
User: super
Print Time: 2024/08/01 8:50:41

室内温度 - Ch7 ASK089161


2024/07/01 00:00 – 2024/08/01 00:00

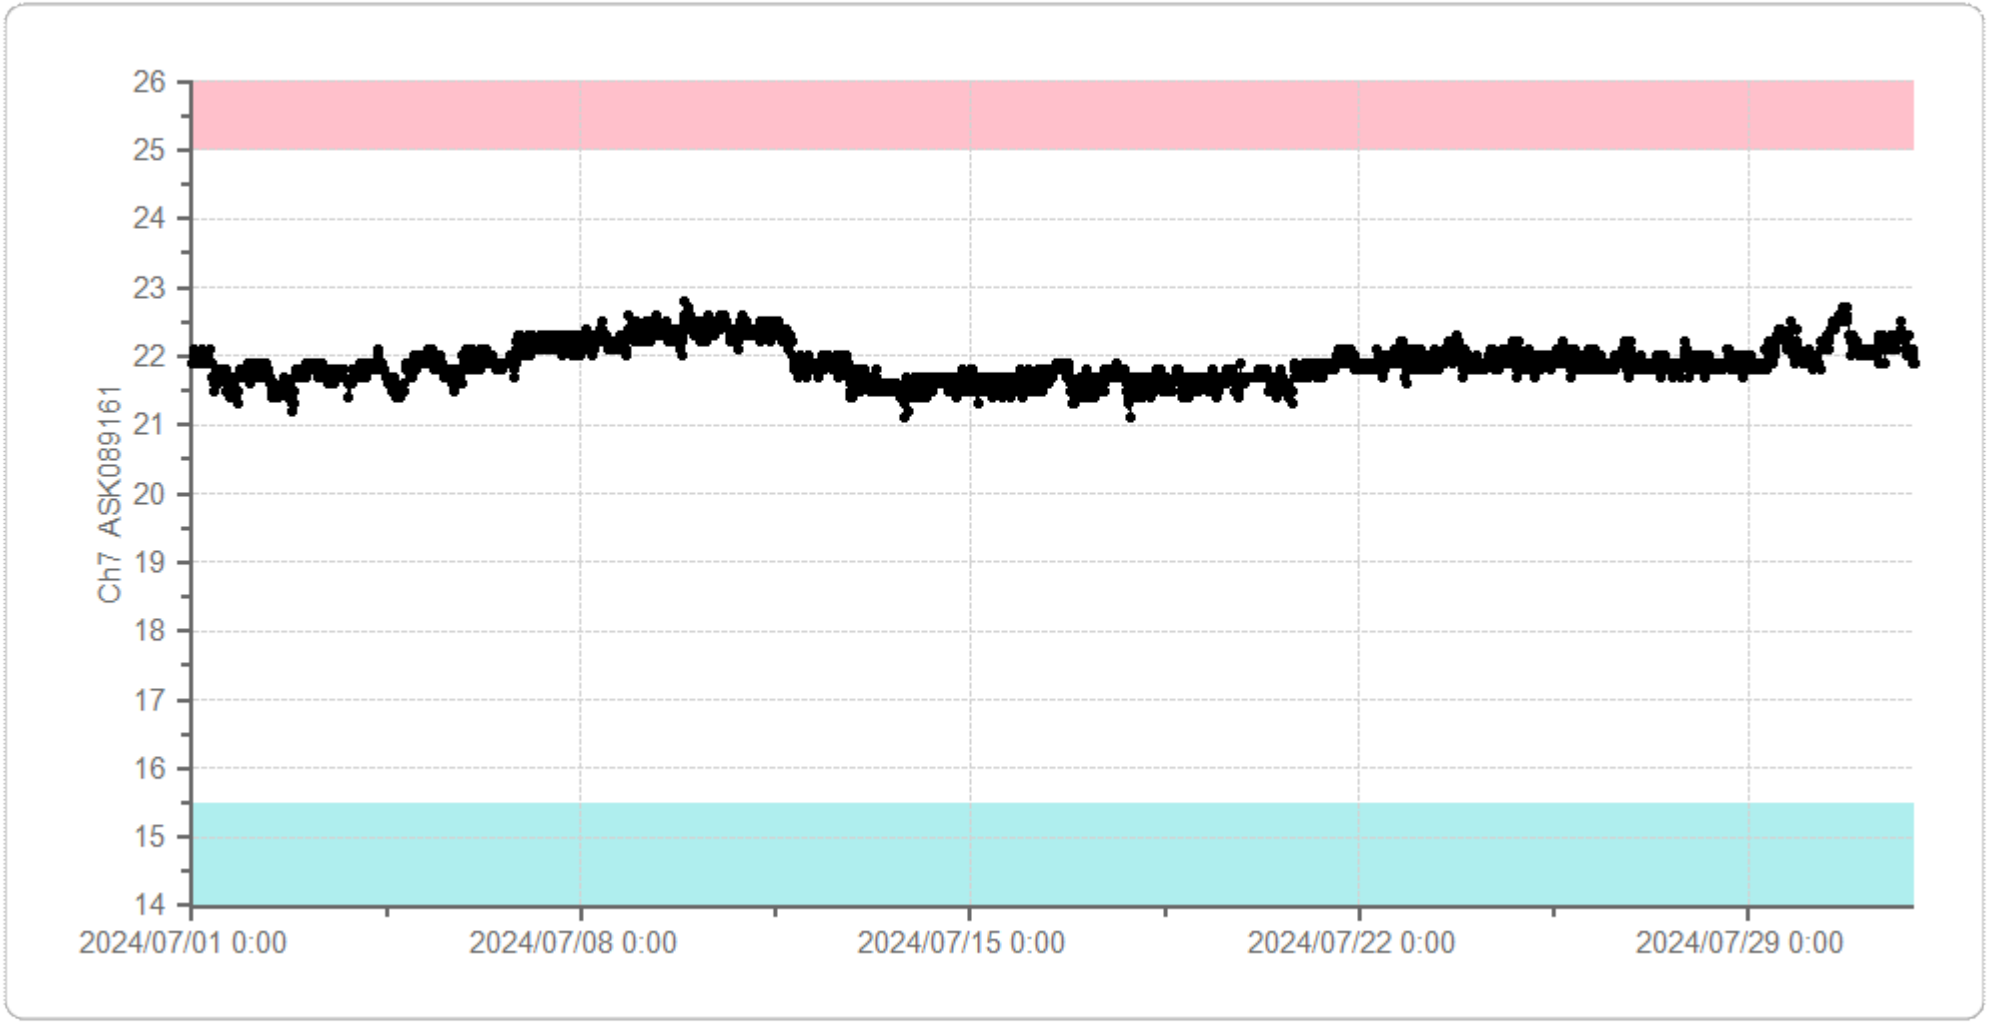

User: super
Print Time: 2024/08/01 8:49:34

薬冷1 (MPR-1014) - Ch1 KQL278302


2024/07/01 00:00 – 2024/08/01 00:00

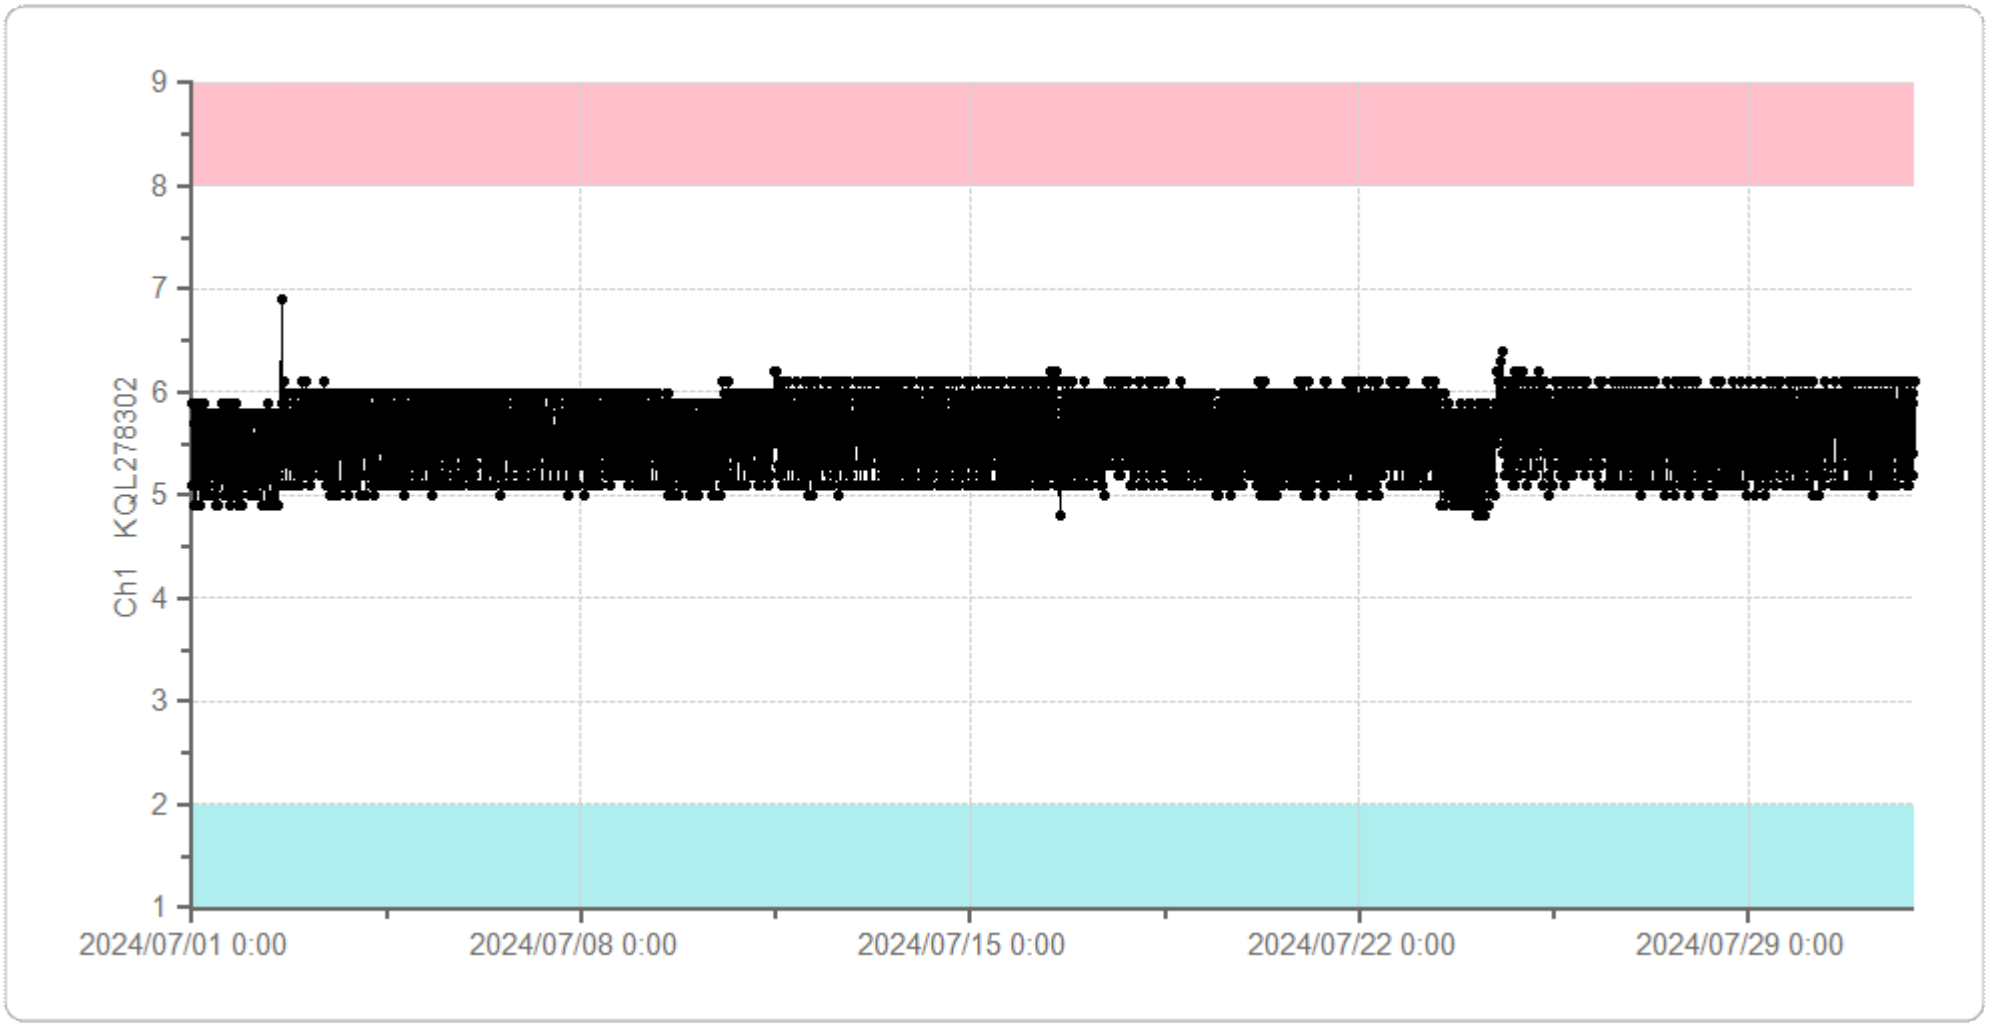

User: super
Print Time: 2024/08/01 8:49:34


薬冷2 (MPR-414F 上) - Ch2 KQL278301

2024/07/01 00:00 – 2024/08/01 00:00

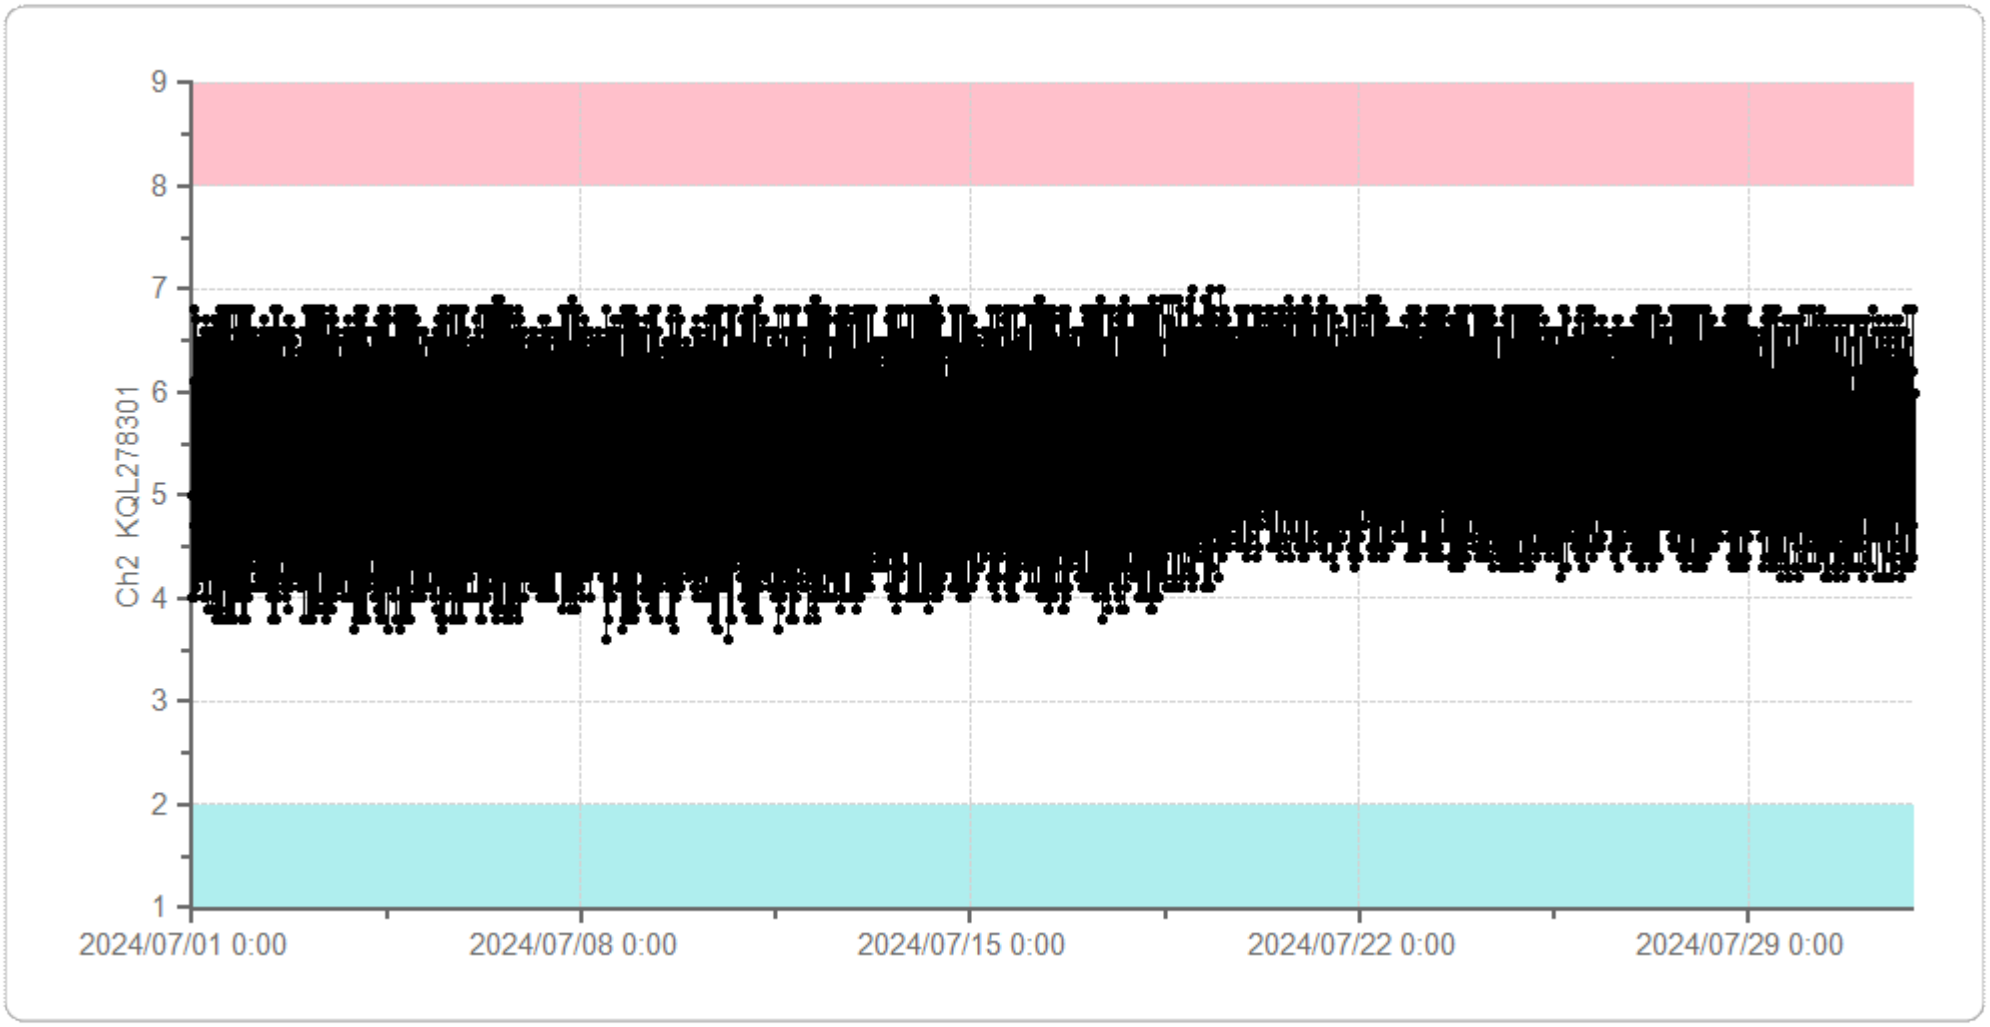


Graph Display

User: super
Print Time: 2024/08/01 8:50:41

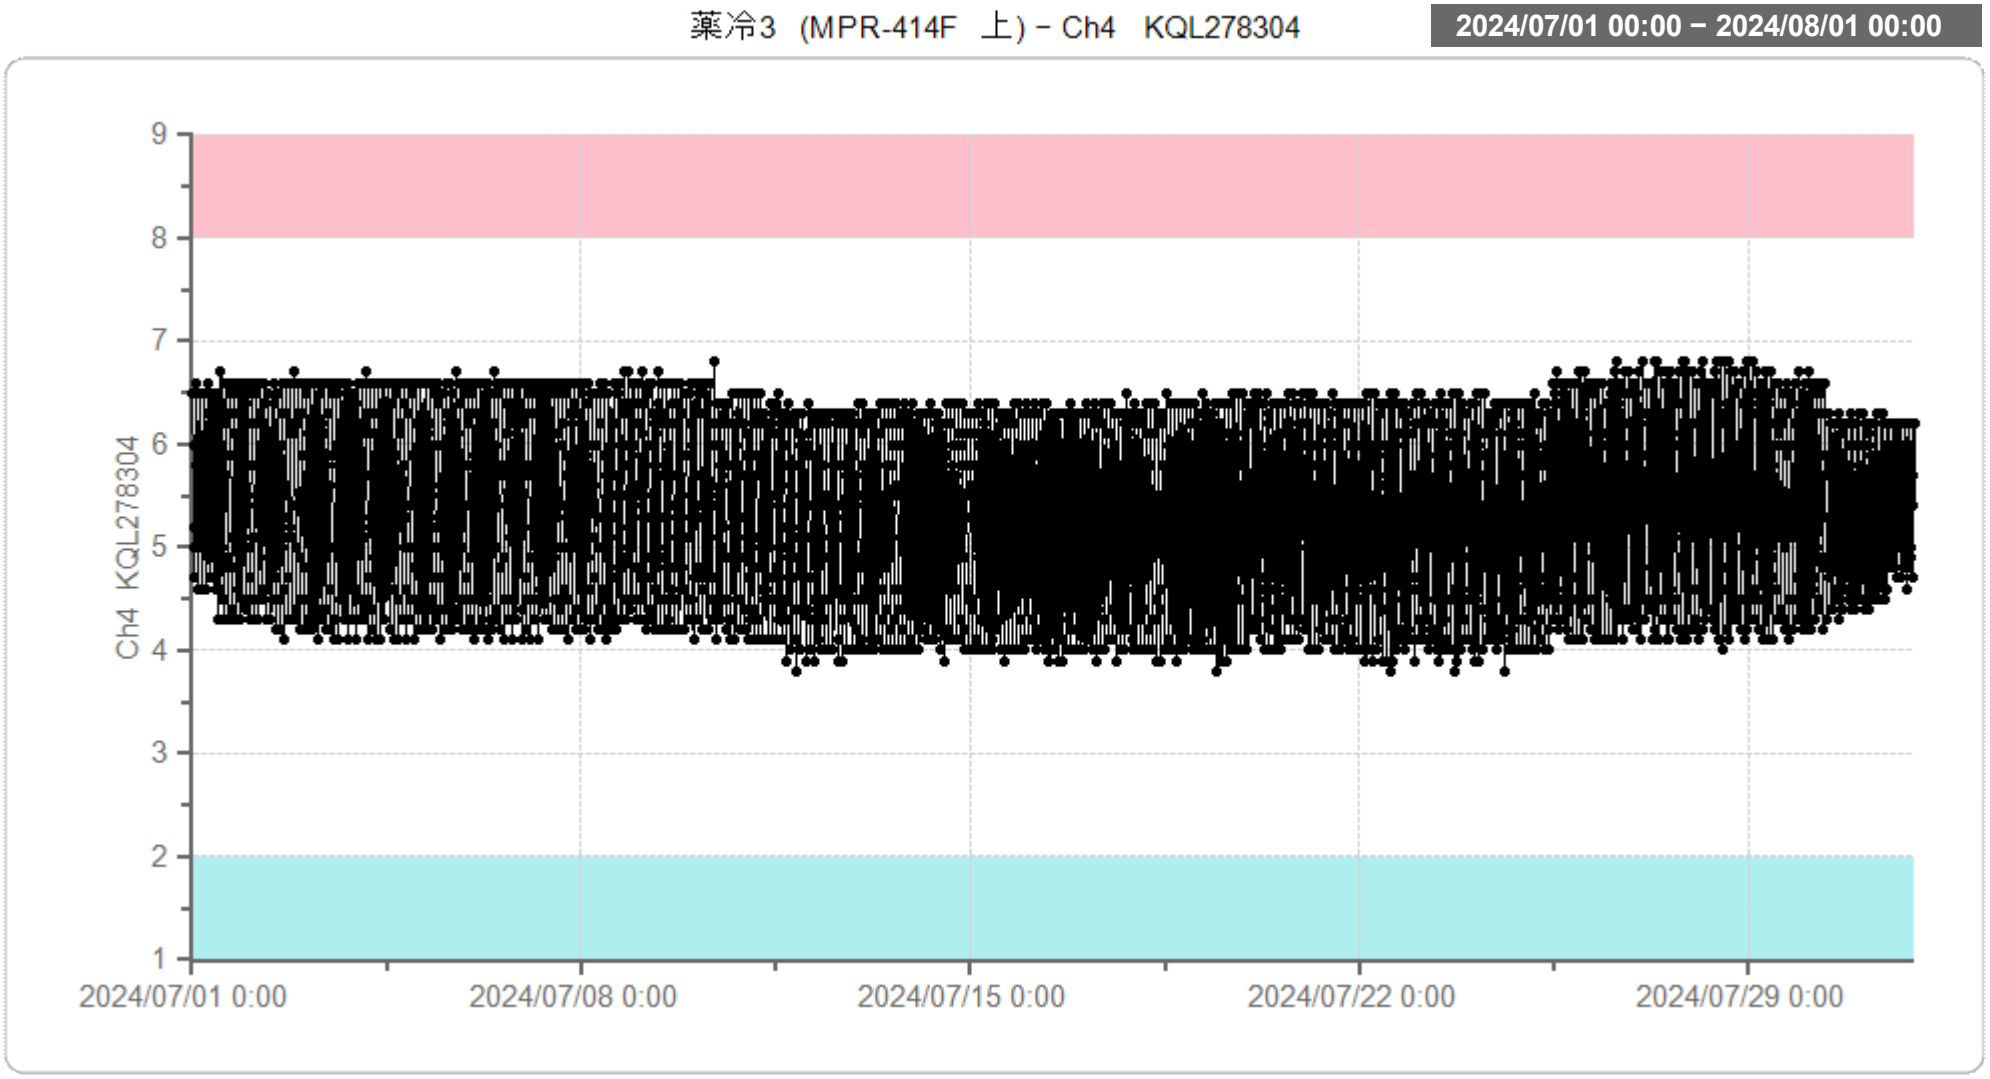


User: super
Print Time: 2024/08/01 8:50:41

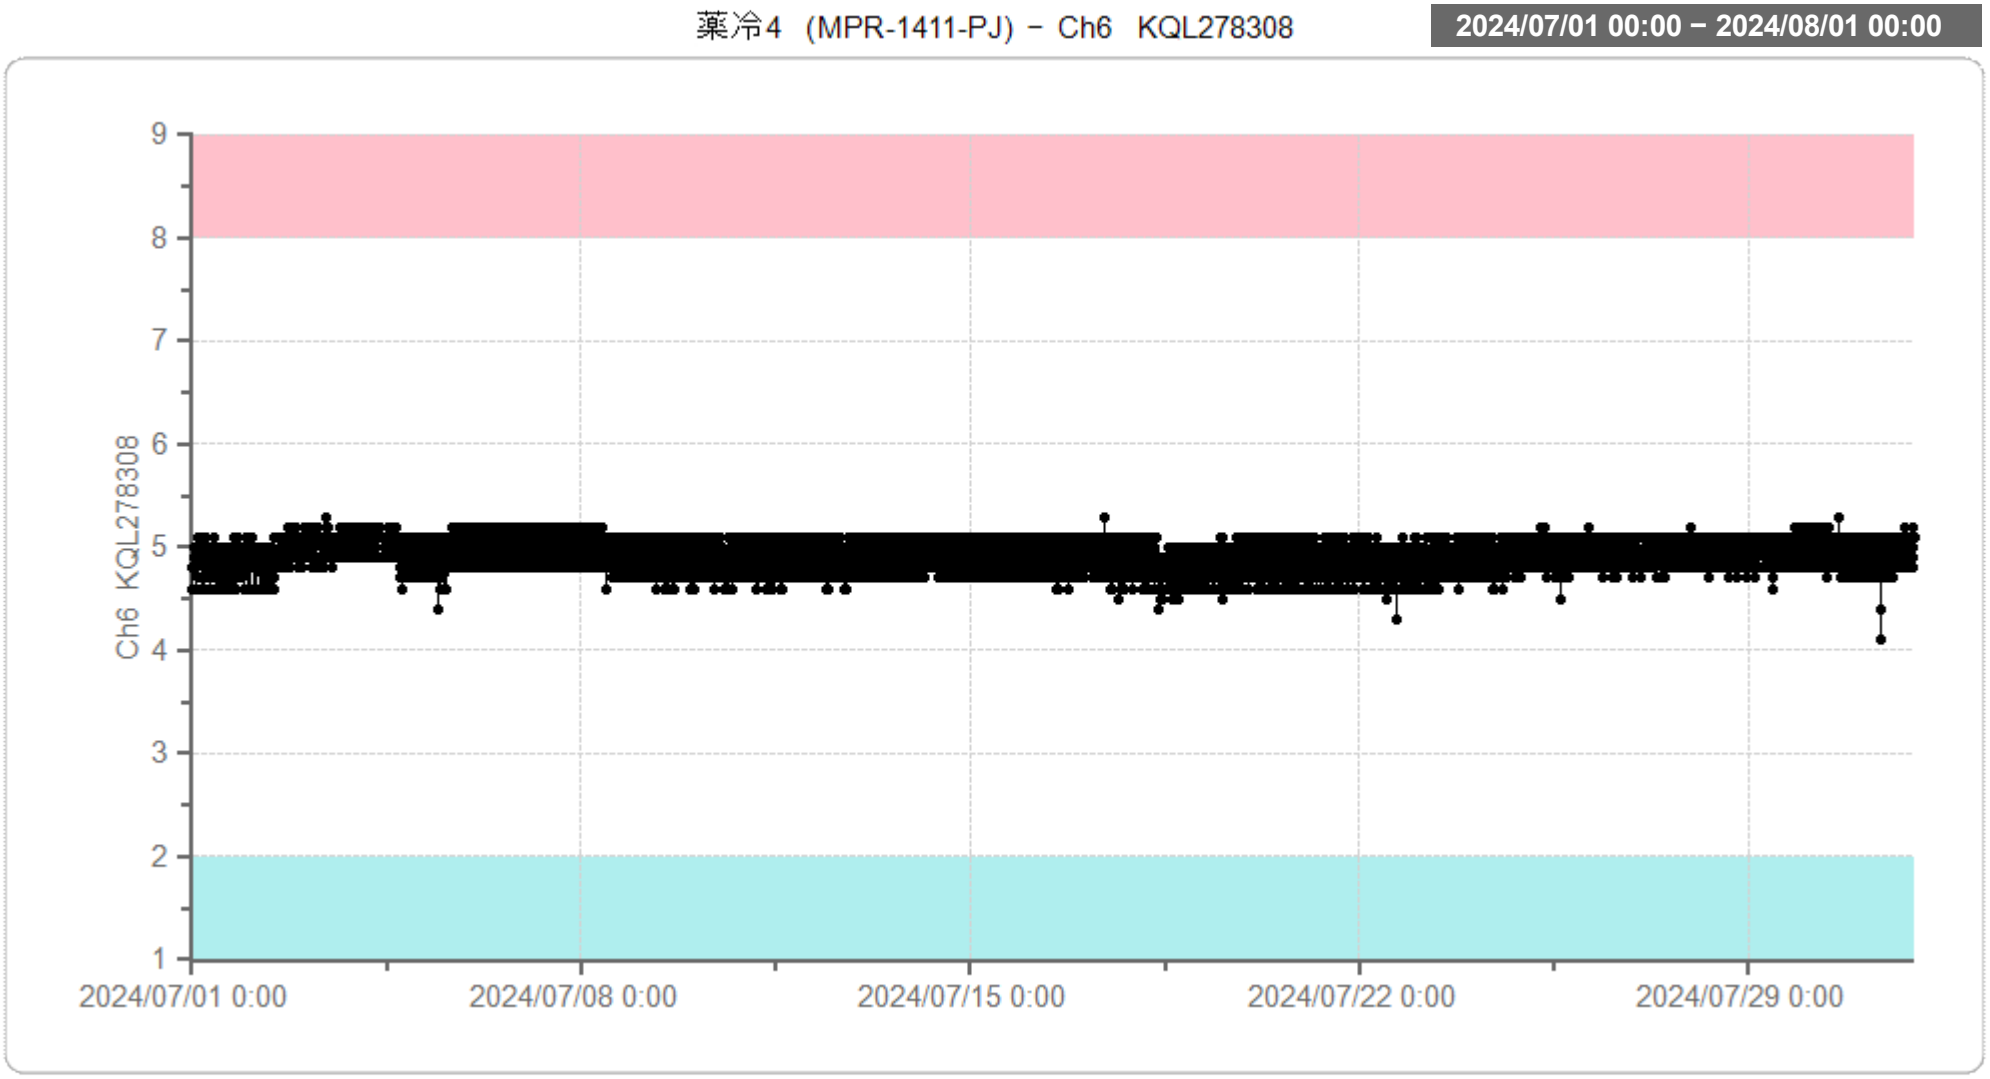


User: super
Print Time: 2024/08/01 8:50:41

薬冷5 （MPR-N200H）- Ch8 KQL278310


2024/07/01 00:00 – 2024/08/01 00:00

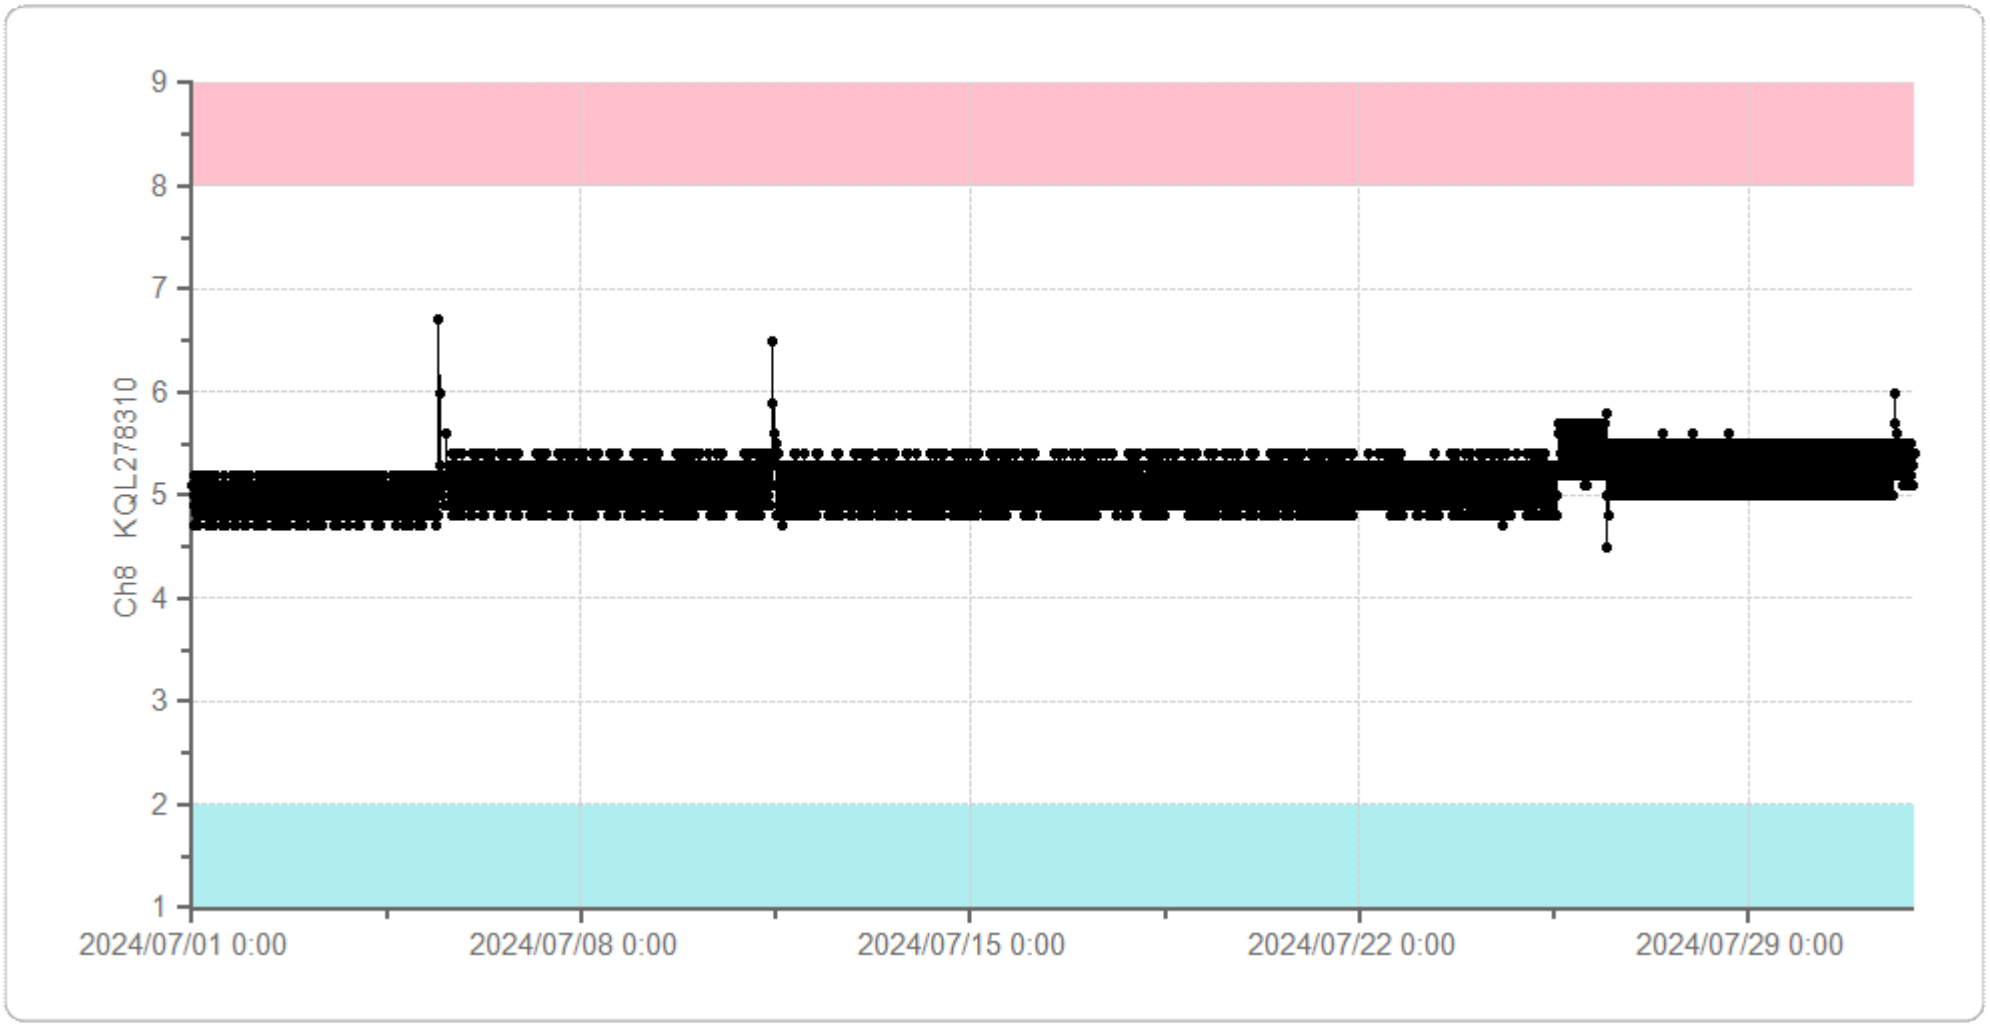

User: super
Print Time: 2024/08/01 8:50:41

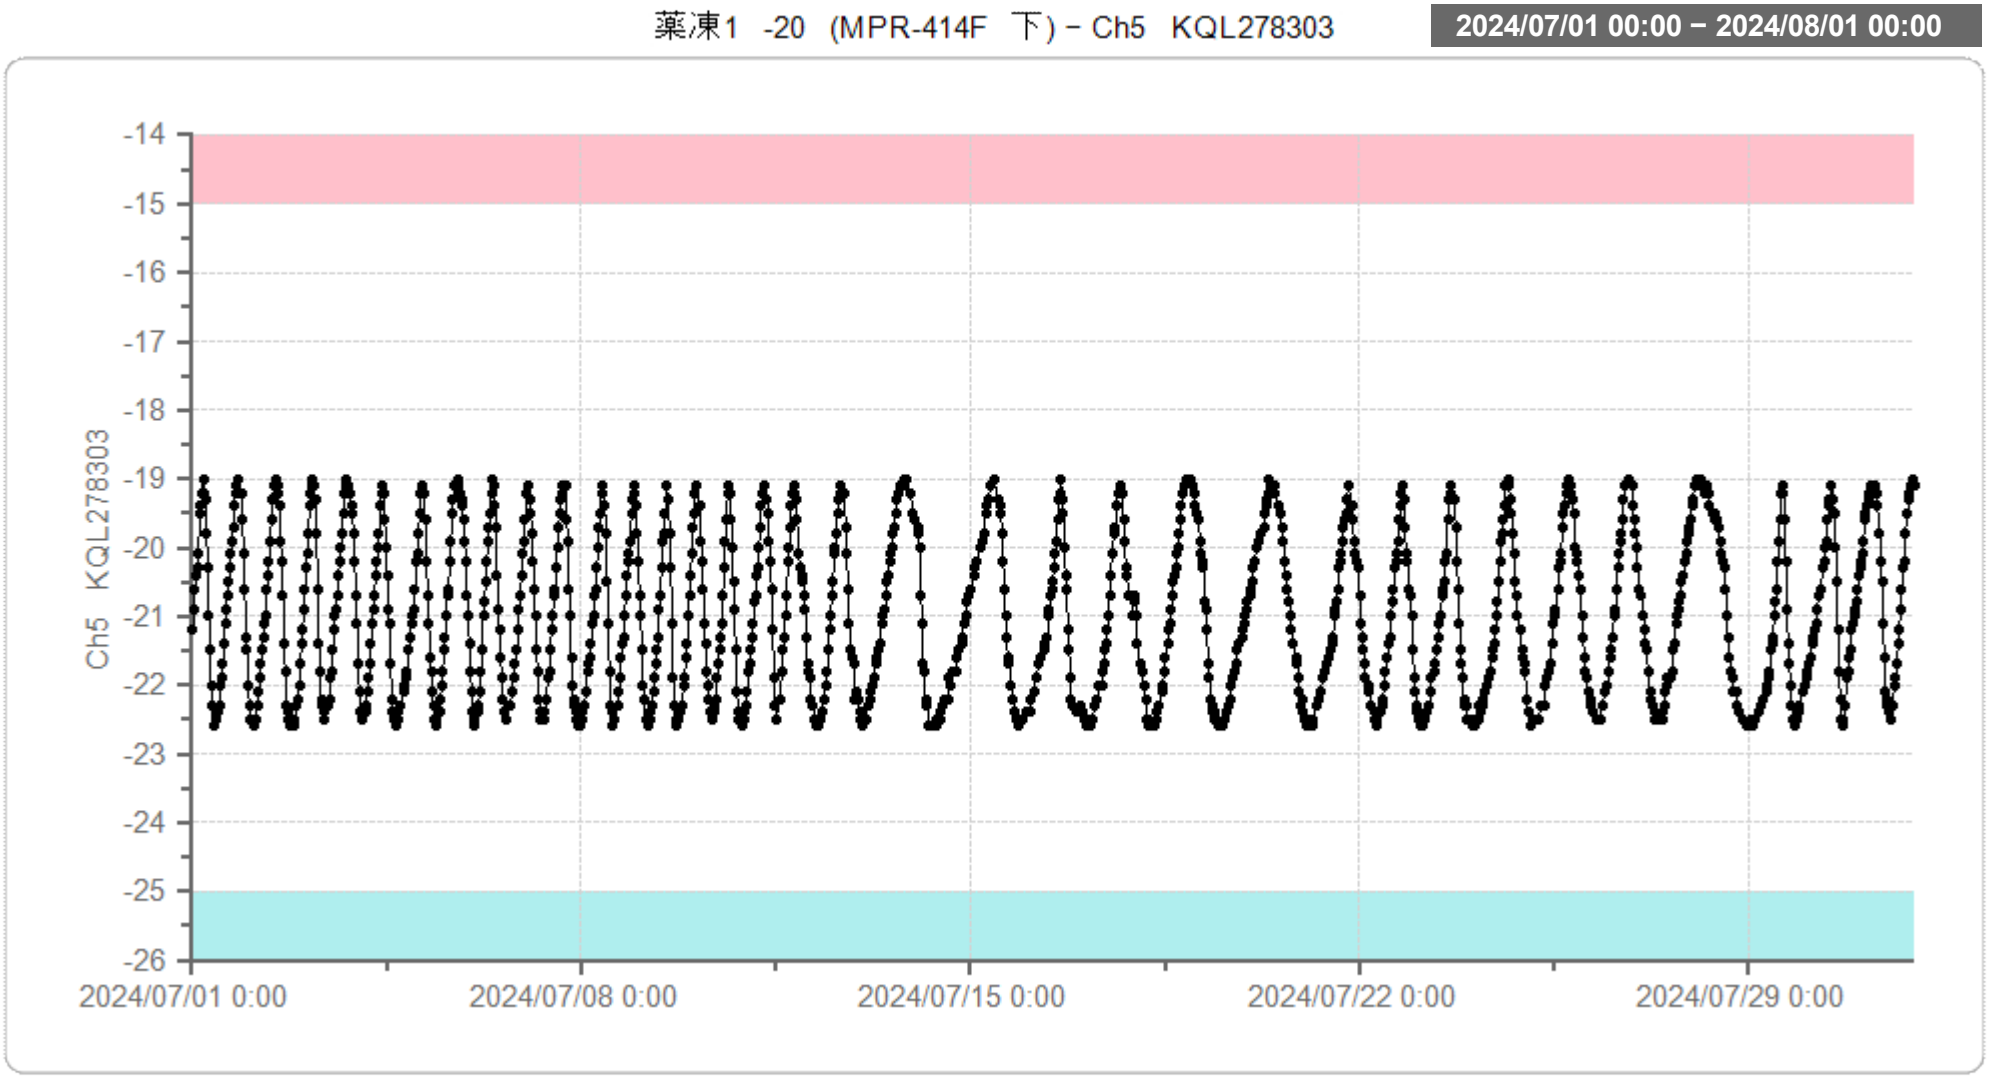


User: super
Print Time: 2024/08/01 8:49:34

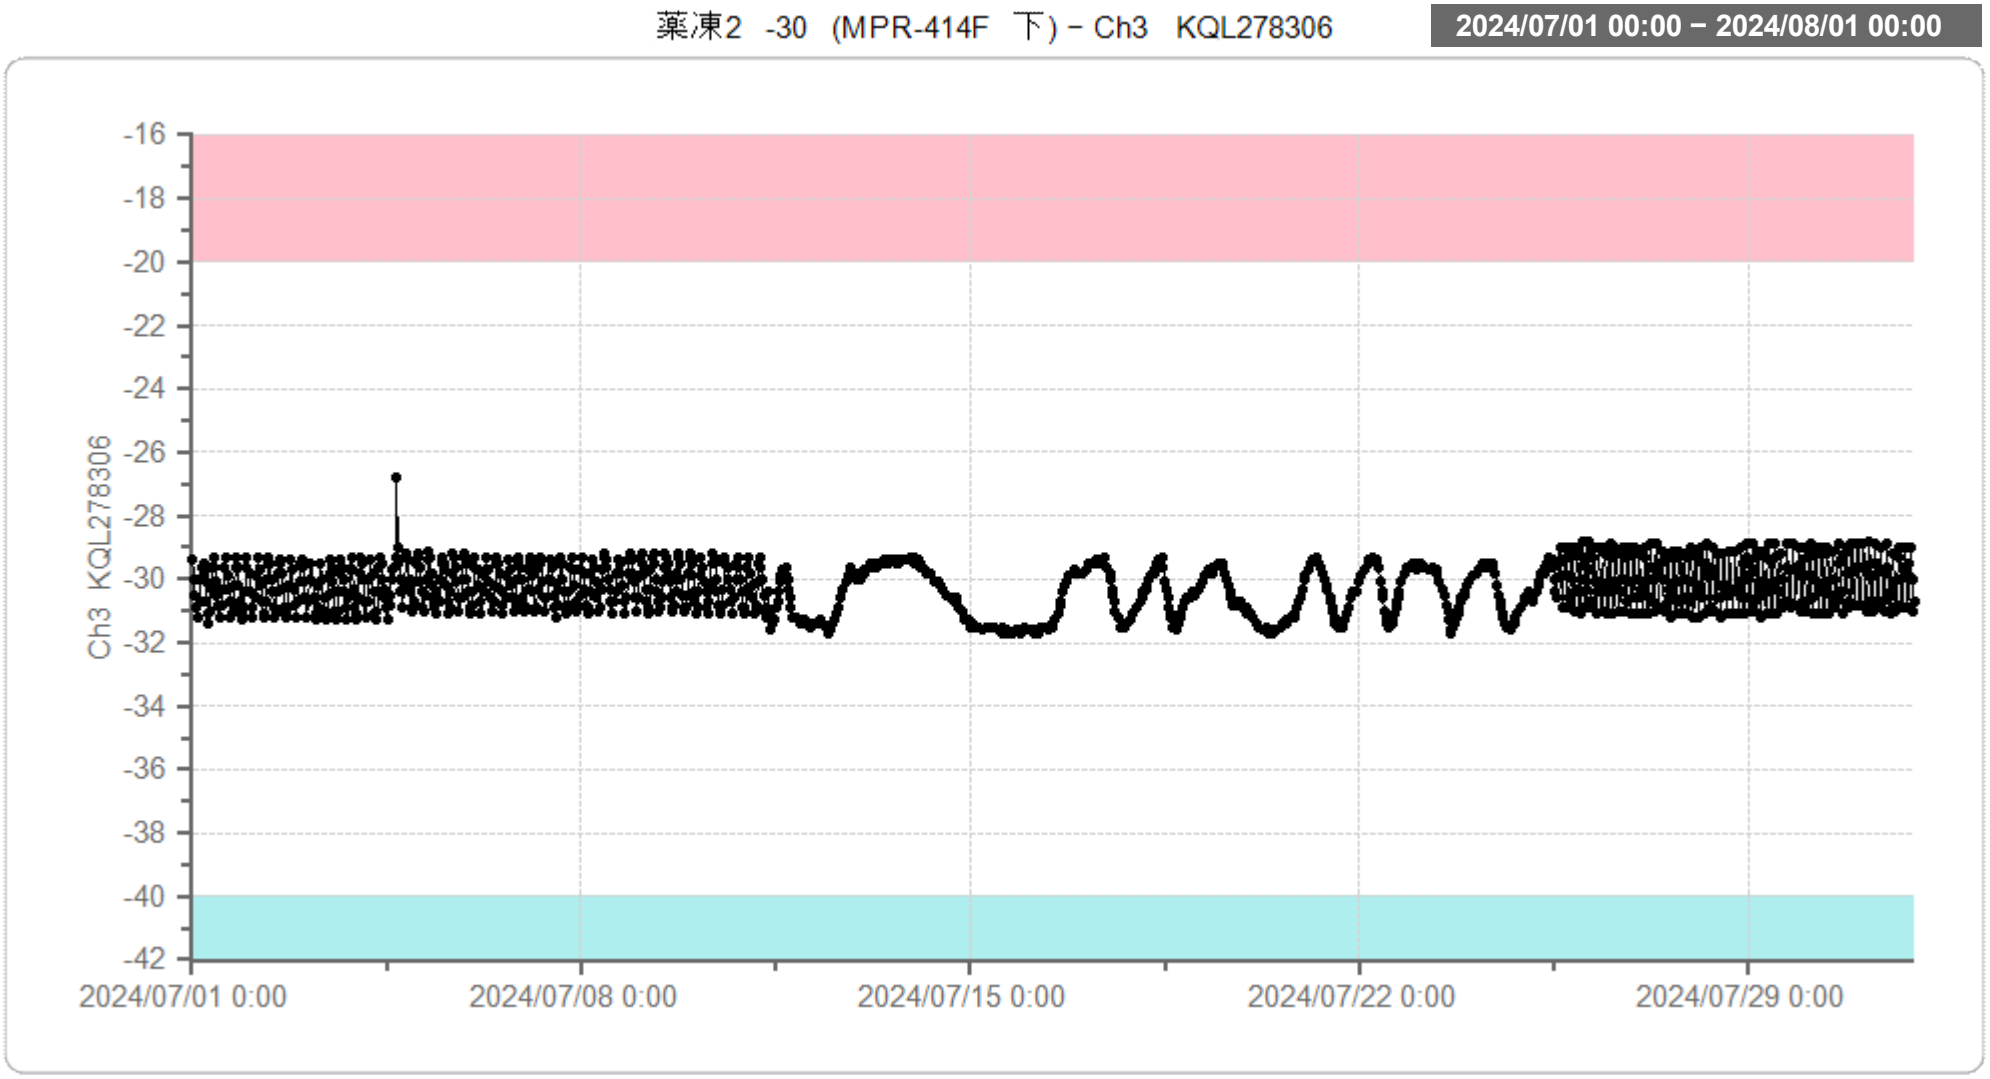

User: super
Print Time: 2024/08/01 8:49:34


検冷 (MPR-311DR) - Ch3 KQL278309

2024/07/01 00:00 – 2024/08/01 00:00

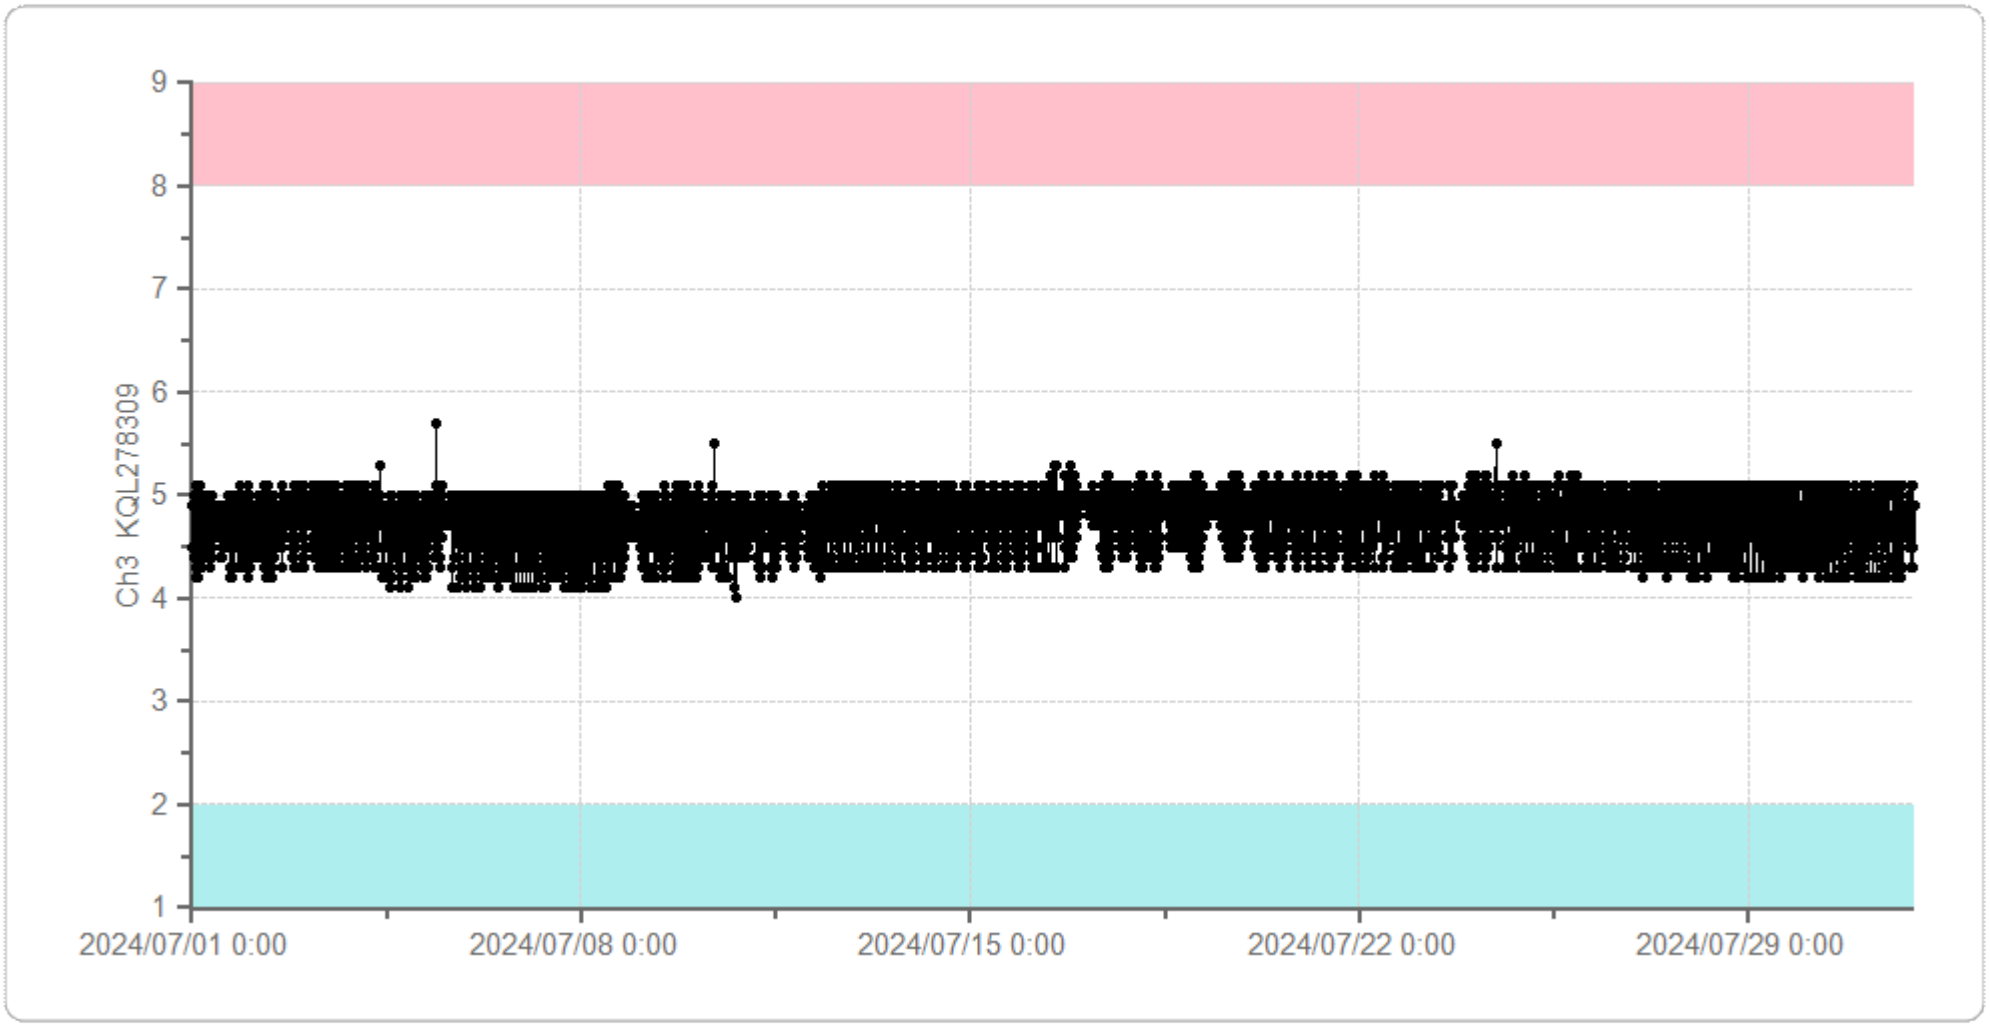

User: super
Print Time: 2024/08/01 8:49:34

検凍-20℃以下 (MDF-U443) - Ch2 KQL278307 **2024/07/01 00:00 – 2024/08/01 00:00**

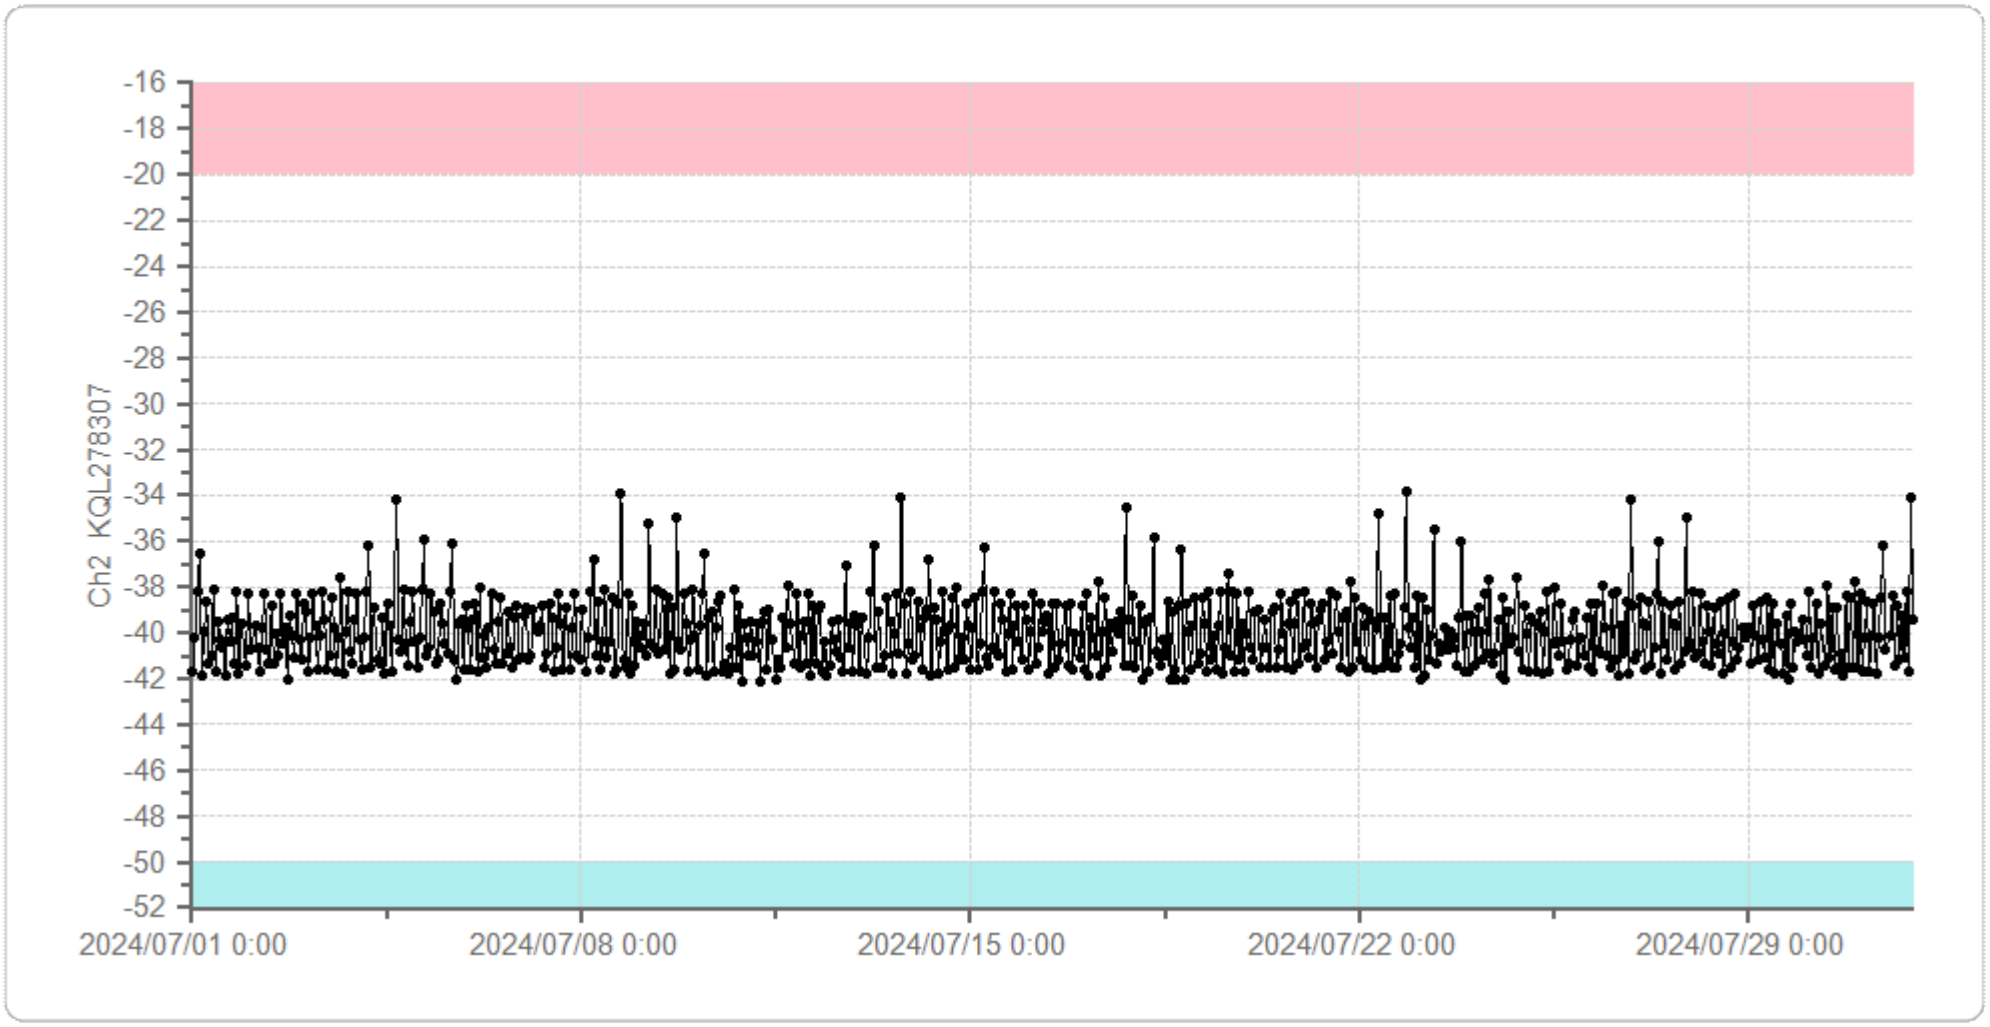

Graph Display

User: super
Print Time: 2024/08/01 8:49:34

