

User: super
Print Time: 2024/10/01 8:10:22

室内温度 - Ch7 ASK089161


2024/09/01 00:00 – 2024/10/01 00:00

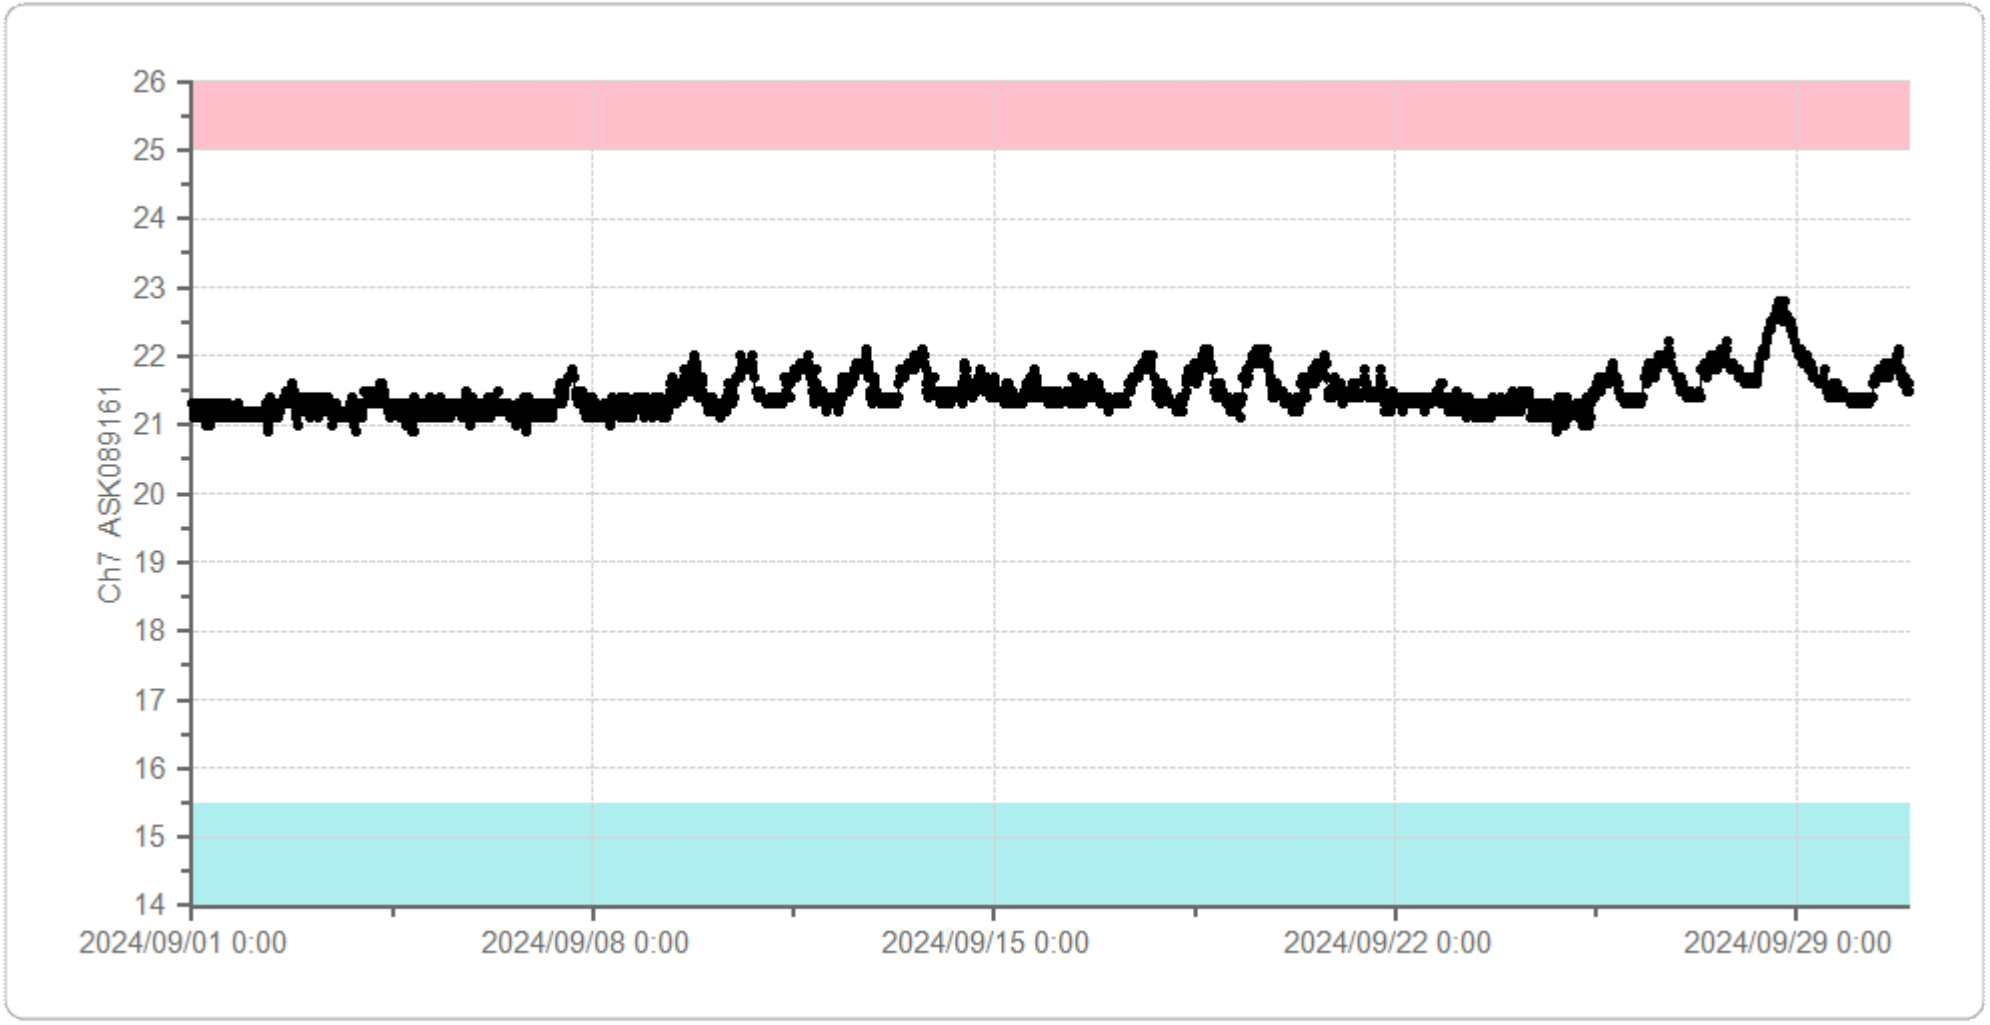

User: super
Print Time: 2024/10/01 8:09:11

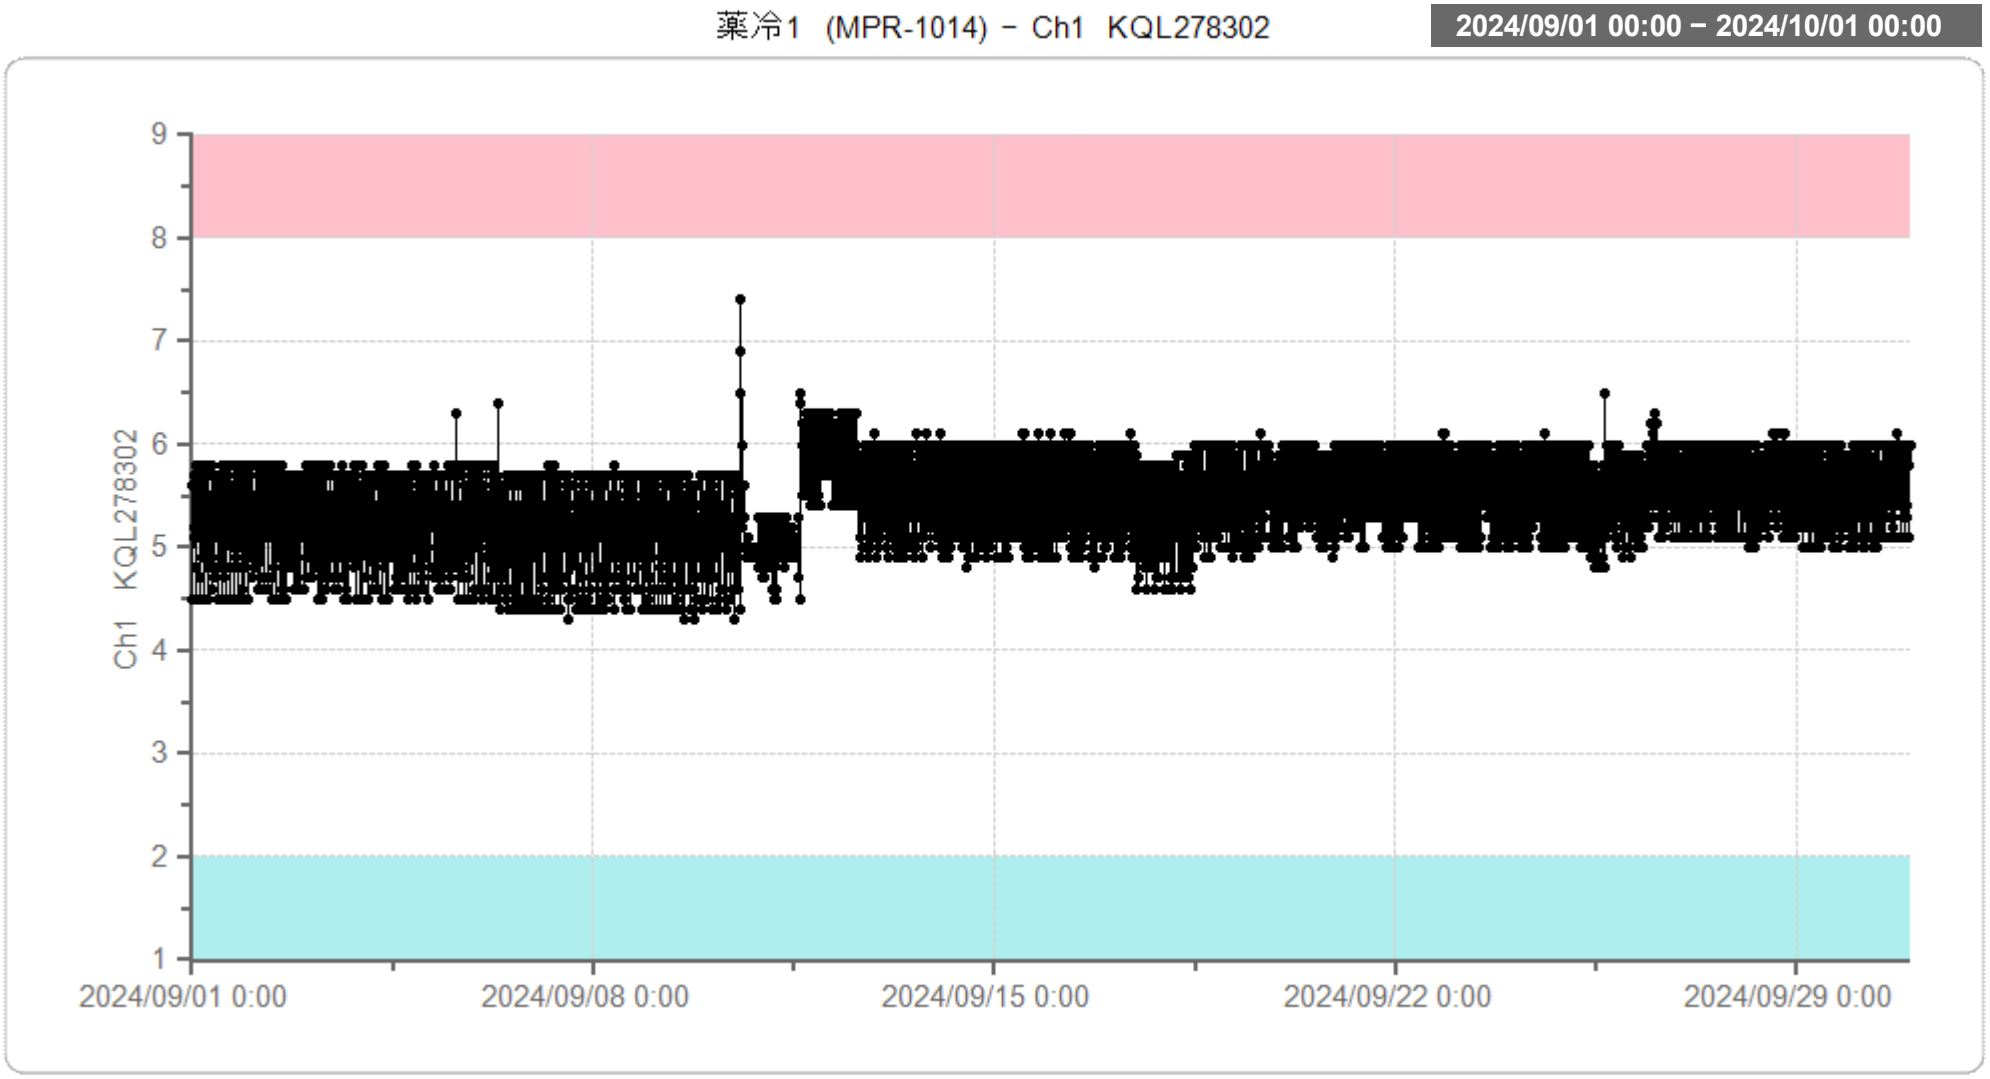


User: super
Print Time: 2024/10/01 8:09:11

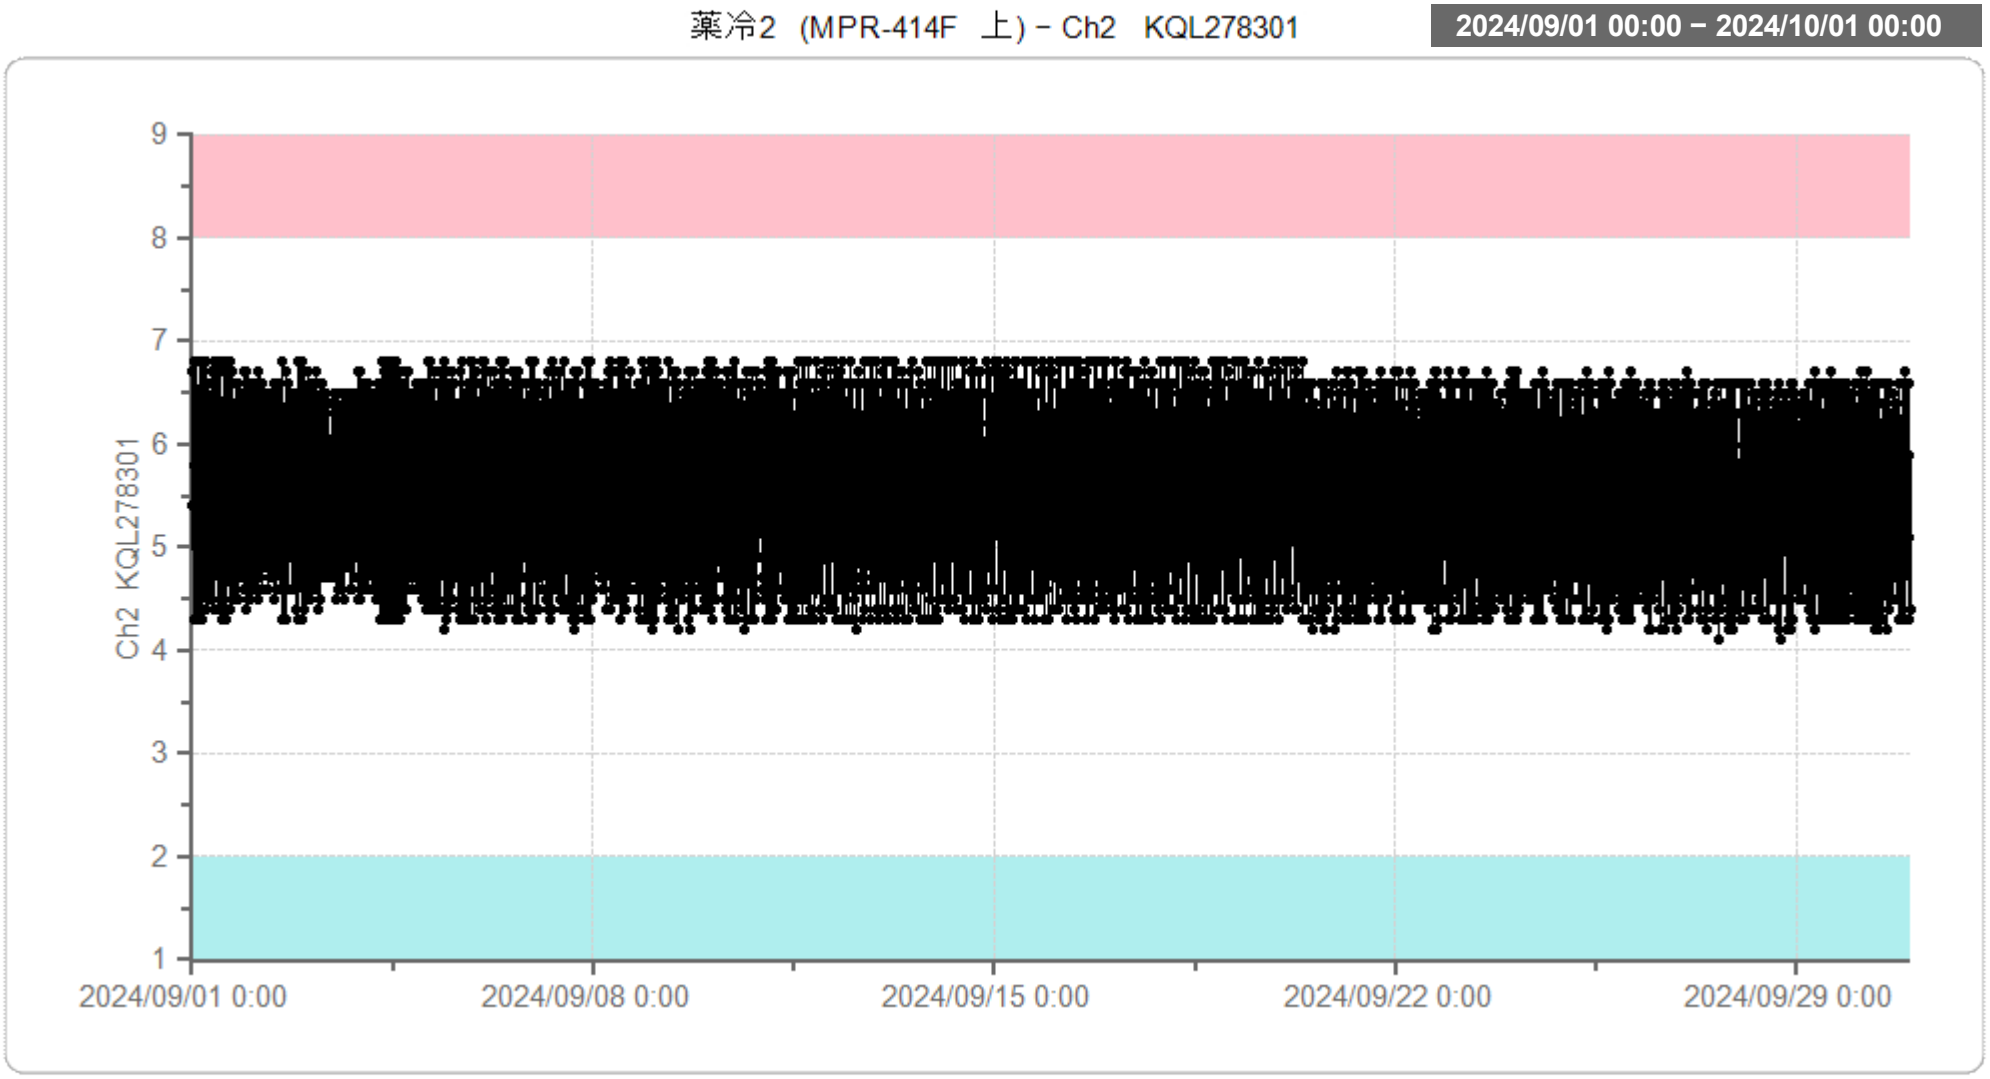


Graph Display


User: super
Print Time: 2024/10/01 8:10:22

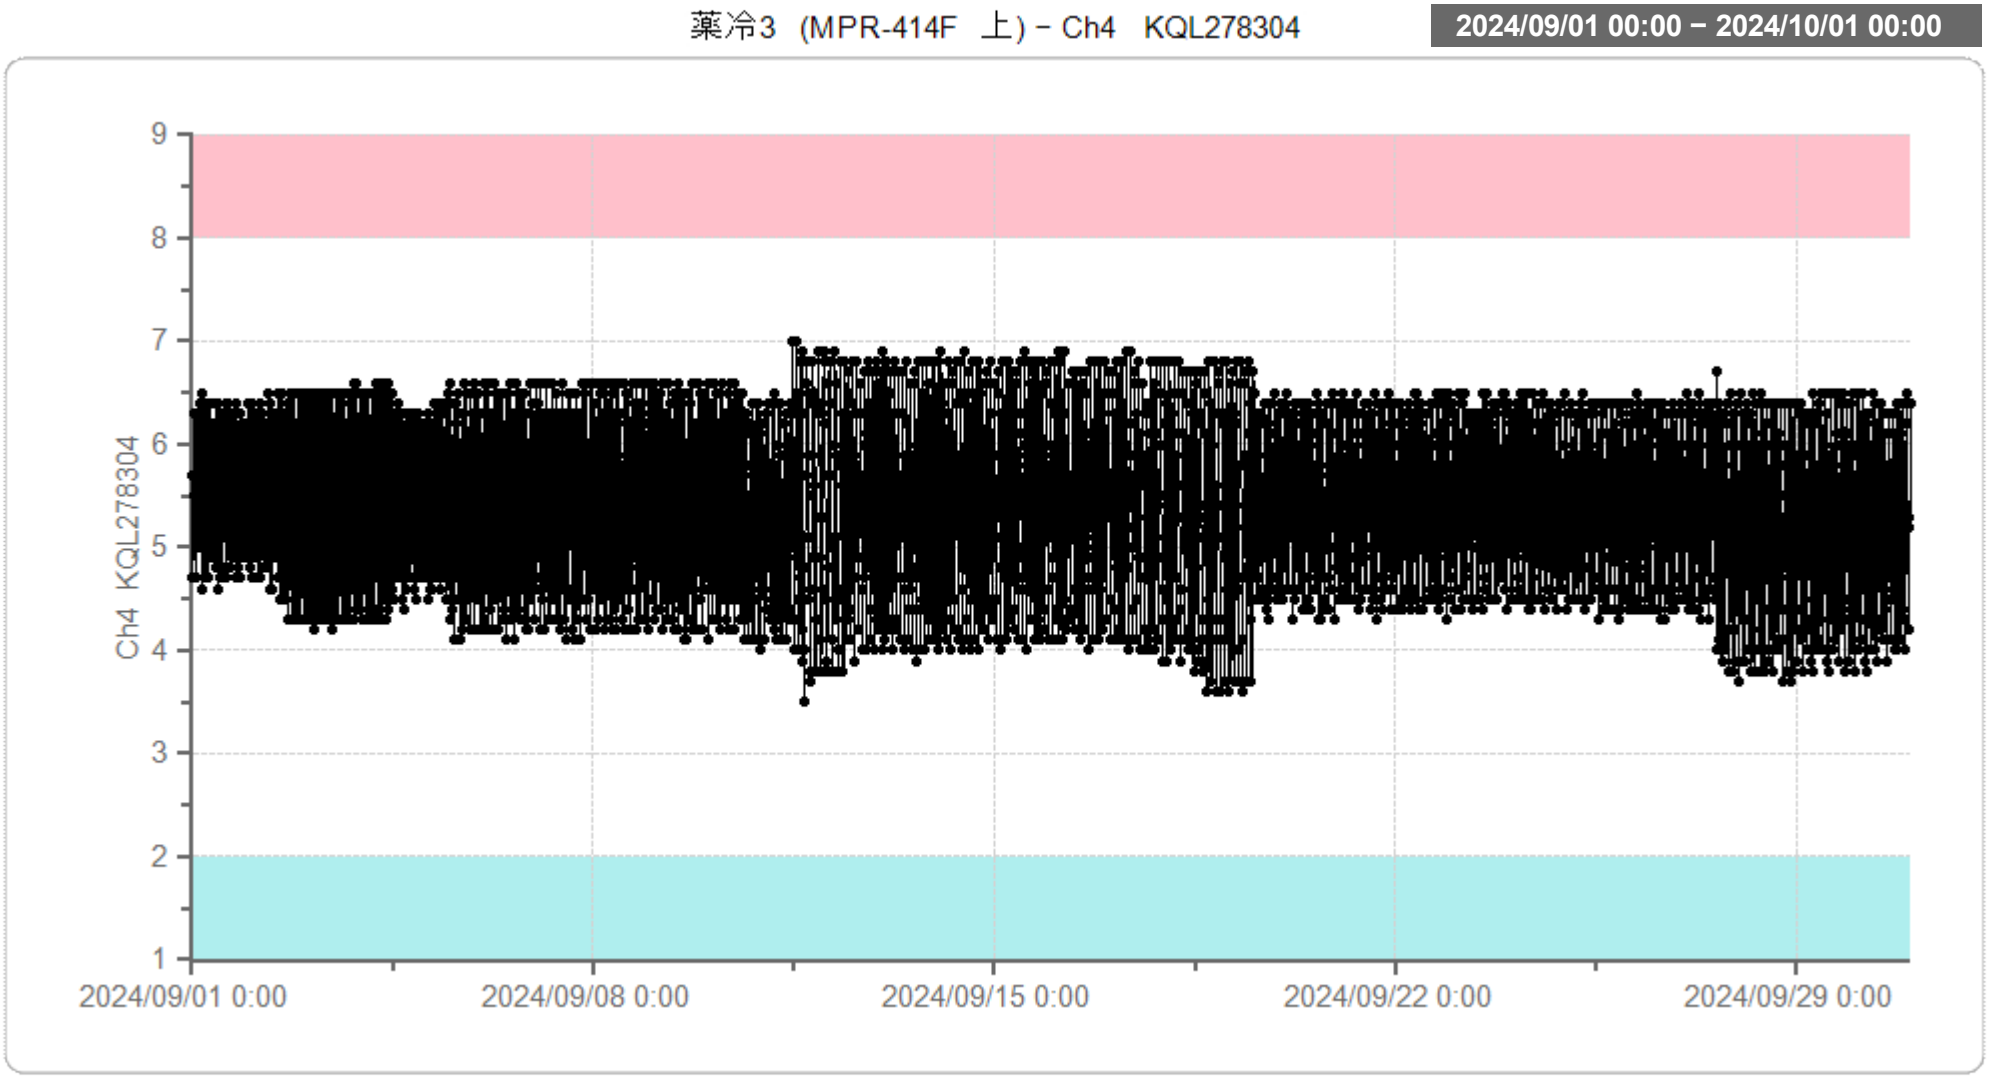

User: super
Print Time: 2024/10/01 8:10:22

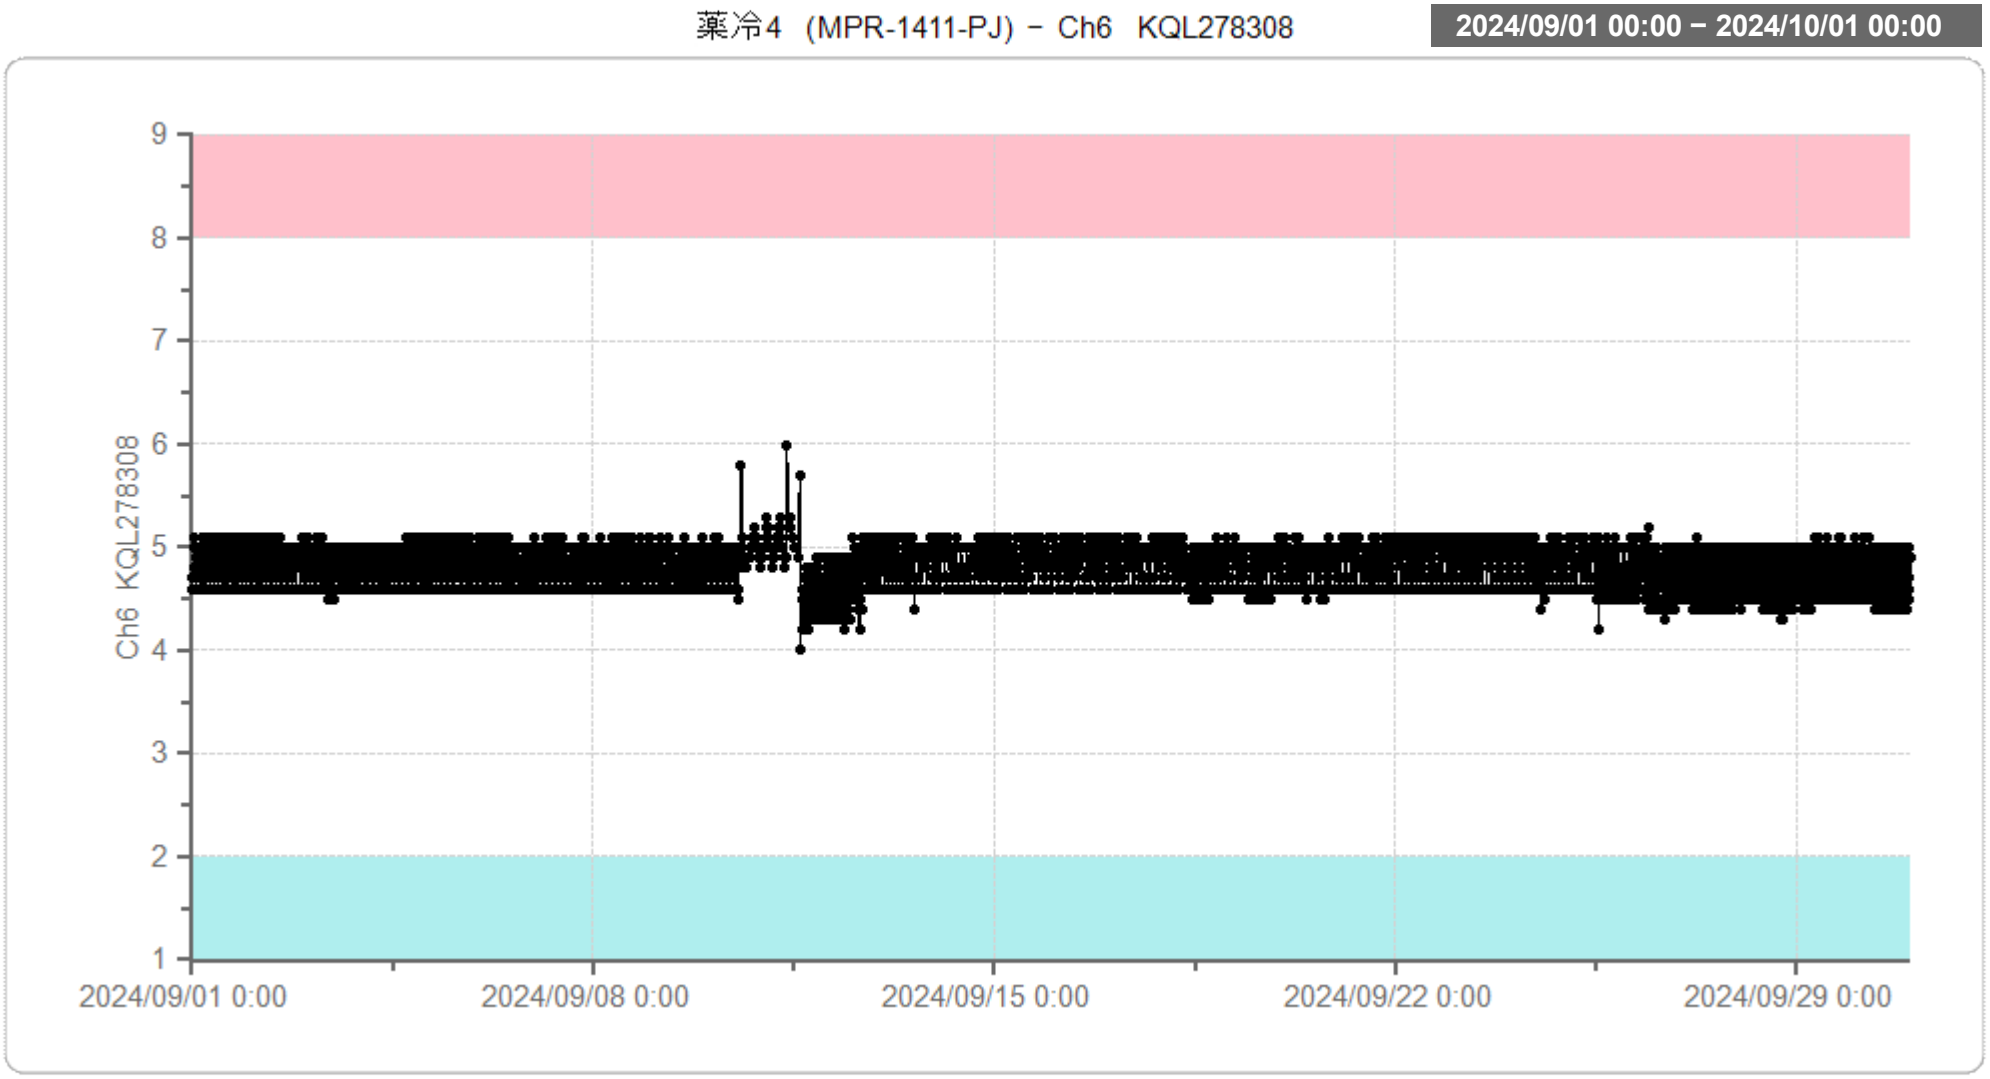


User: super
Print Time: 2024/10/01 8:10:22

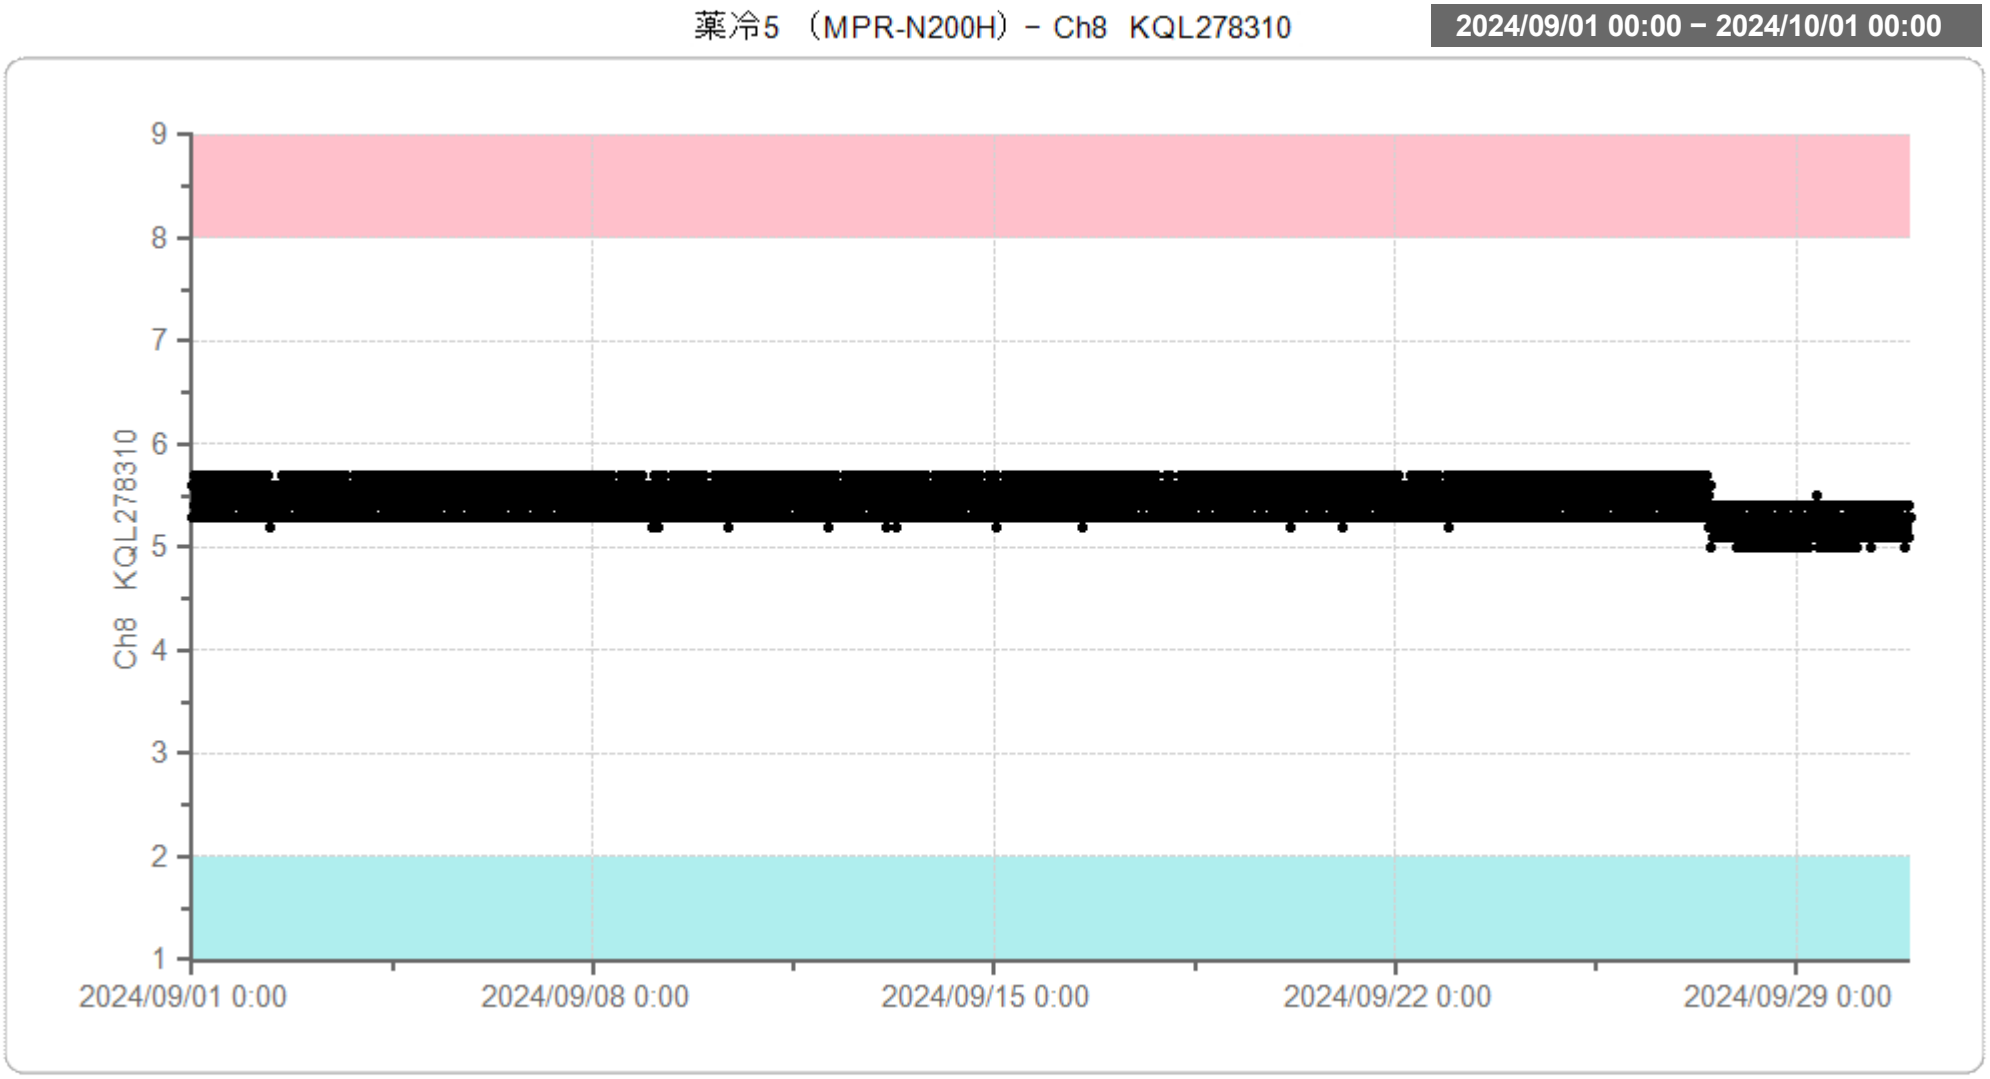


User: super
Print Time: 2024/10/01 8:10:22

薬凍1 -20 (MPR-414F 下) - Ch5 KQL278303

2024/09/01 00:00 – 2024/10/01 00:00

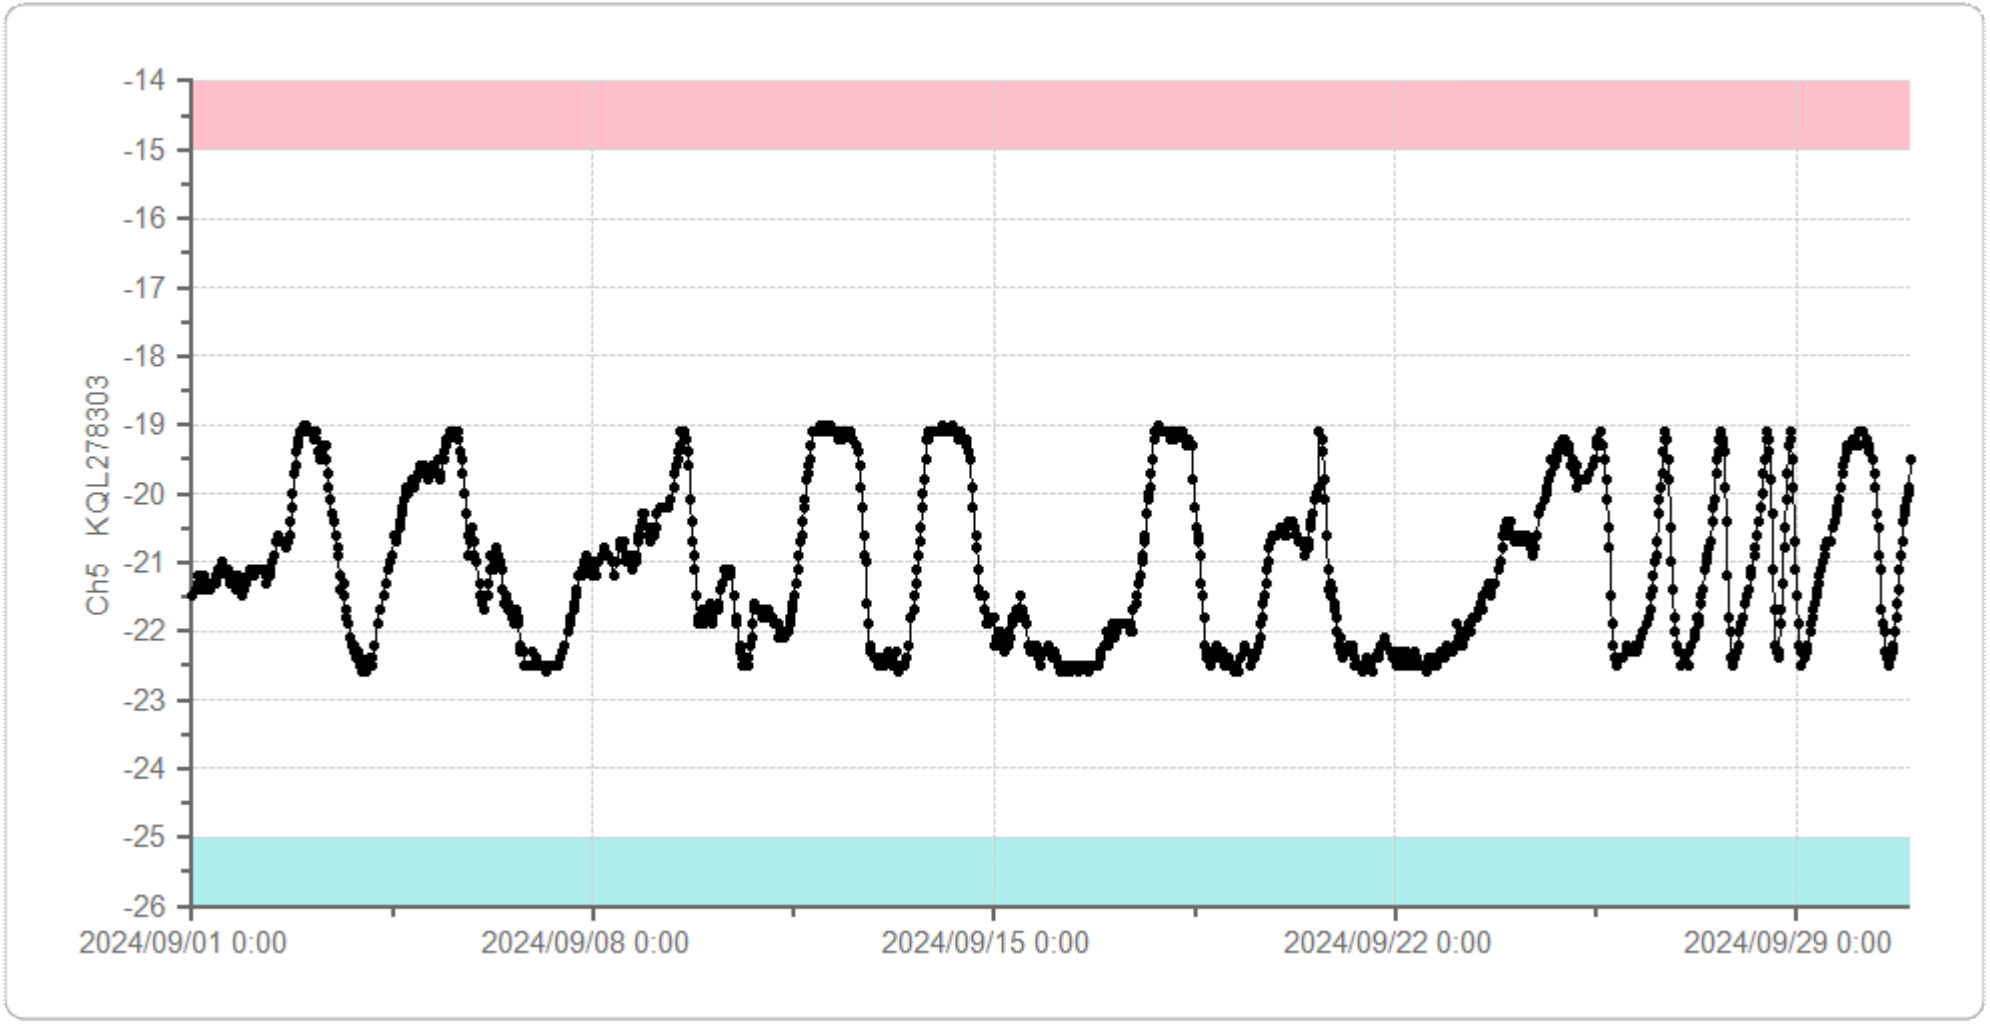


User: super
Print Time: 2024/10/01 8:09:11

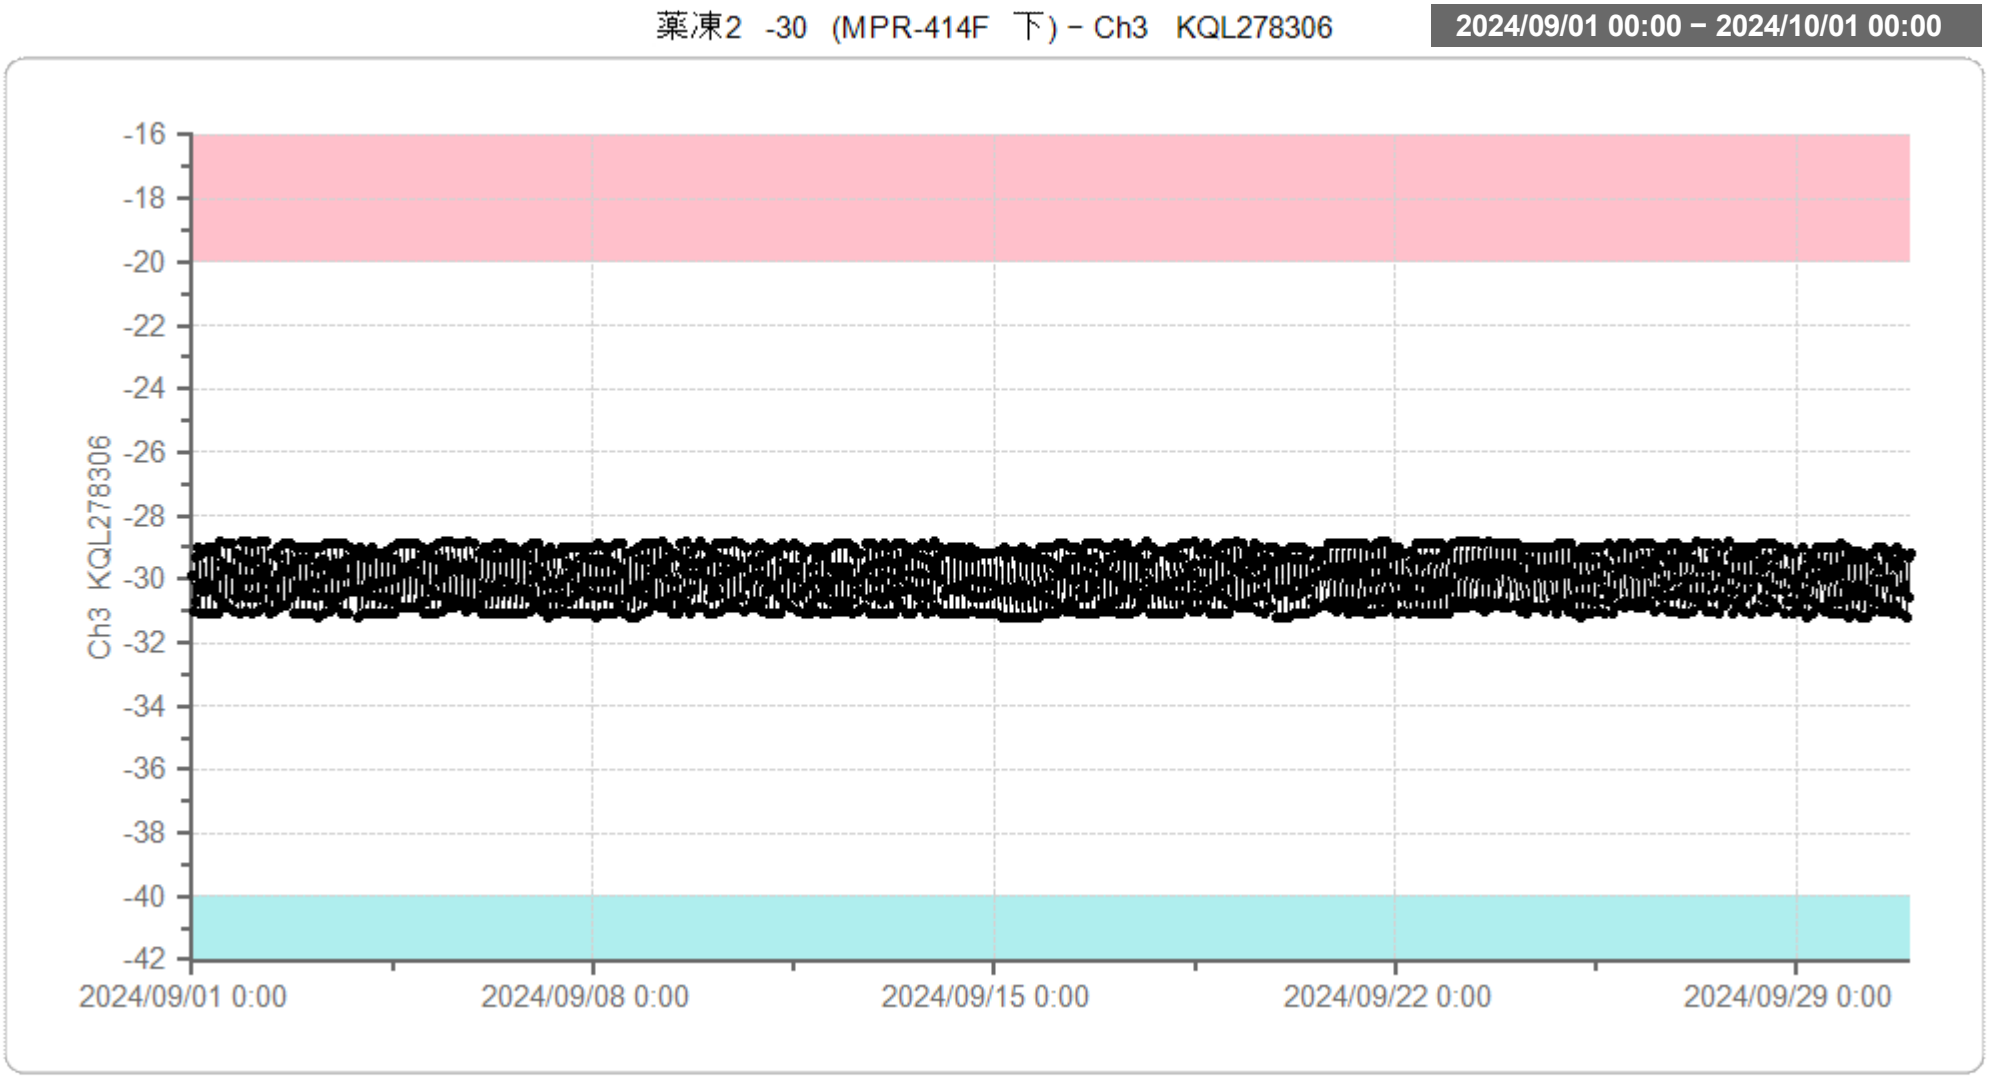

User: super
Print Time: 2024/10/01 8:09:11


検冷 (MPR-311DR) - Ch3 KQL278309

2024/09/01 00:00 – 2024/10/01 00:00

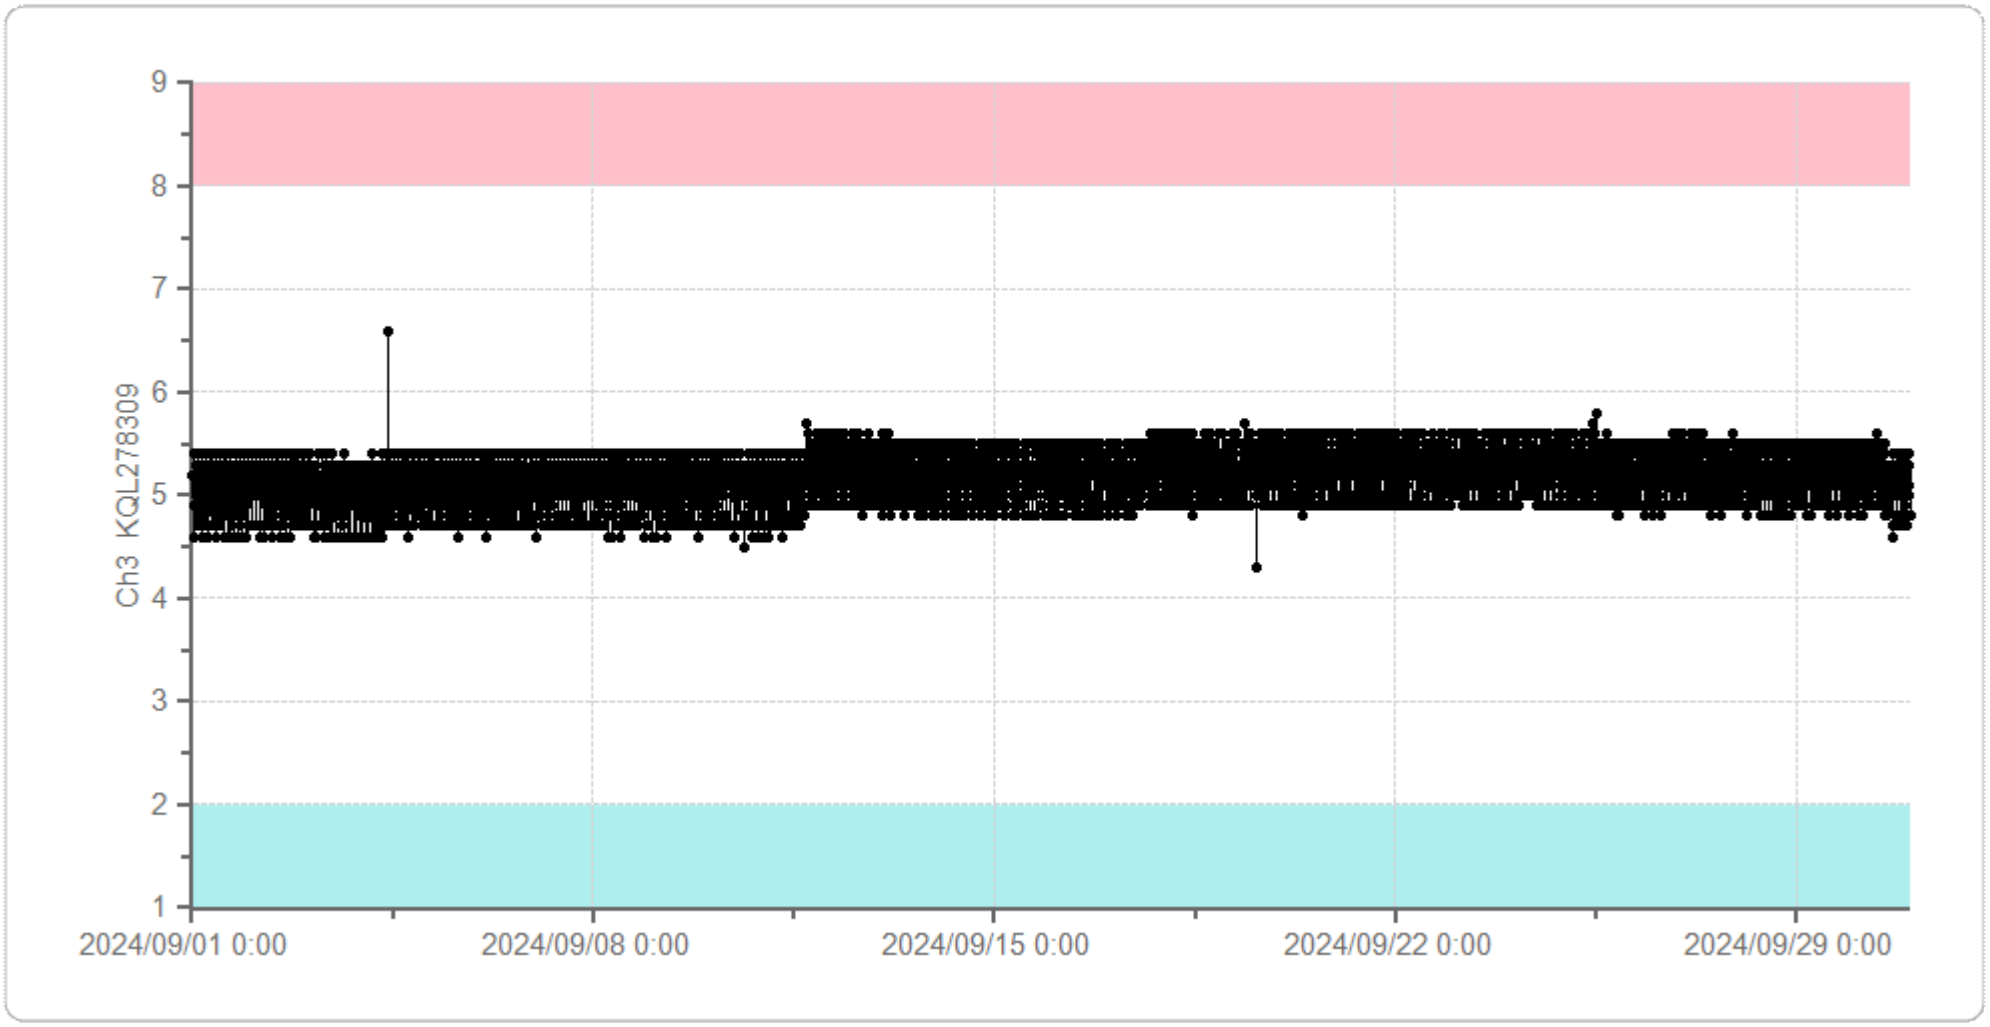

User: super
Print Time: 2024/10/01 8:09:11

検凍-20℃以下 (MDF-U443) - Ch2 KQL278307 **2024/09/01 00:00 – 2024/10/01 00:00**

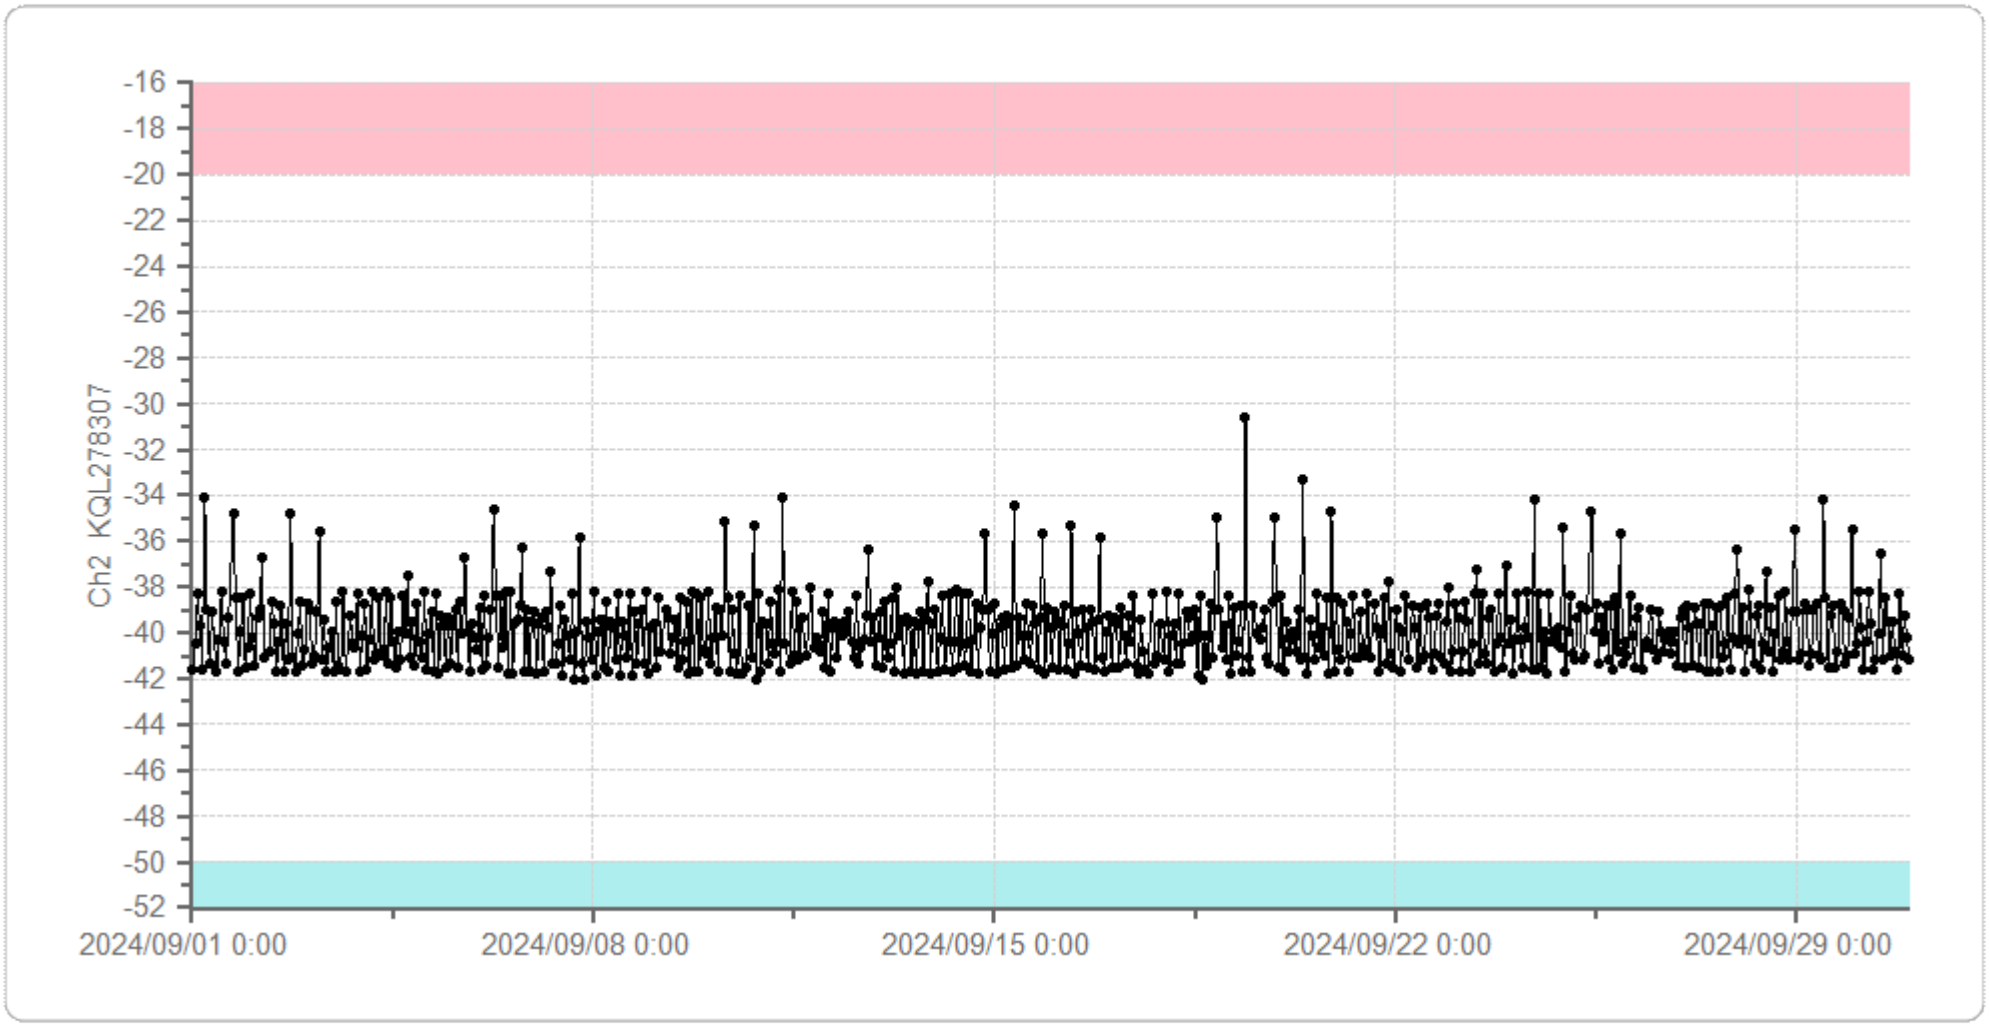

Graph Display

User: super
Print Time: 2024/10/01 8:09:11

