
User: super
Print Time: 2025/03/04 8:51:46

室内温度 - Ch7 ASK089161


2025/02/01 00:00 – 2025/03/01 00:00

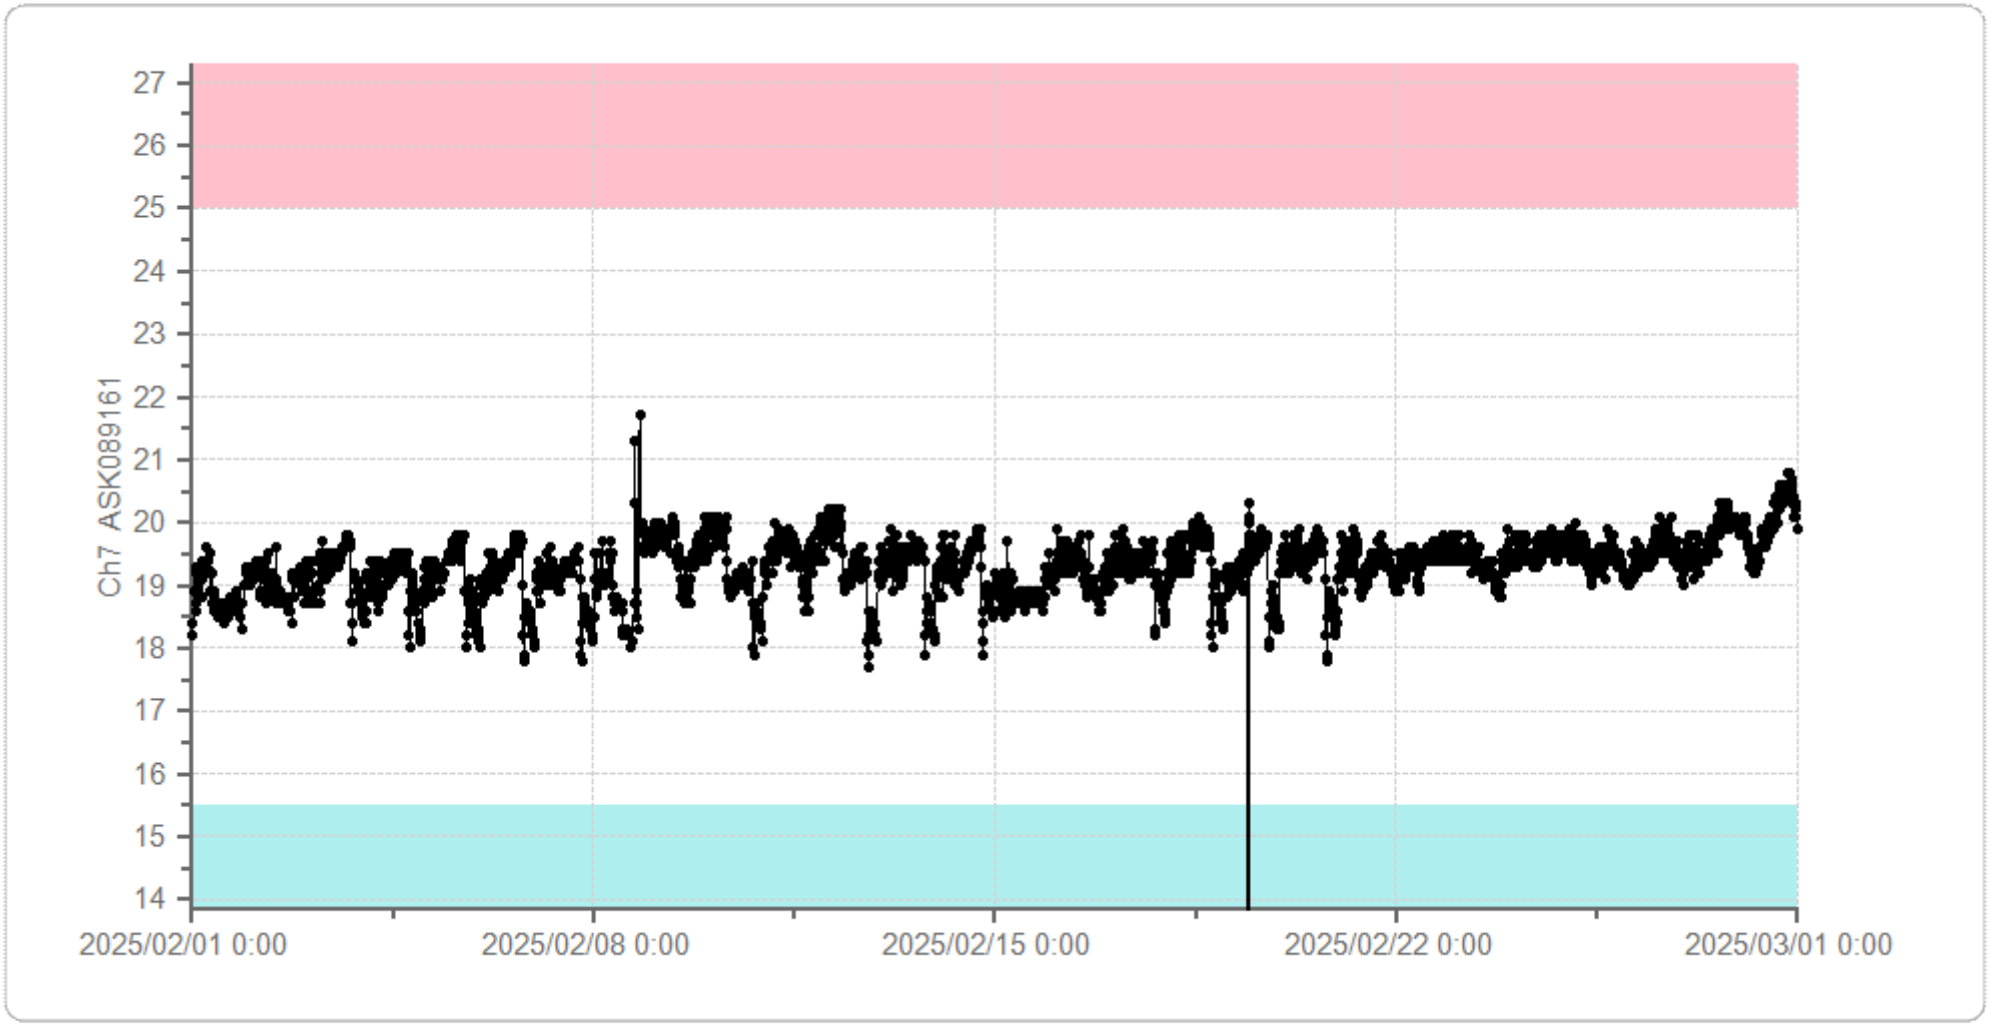

User: super
Print Time: 2025/03/04 8:45:02

薬冷1 (MPR-1014) - Ch1 KQL278302


2025/02/01 00:00 – 2025/03/01 00:00

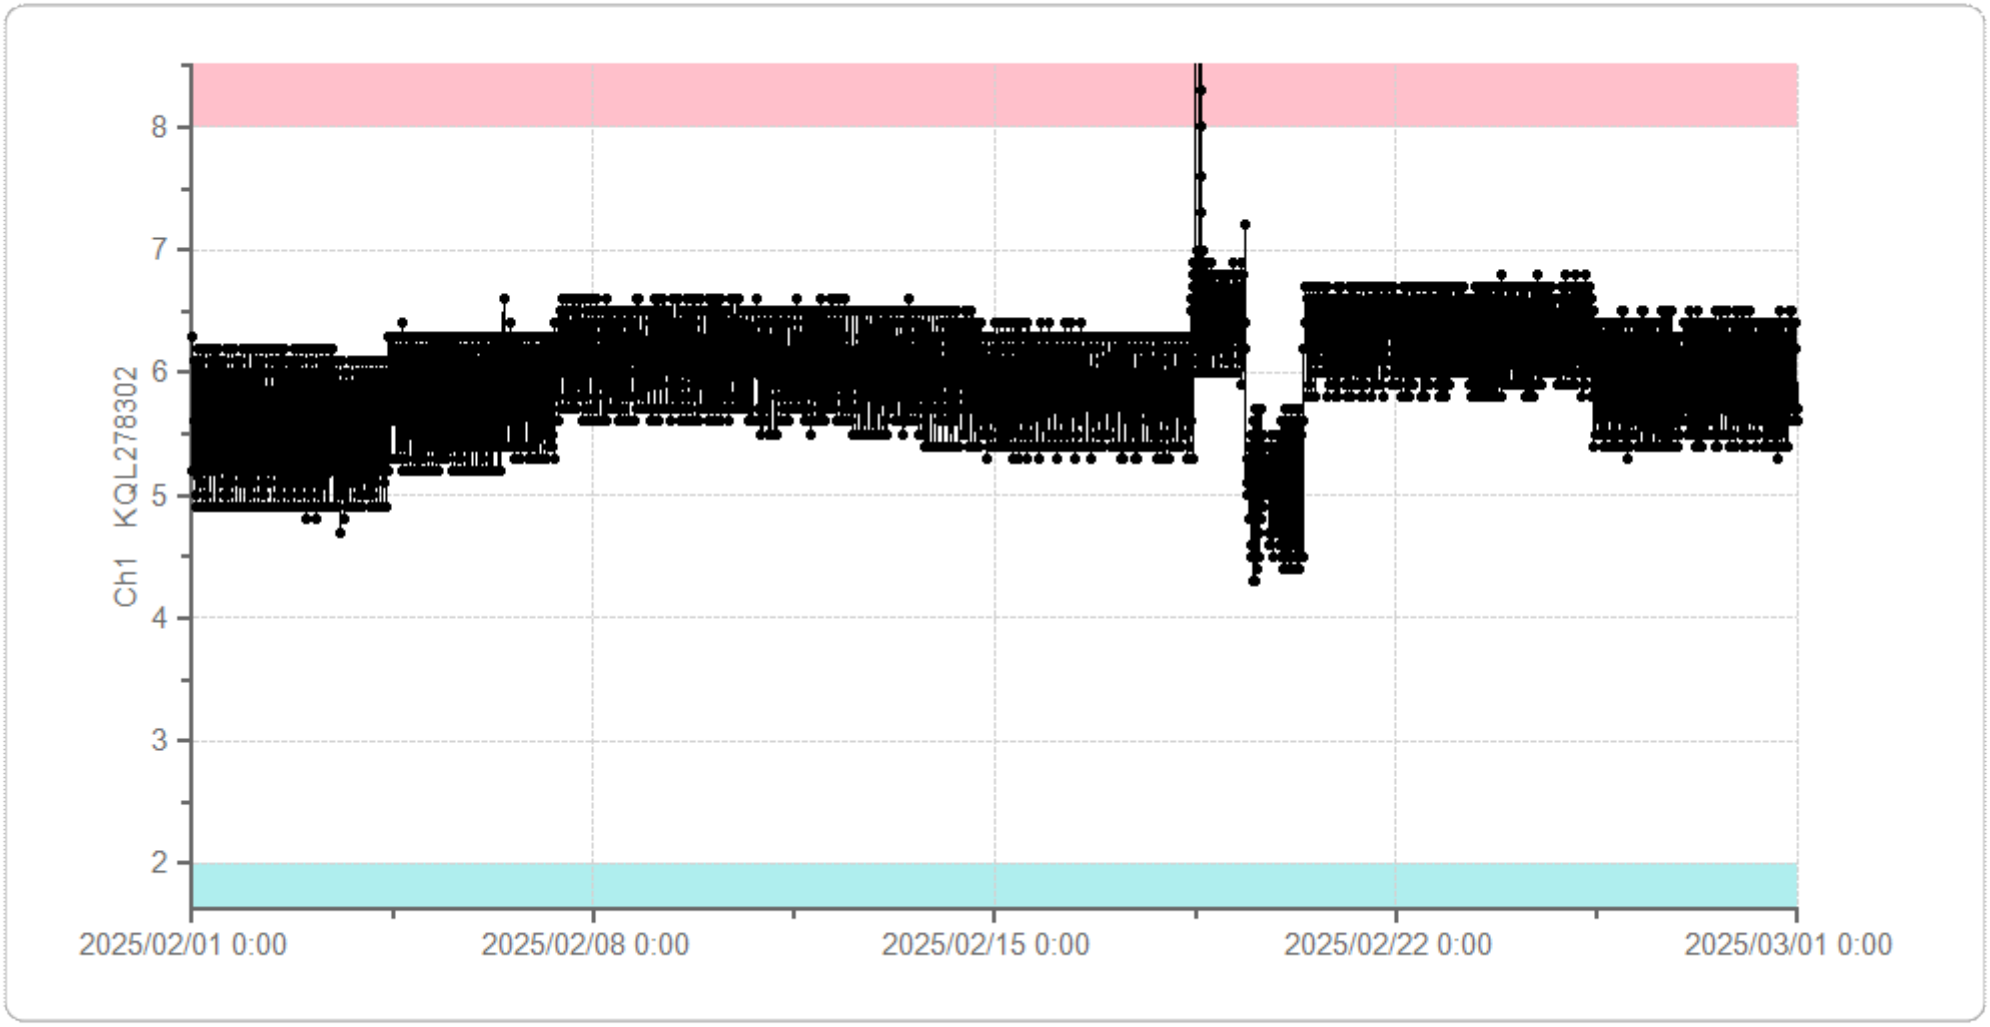

User: super
Print Time: 2025/03/04 8:45:02


薬冷2 (MPR-414F 上) - Ch2 KQL278301

2025/02/01 00:00 – 2025/03/01 00:00

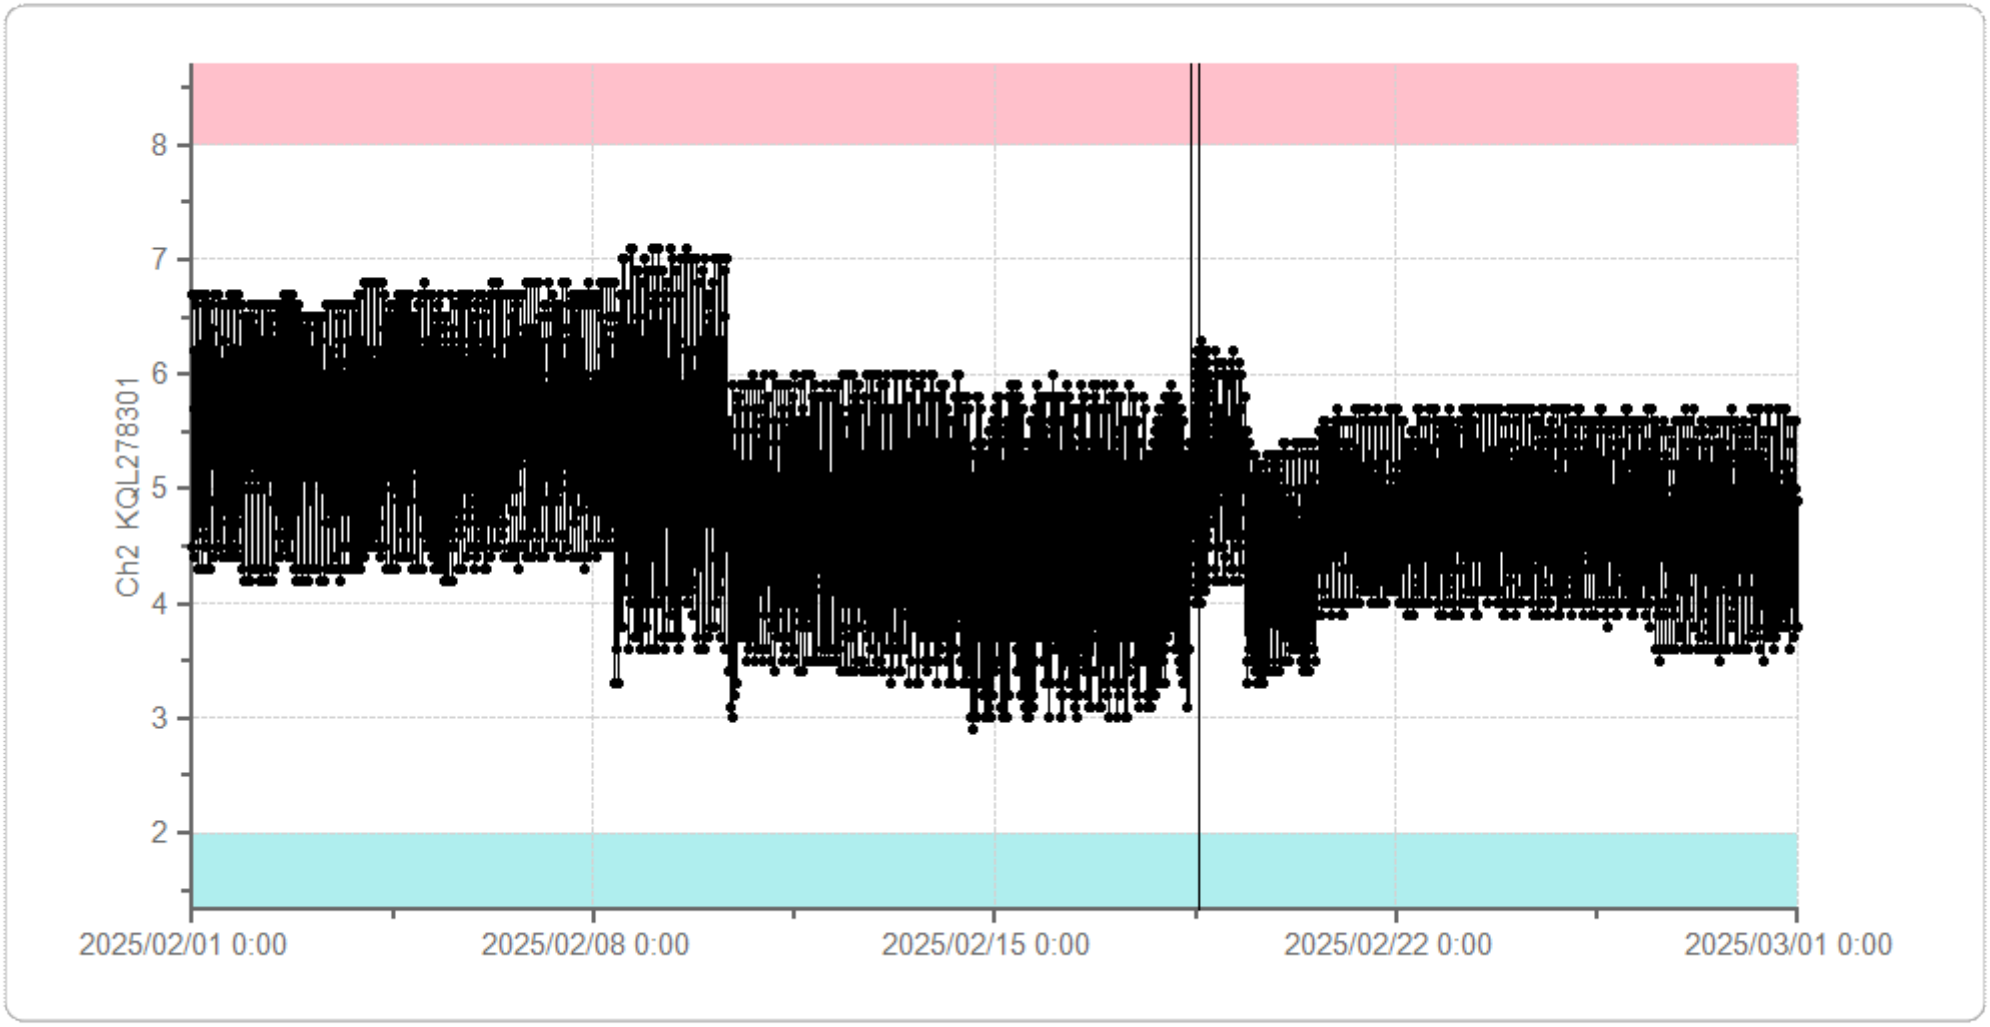

Graph Display


User: super
Print Time: 2025/03/04 8:51:46

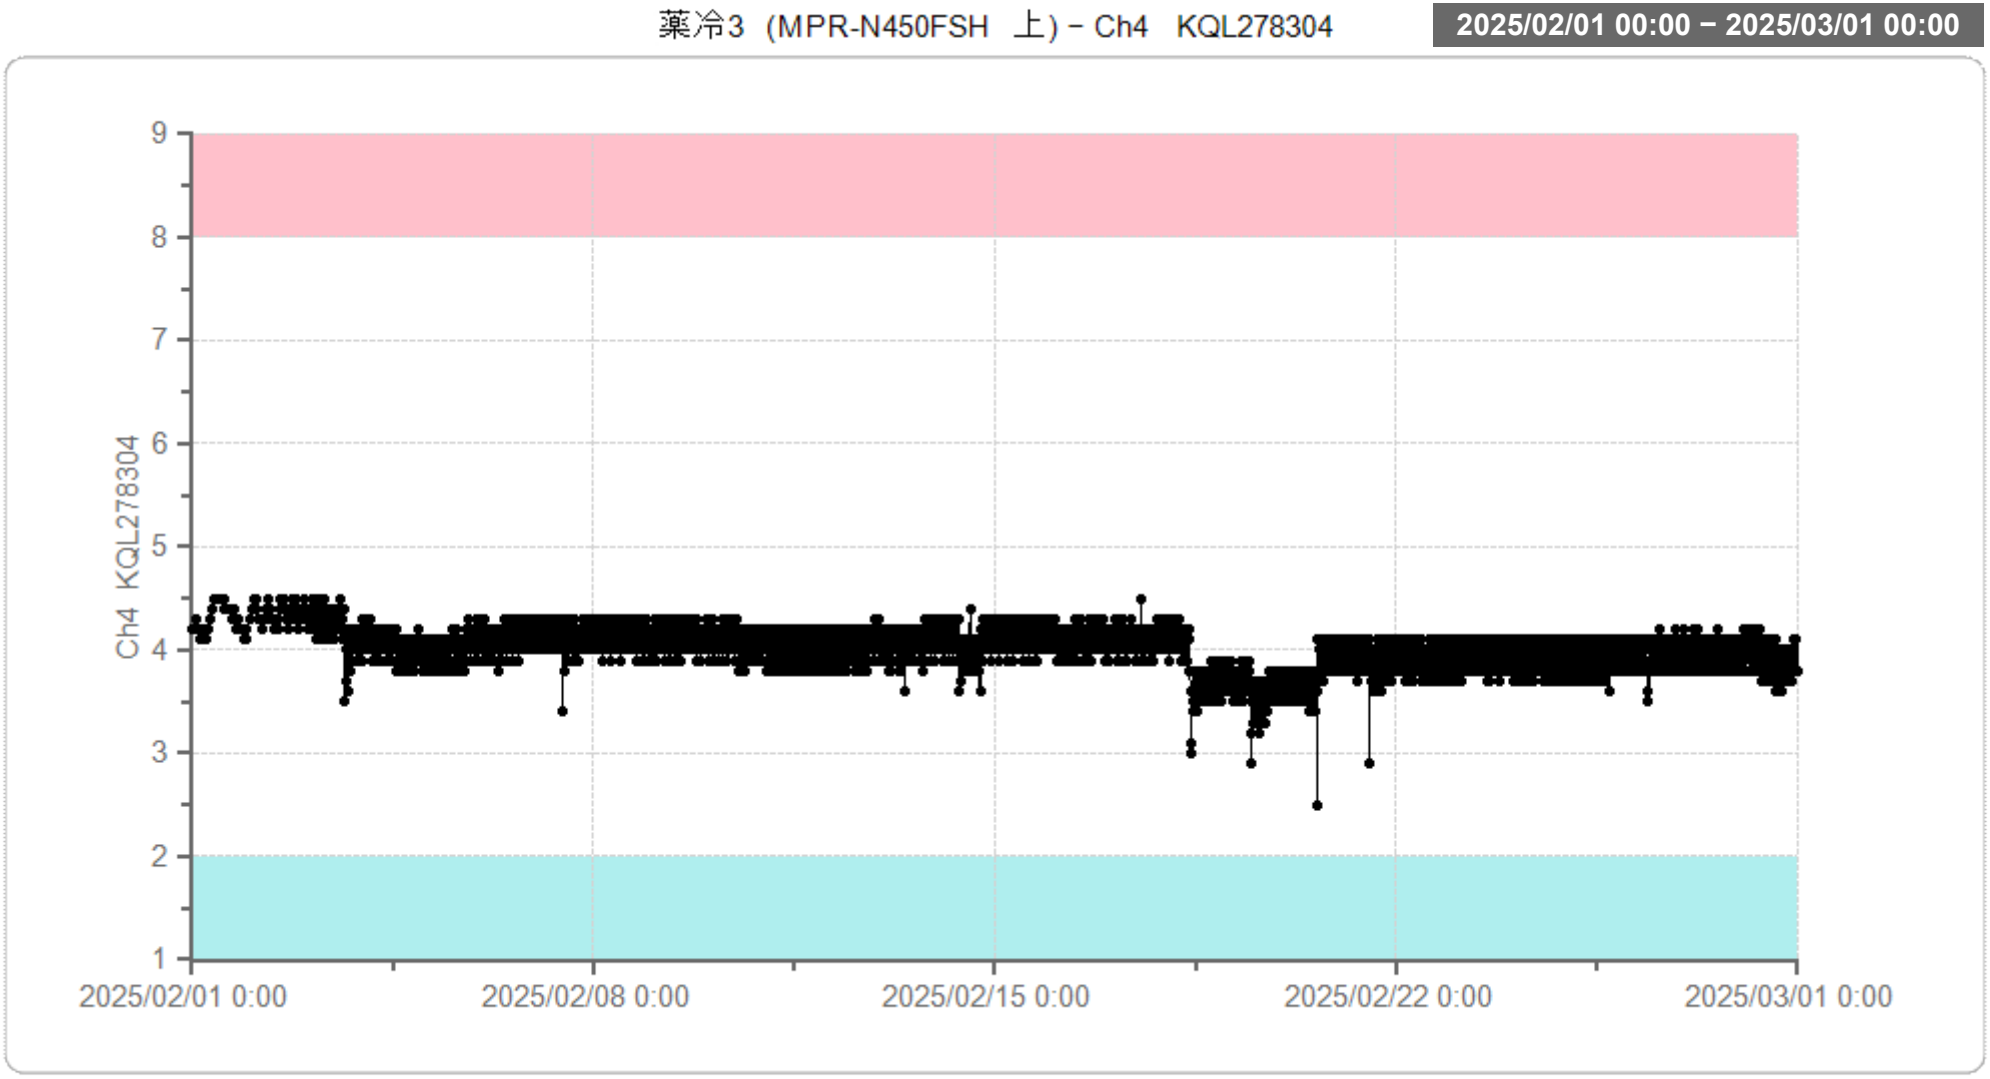

User: super
Print Time: 2025/03/04 8:51:46

薬冷4 (MPR-1411-PJ) - Ch6 KQL278308


2025/02/01 00:00 – 2025/03/01 00:00

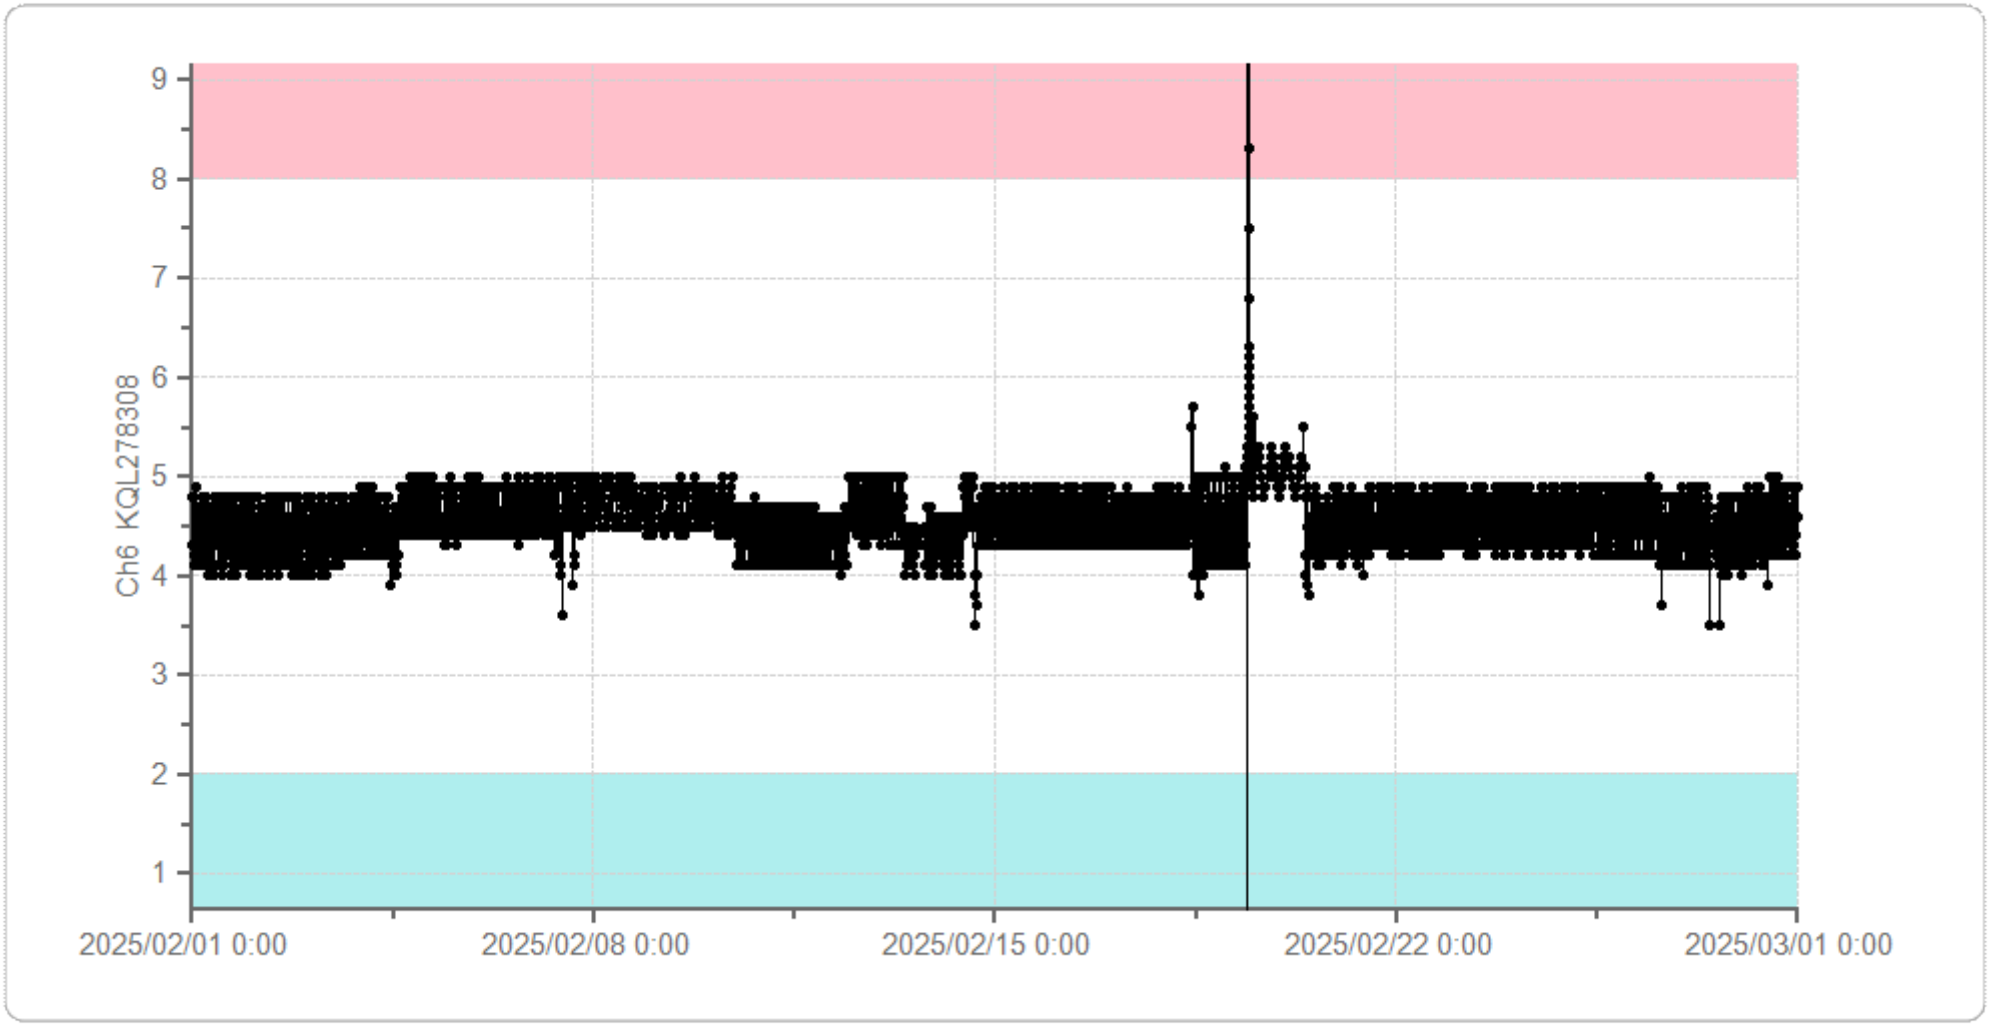


User: super
Print Time: 2025/03/04 8:51:46

薬冷5 （MPR-N200H）- Ch8 KQL278310


2025/02/01 00:00 – 2025/03/01 00:00

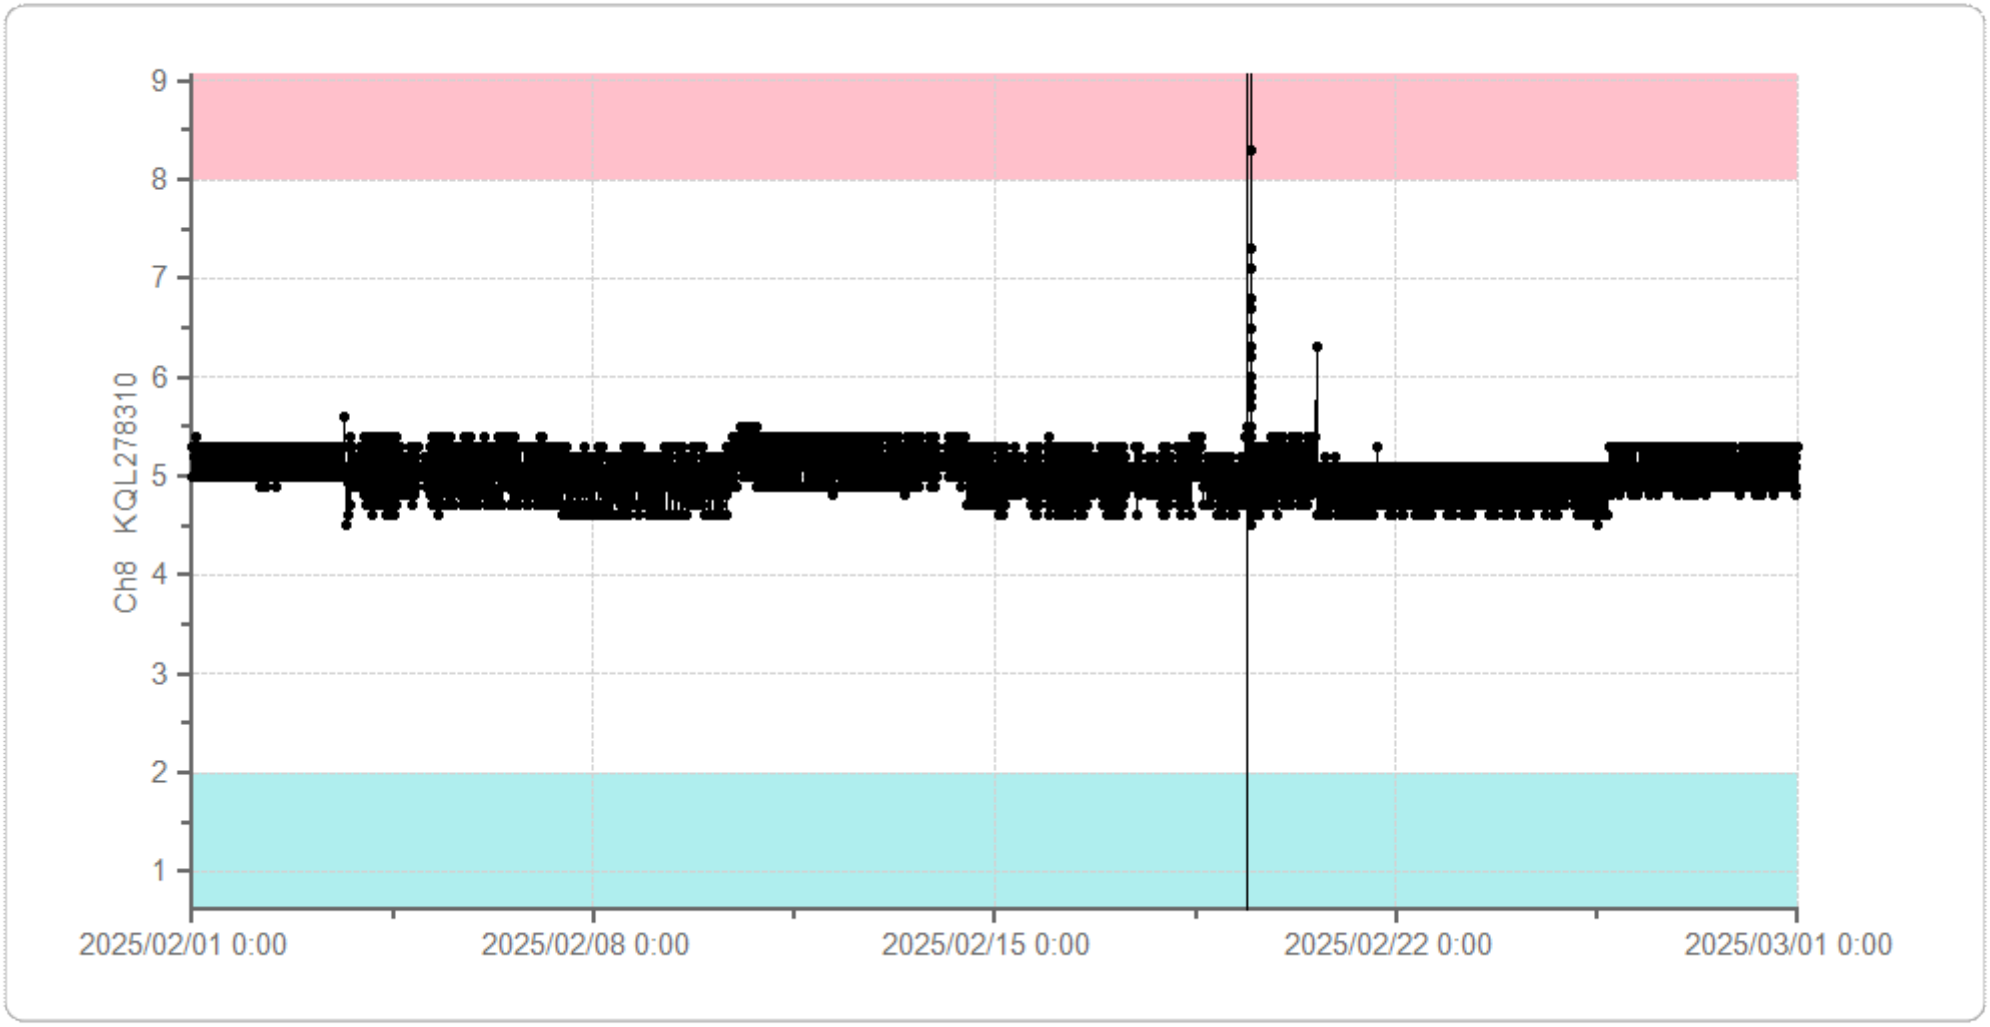

User: super
Print Time: 2025/03/04 8:51:46

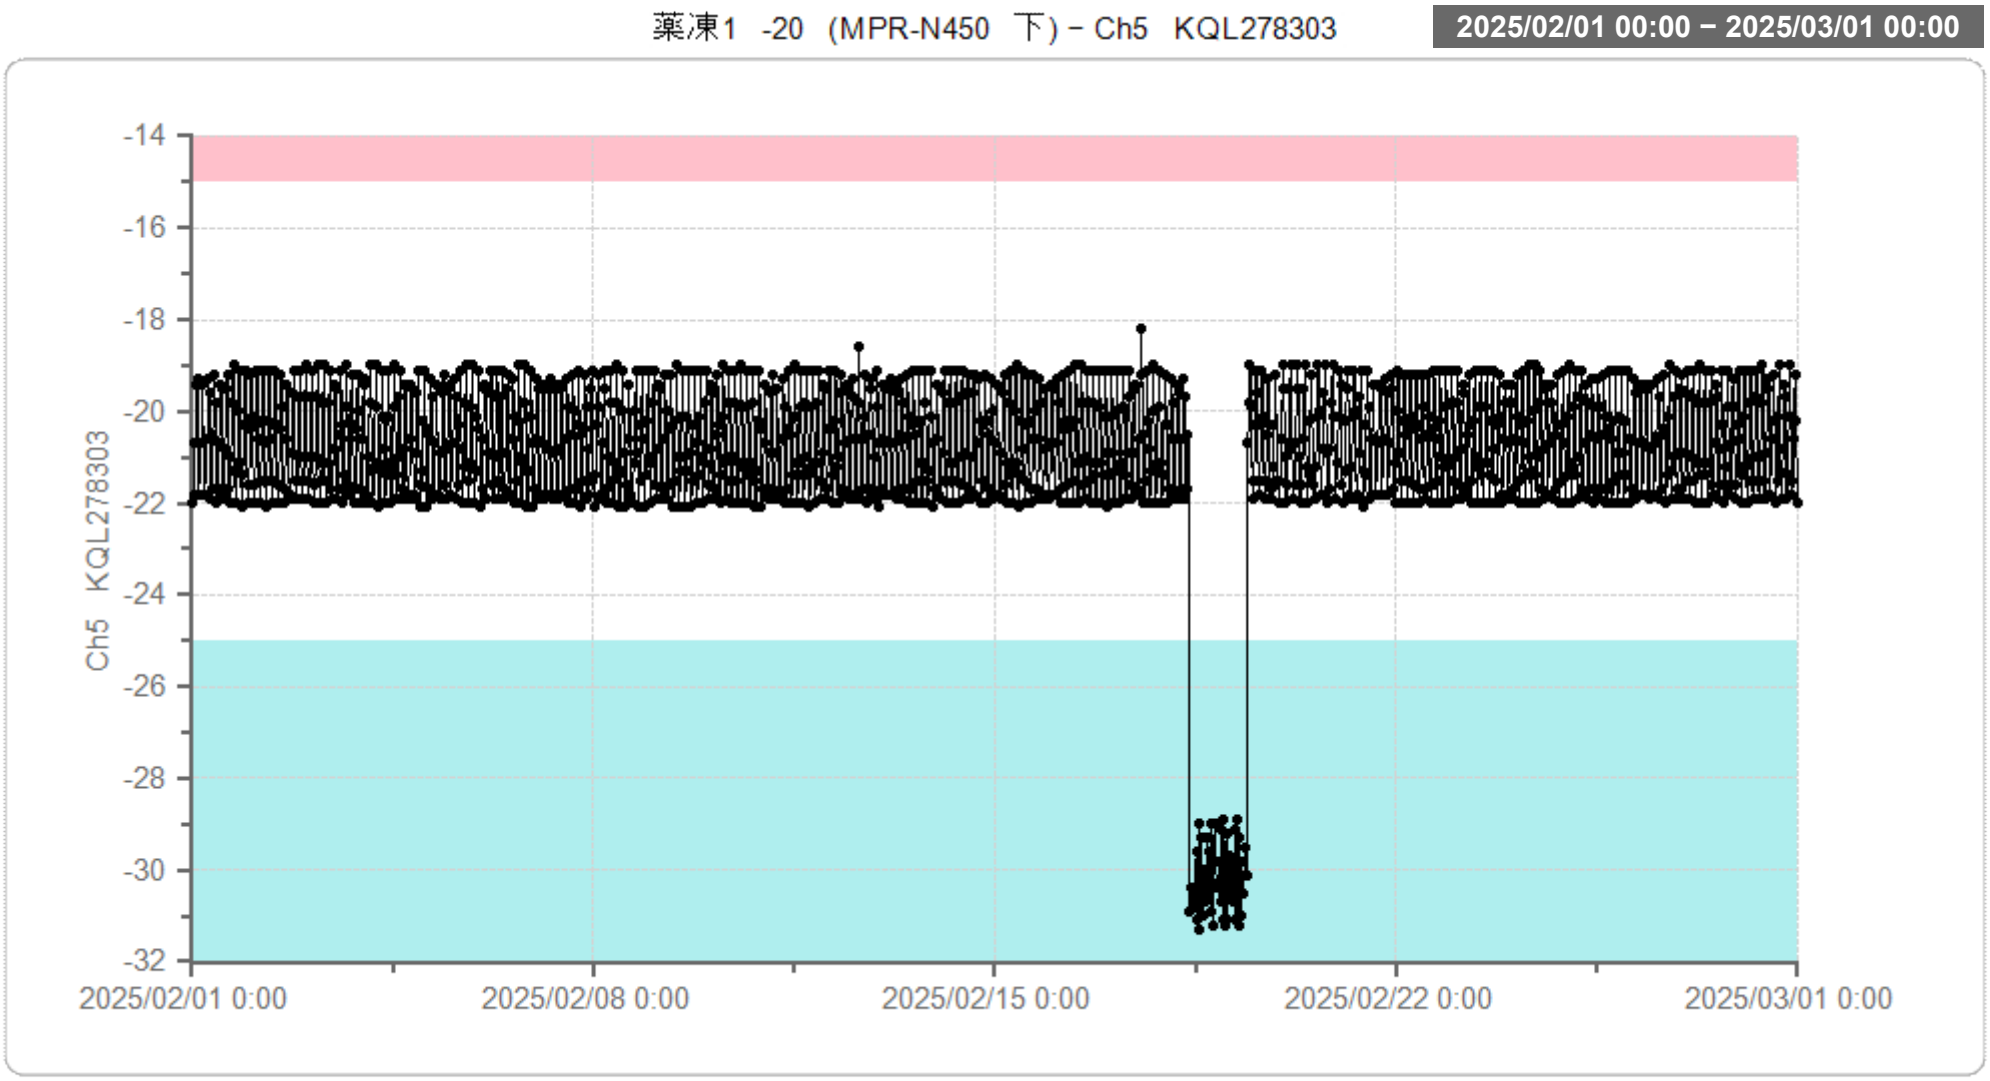


User: super
Print Time: 2025/03/04 8:45:02

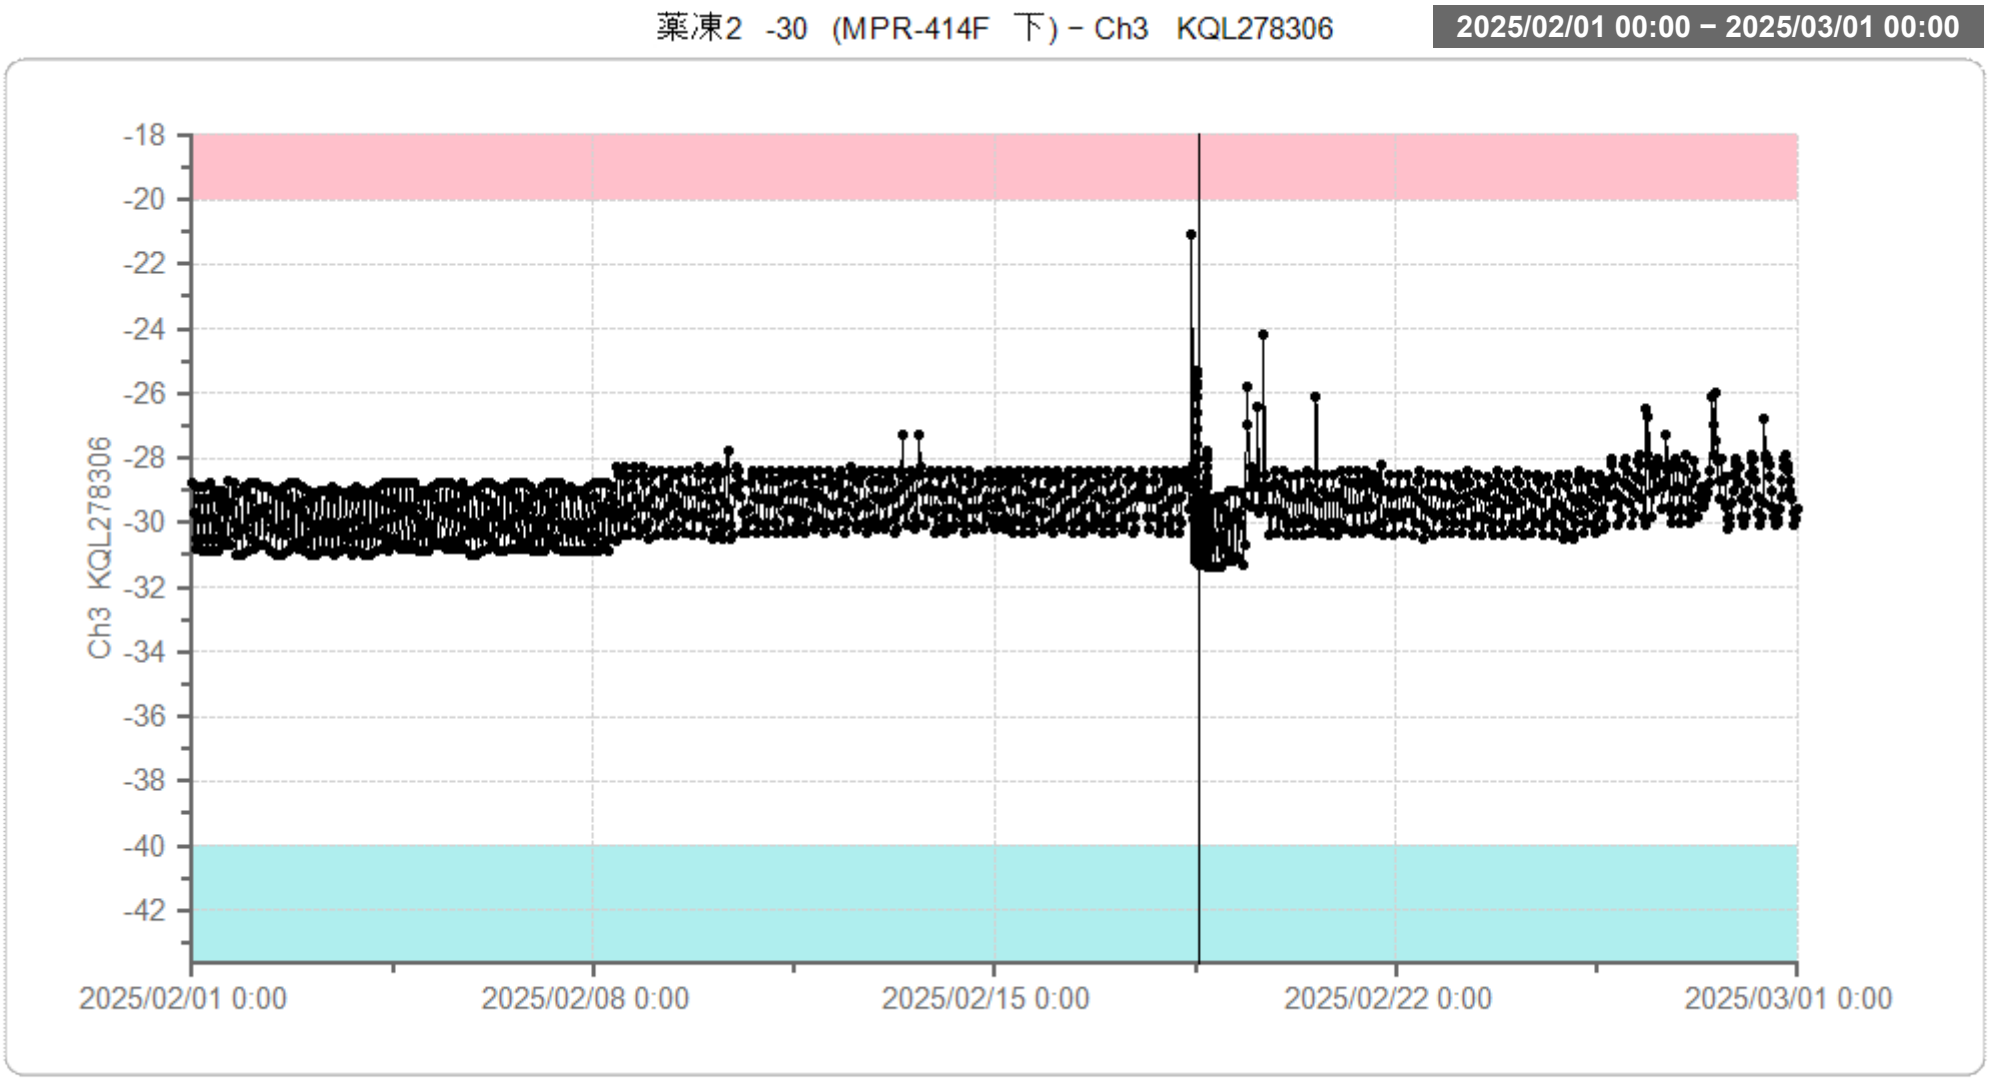


Graph Display

User: super
Print Time: 2025/03/04 9:42:35

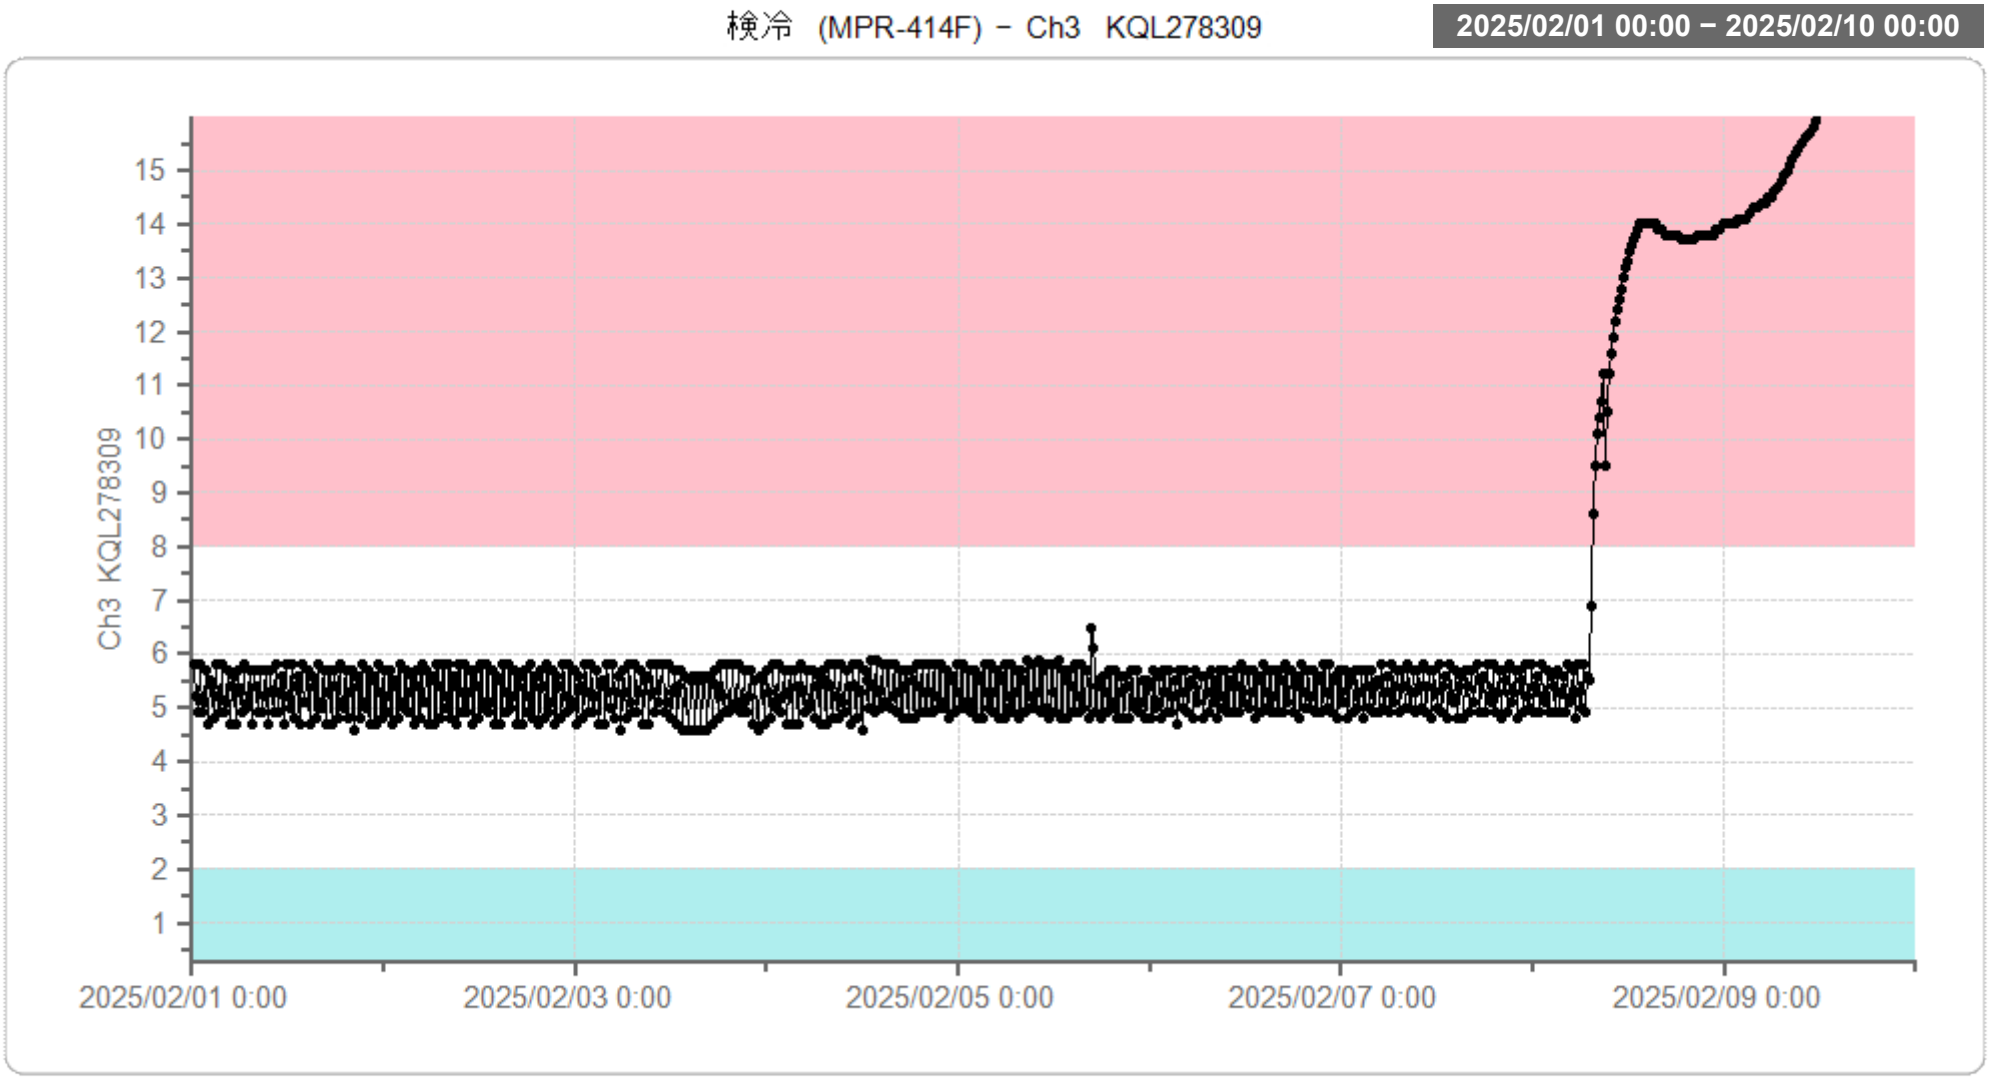

Graph Display


User: super
Print Time: 2025/03/04 8:45:02

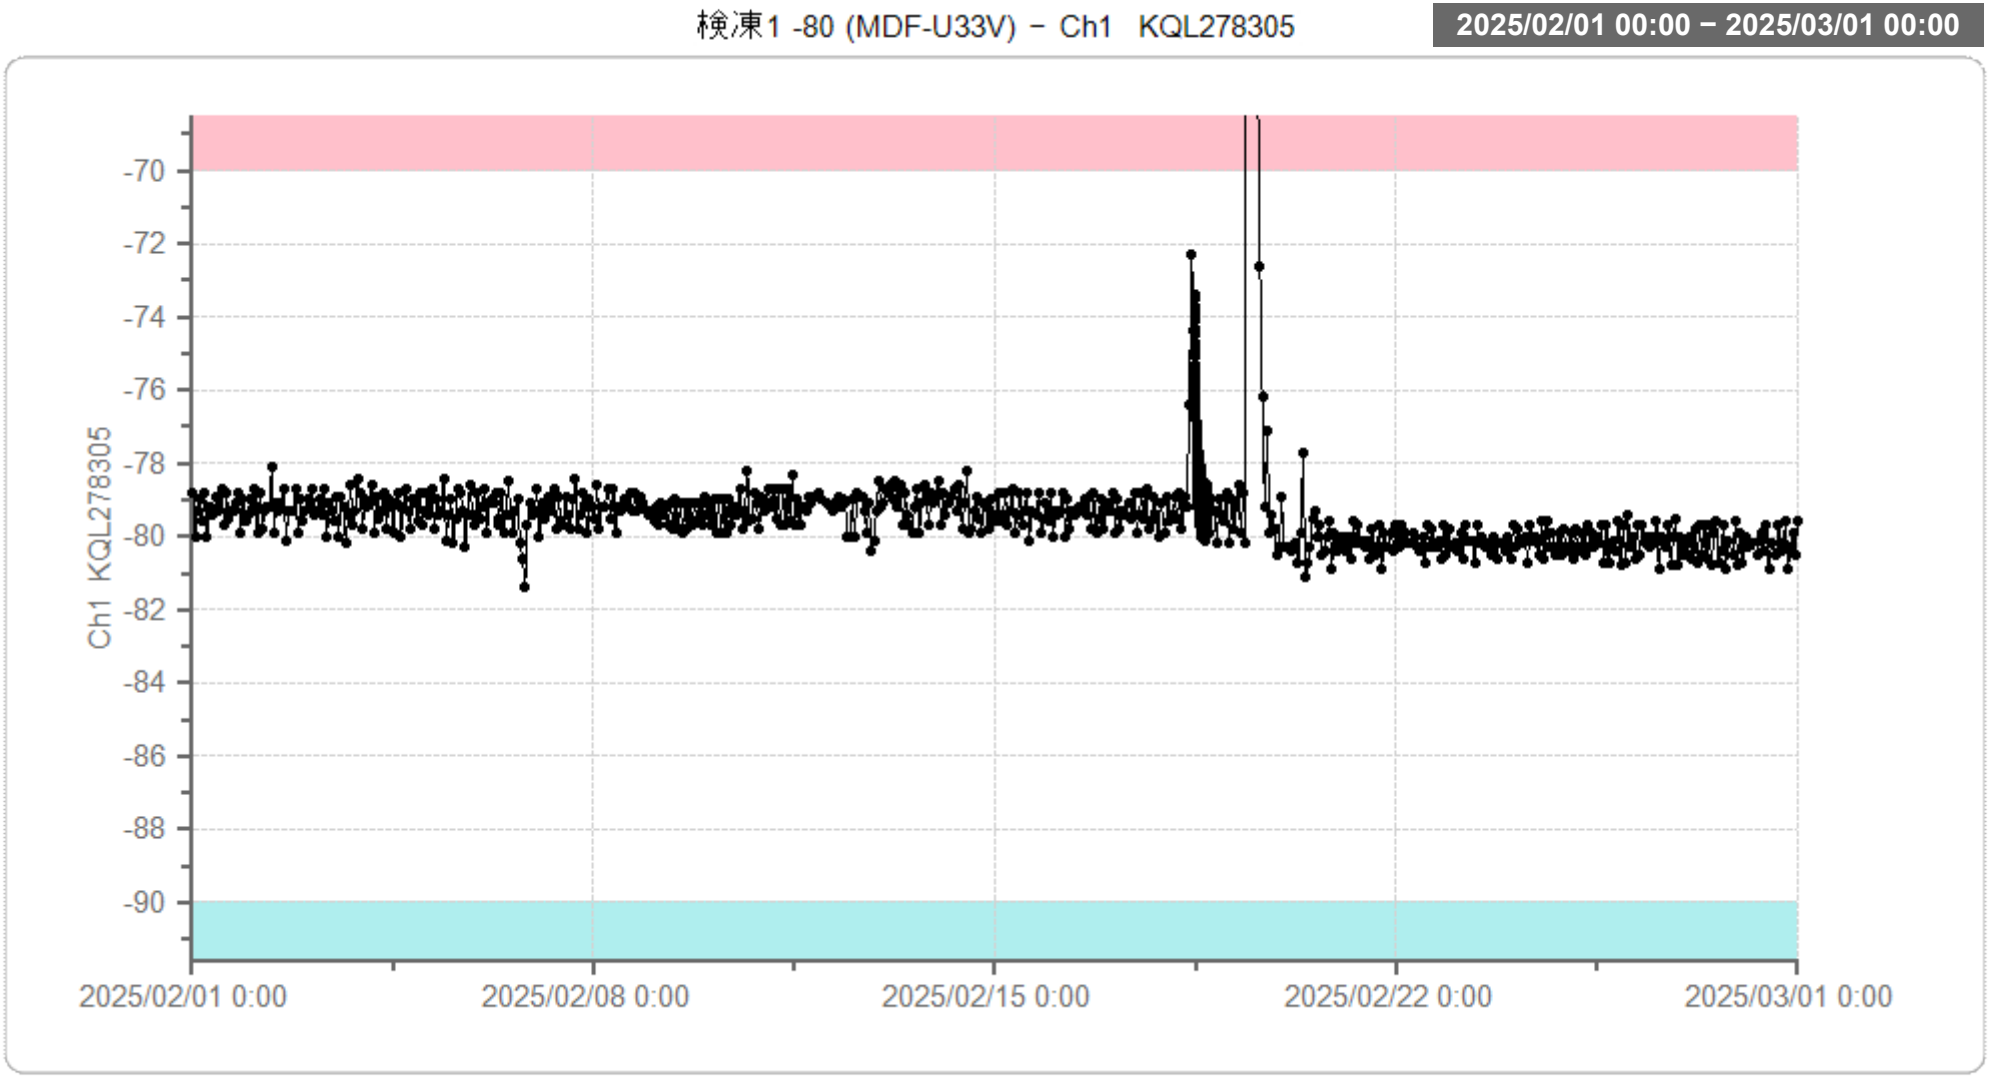

User: super
Print Time: 2025/03/04 8:45:02

検凍2 -80 (MDF-DC202) - Ch2 KQL278307

2025/02/01 00:00 – 2025/03/01 00:00

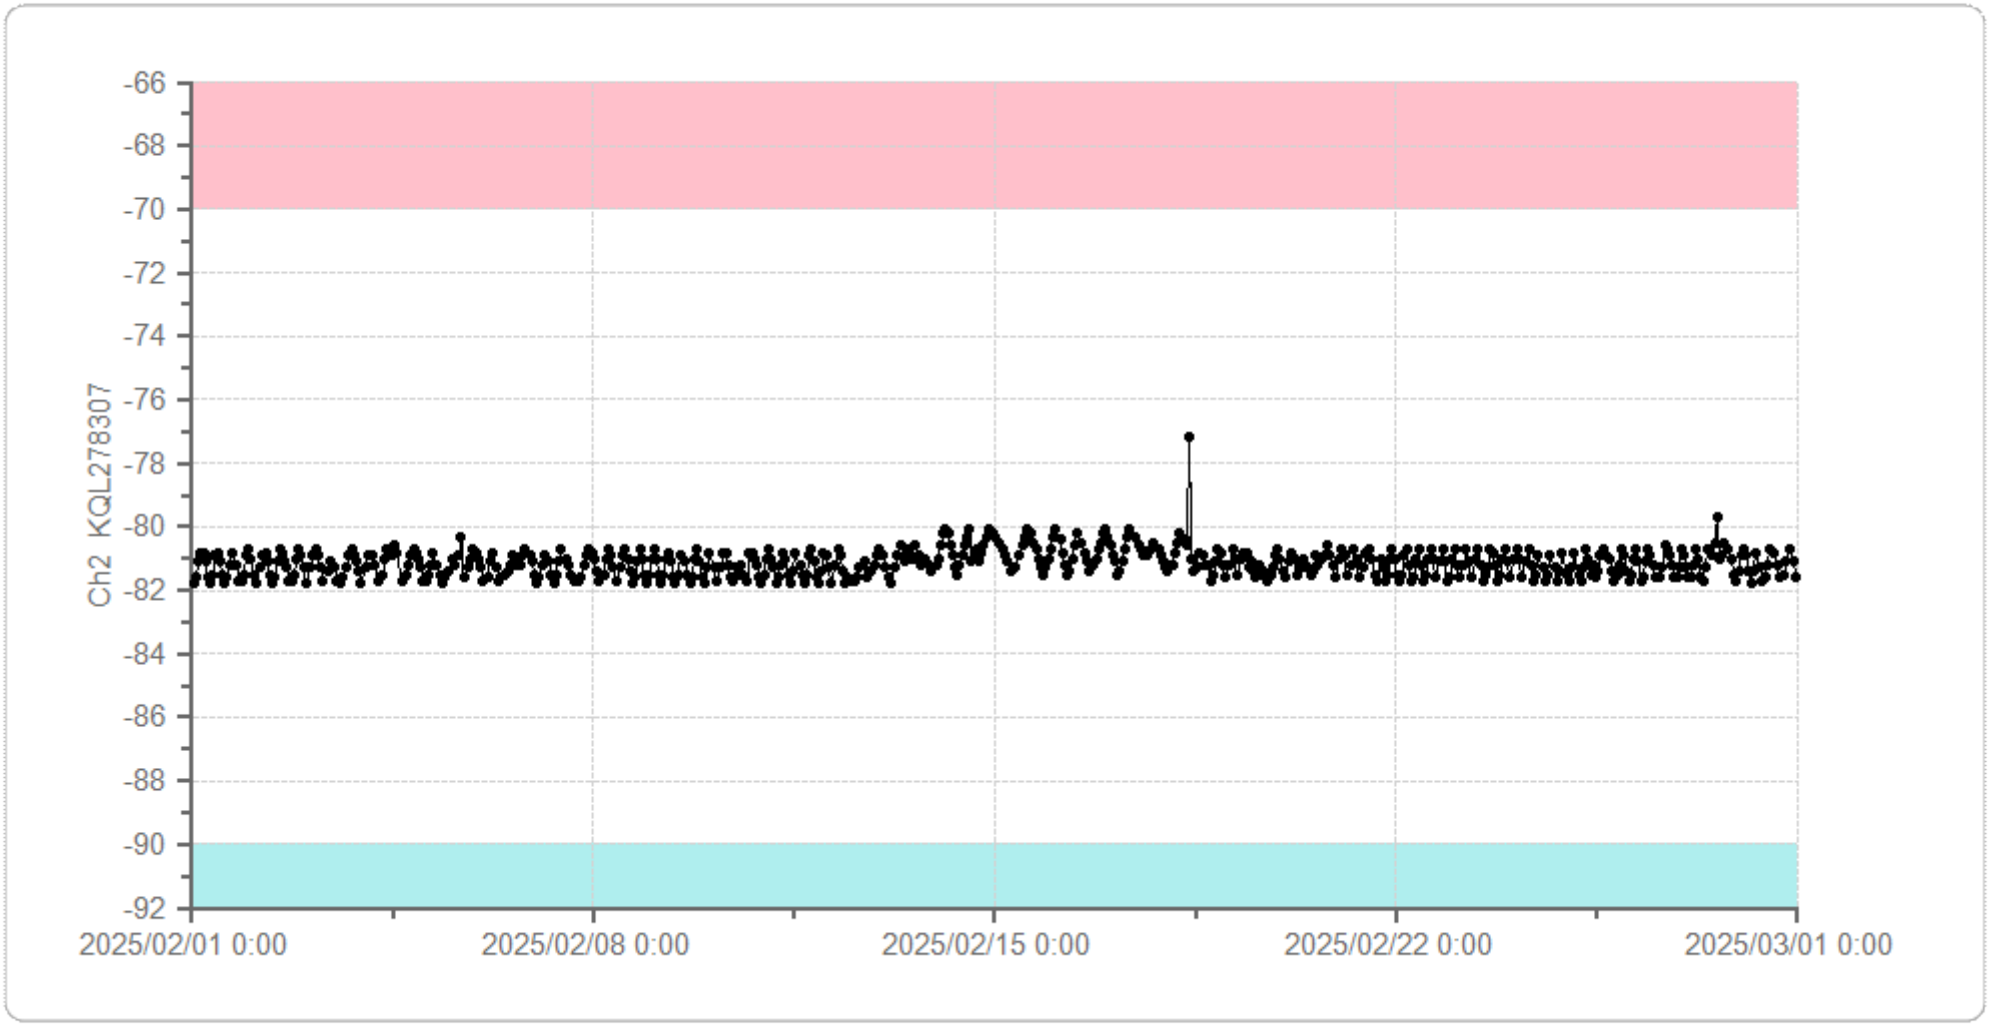

Graph Display

User: super
Print Time: 2025/03/04 9:57:55

検凍3 -30 (MPR-414F) - Ch4 ASK116771

2025/02/01 00:00 – 2025/02/09 00:00

