
User: super
Print Time: 2025/08/01 11:28:53

室内温度 - Ch7 ASK089161


2025/07/01 00:00 – 2025/08/01 00:00

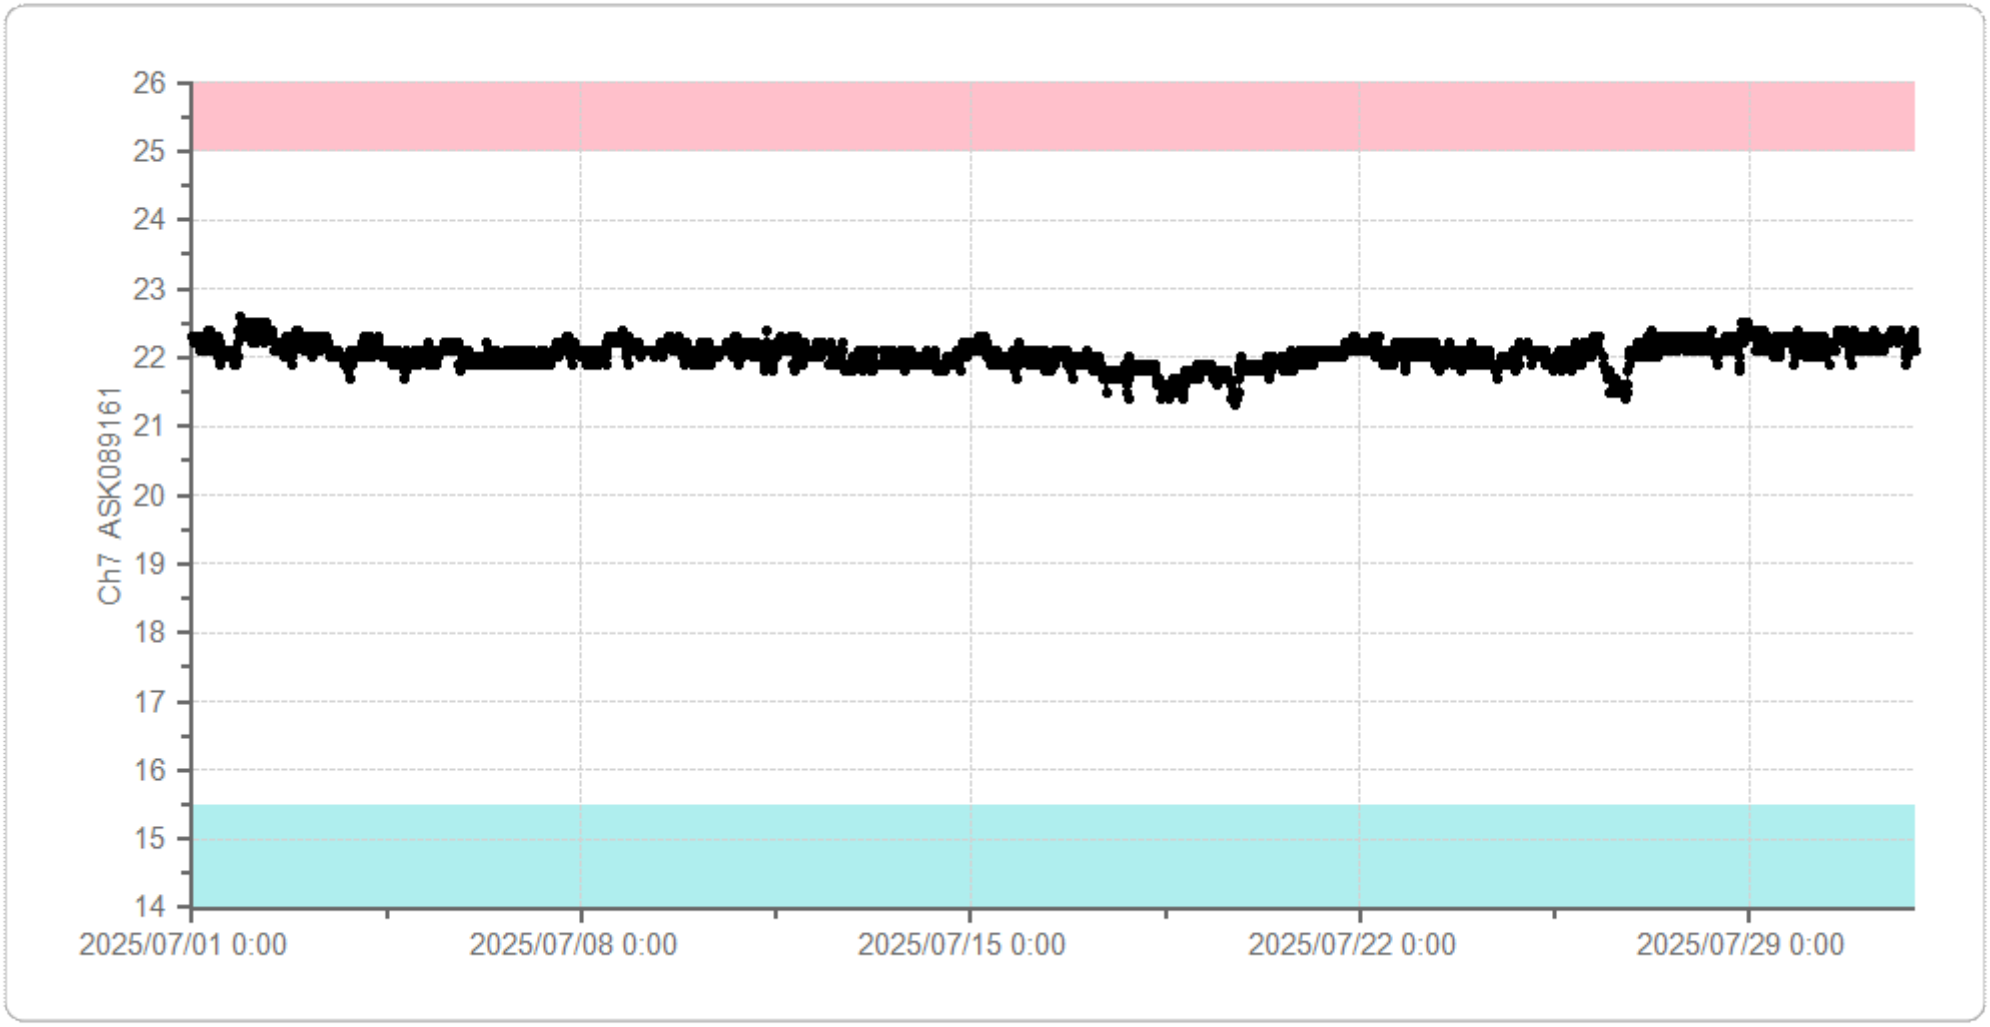

User: super
Print Time: 2025/08/01 11:25:32

薬冷1 (MPR-1014) - Ch1 KQL278302


2025/07/01 00:00 – 2025/08/01 00:00

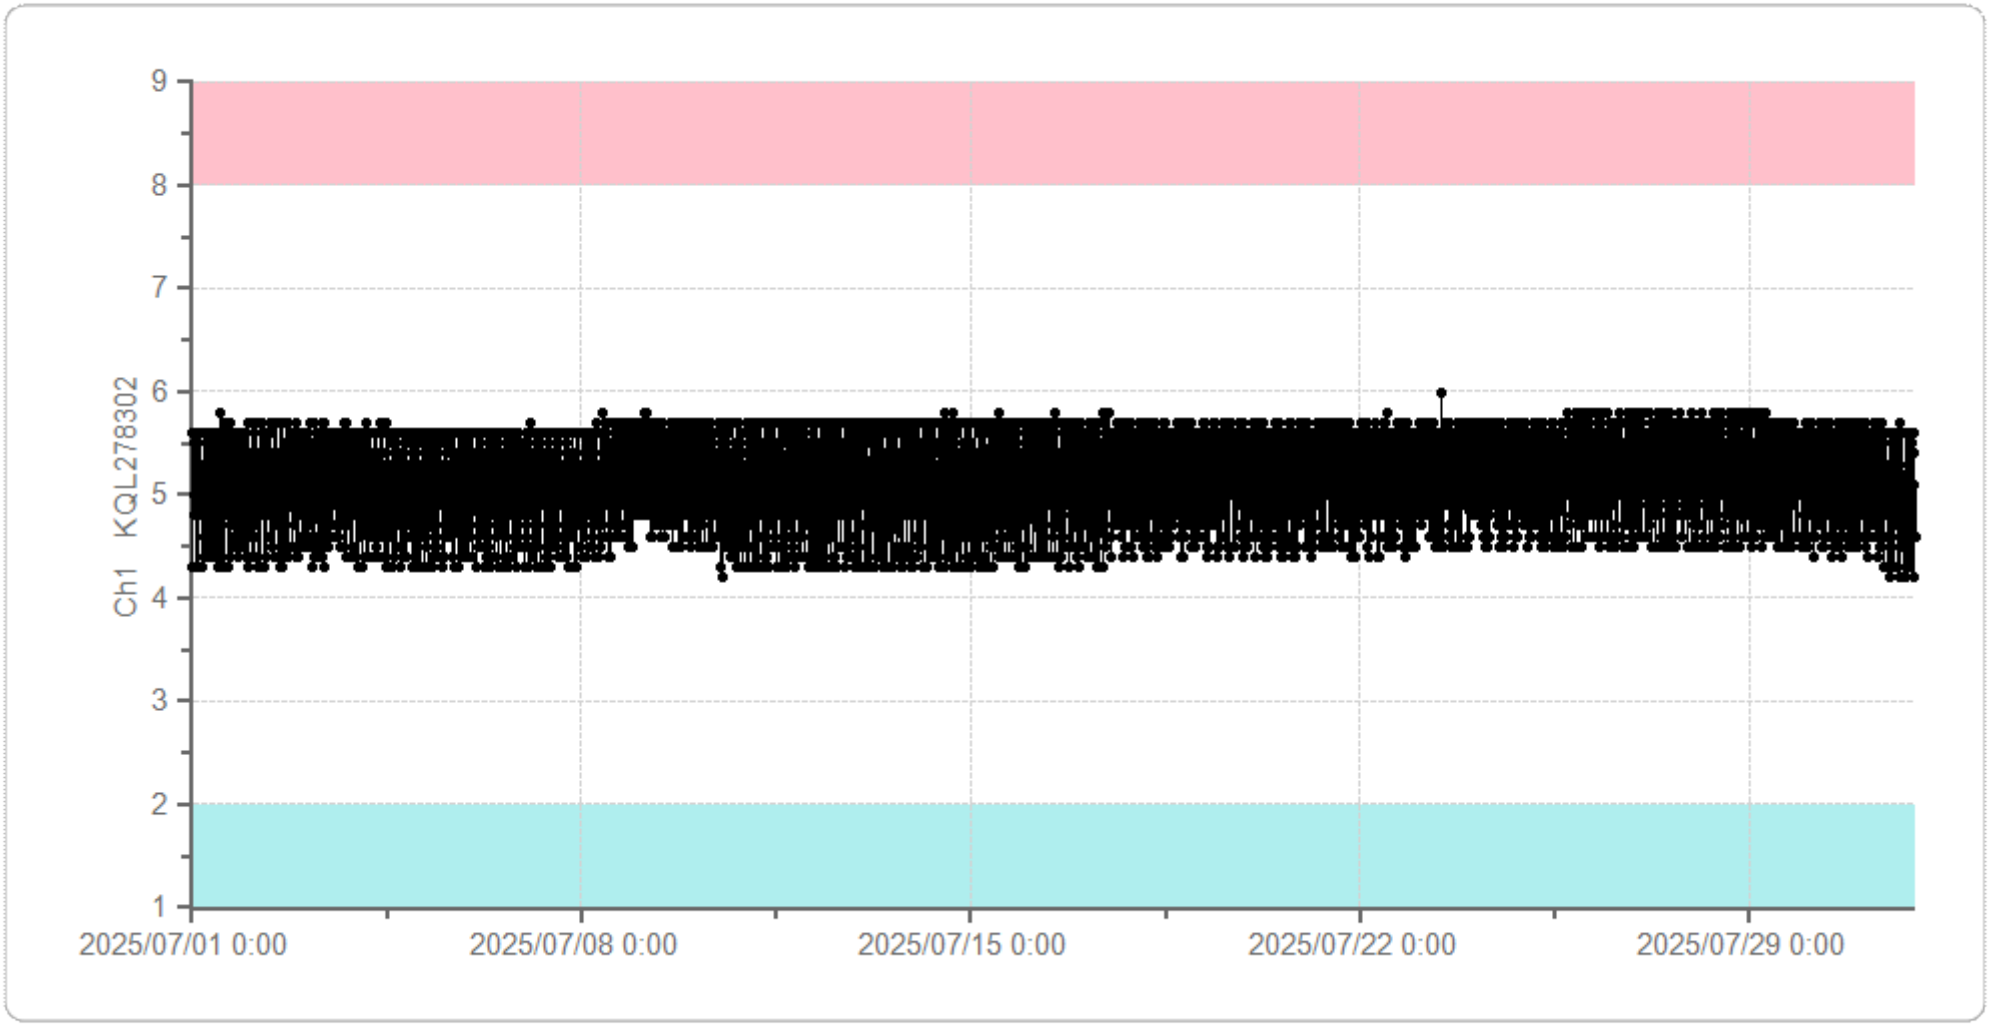

User: super
Print Time: 2025/08/01 11:25:32


薬冷2 (MPR-414F 上) - Ch2 KQL278301

2025/07/01 00:00 – 2025/08/01 00:00

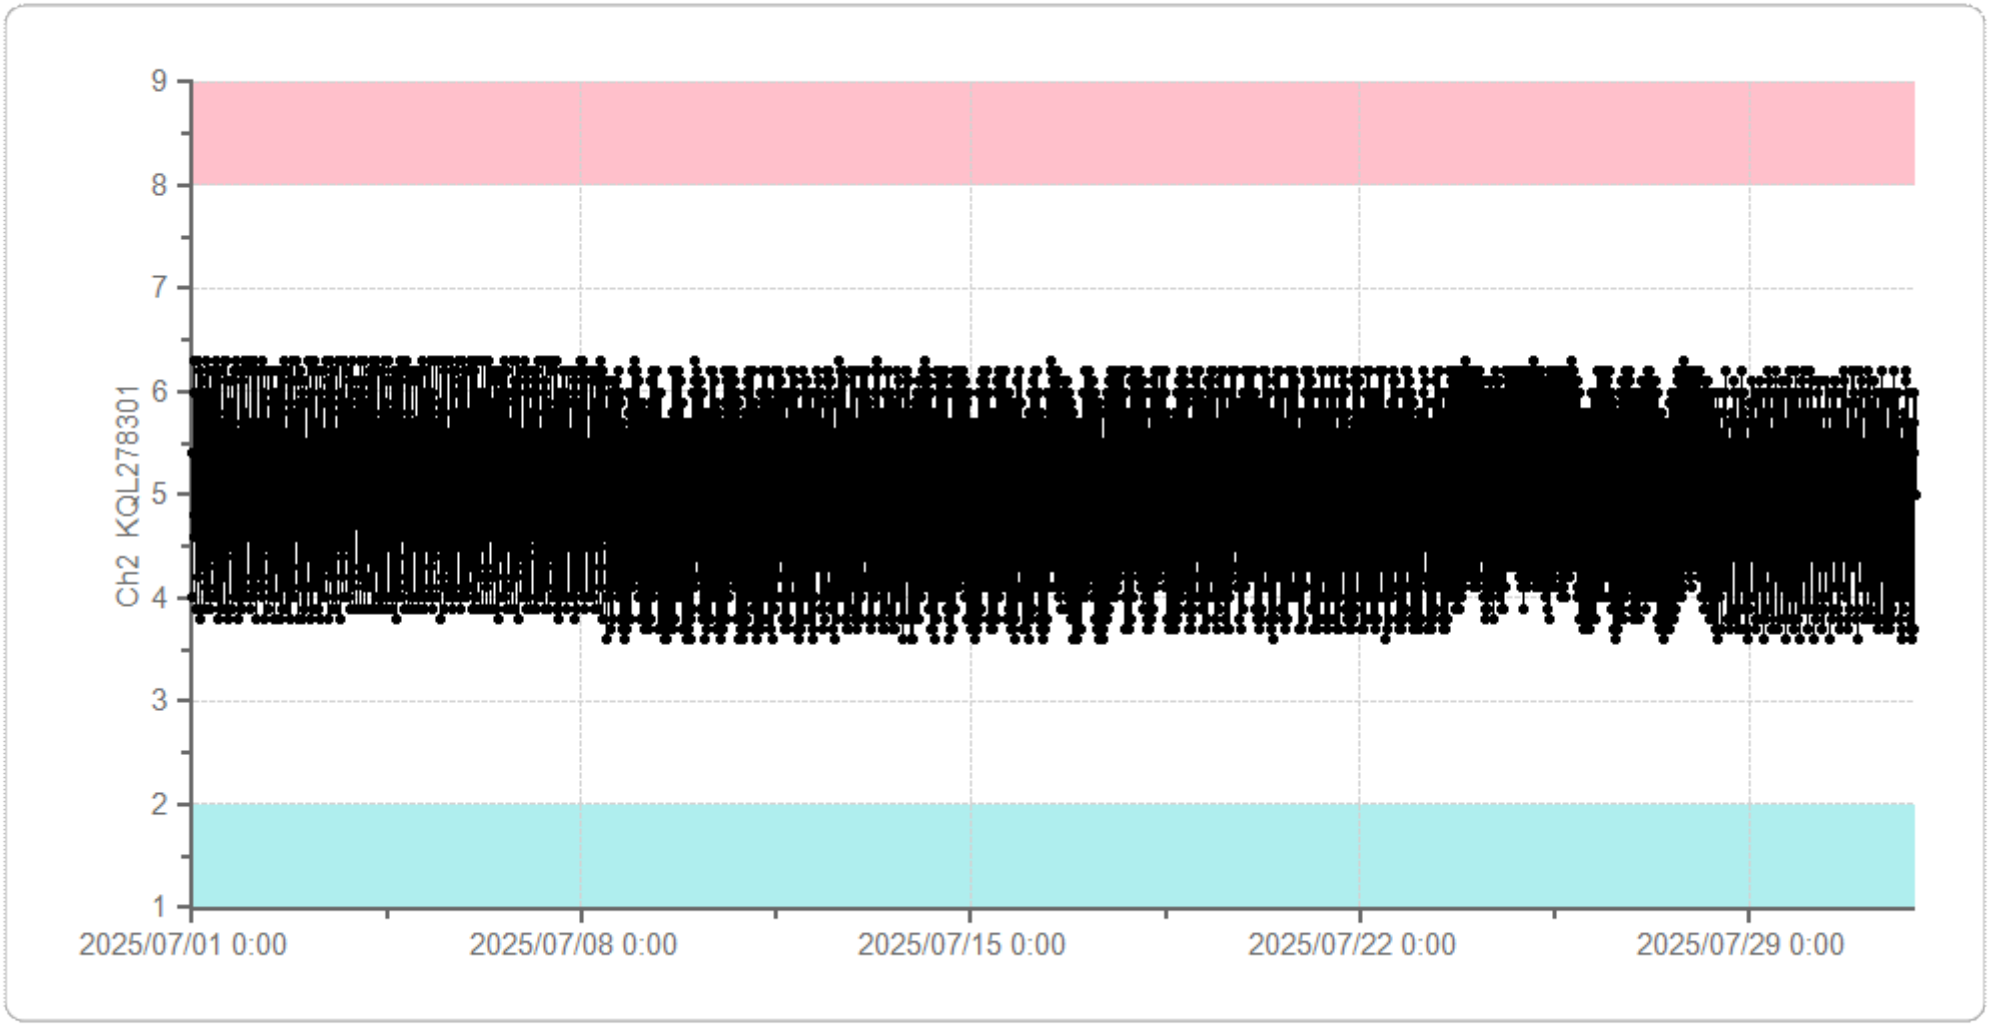

Graph Display


User: super
Print Time: 2025/08/01 11:28:53

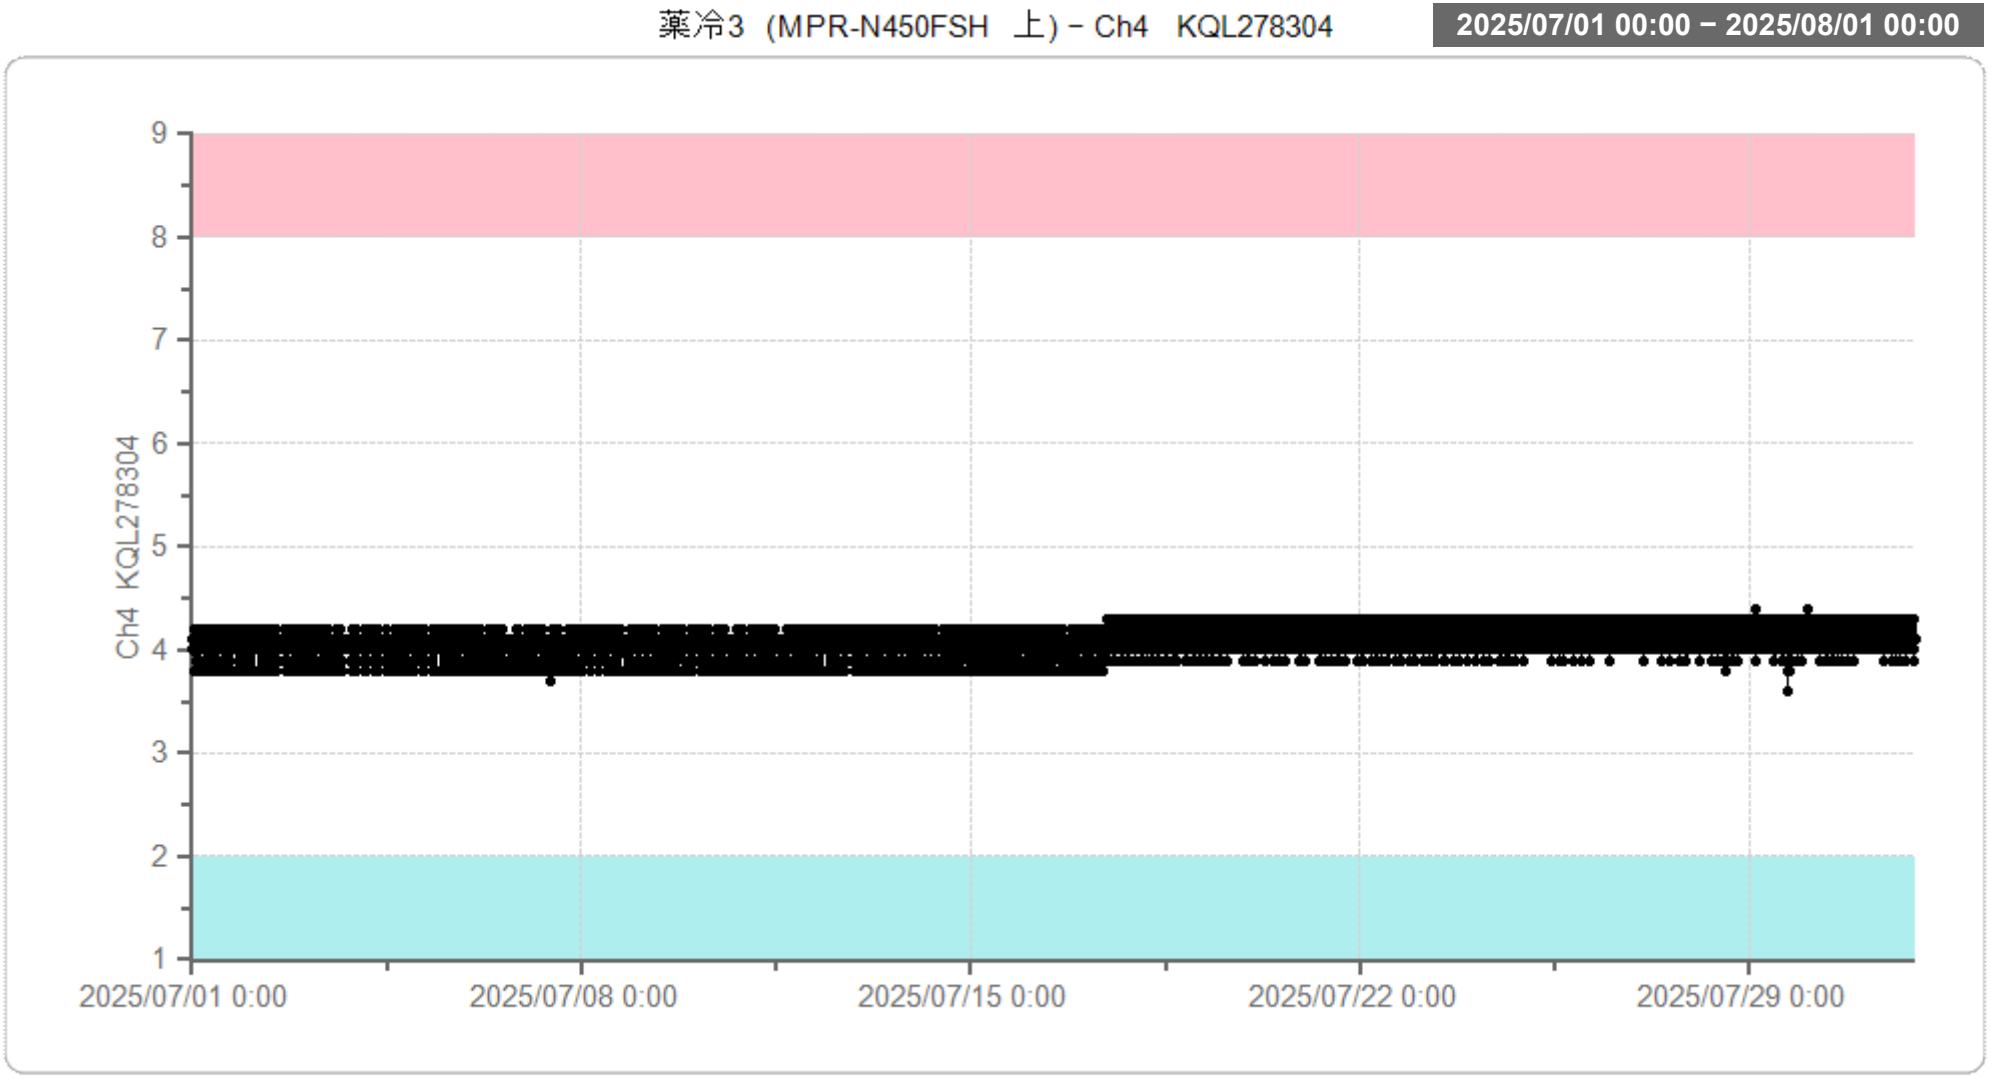


User: super
Print Time: 2025/08/01 11:28:53

薬冷4 (MPR-1411-PJ) - Ch6 KQL278308


2025/07/01 00:00 – 2025/08/01 00:00

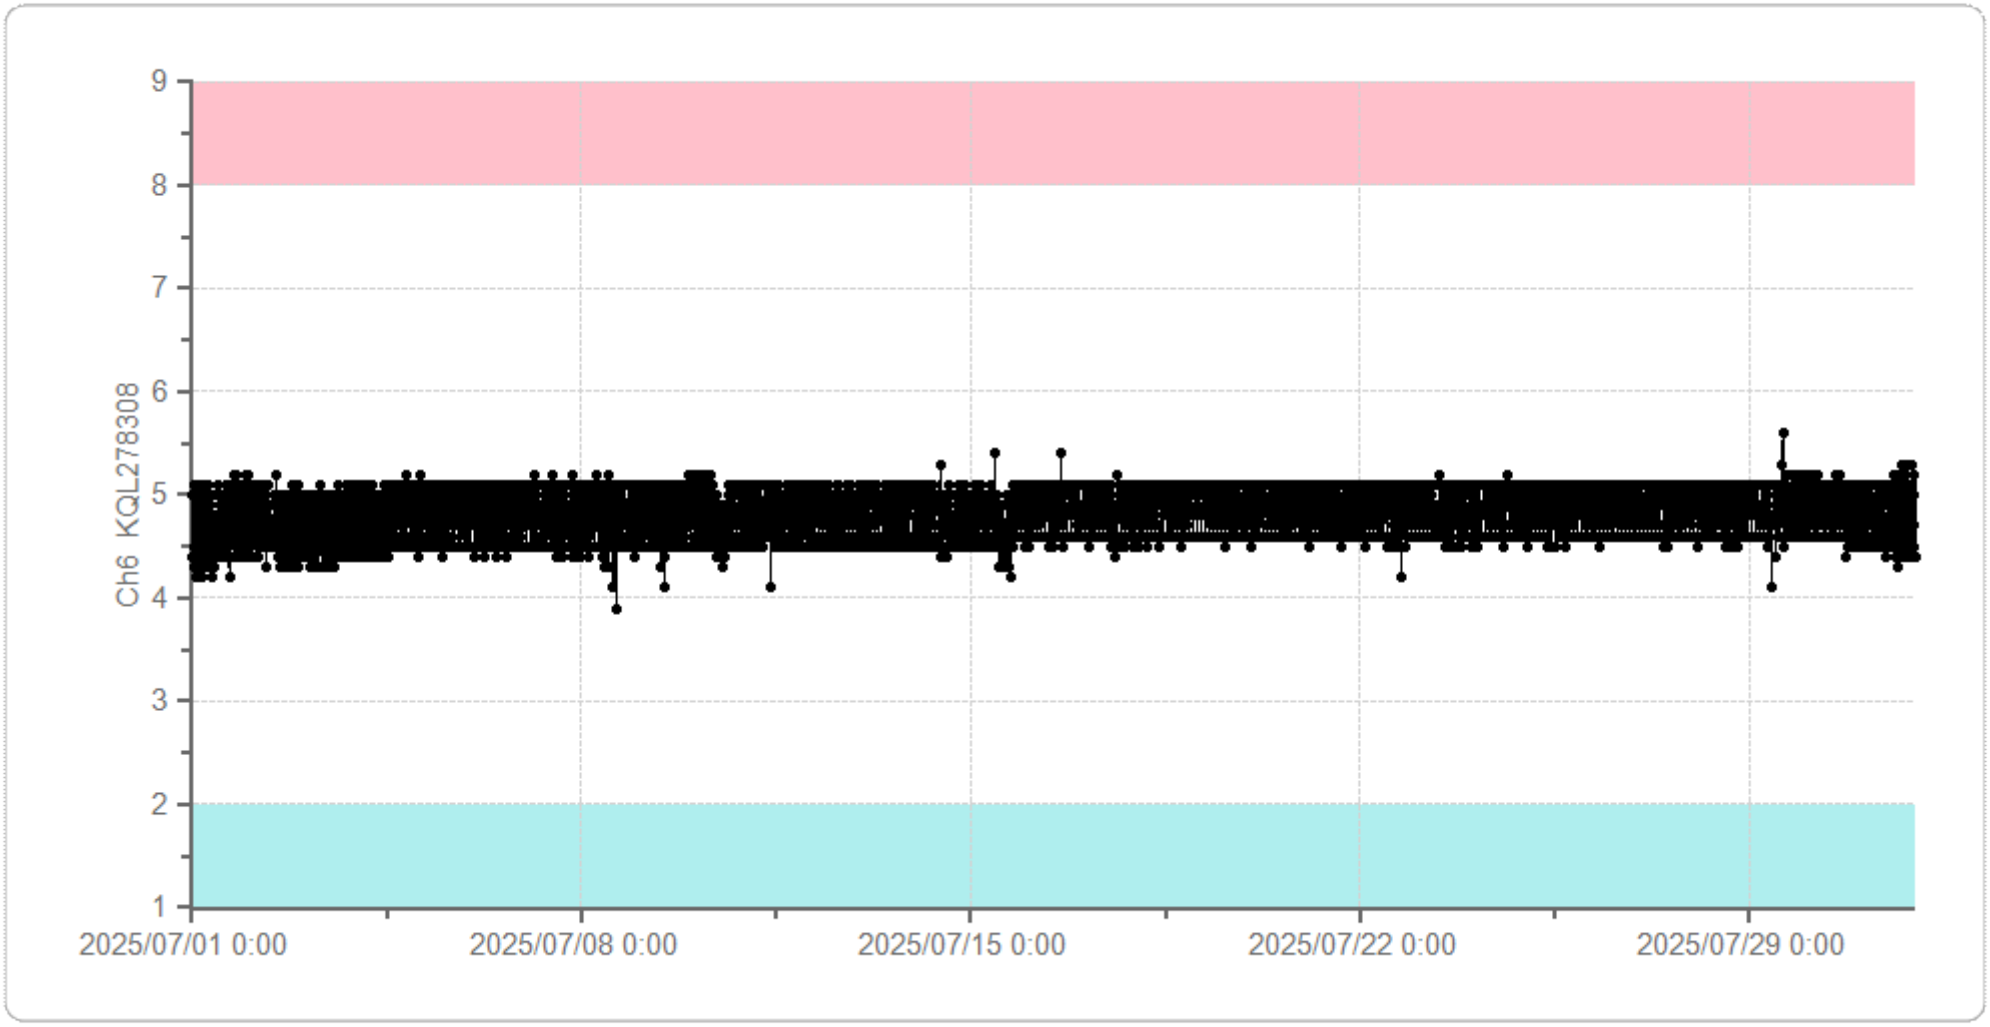

User: super
Print Time: 2025/08/01 11:28:53

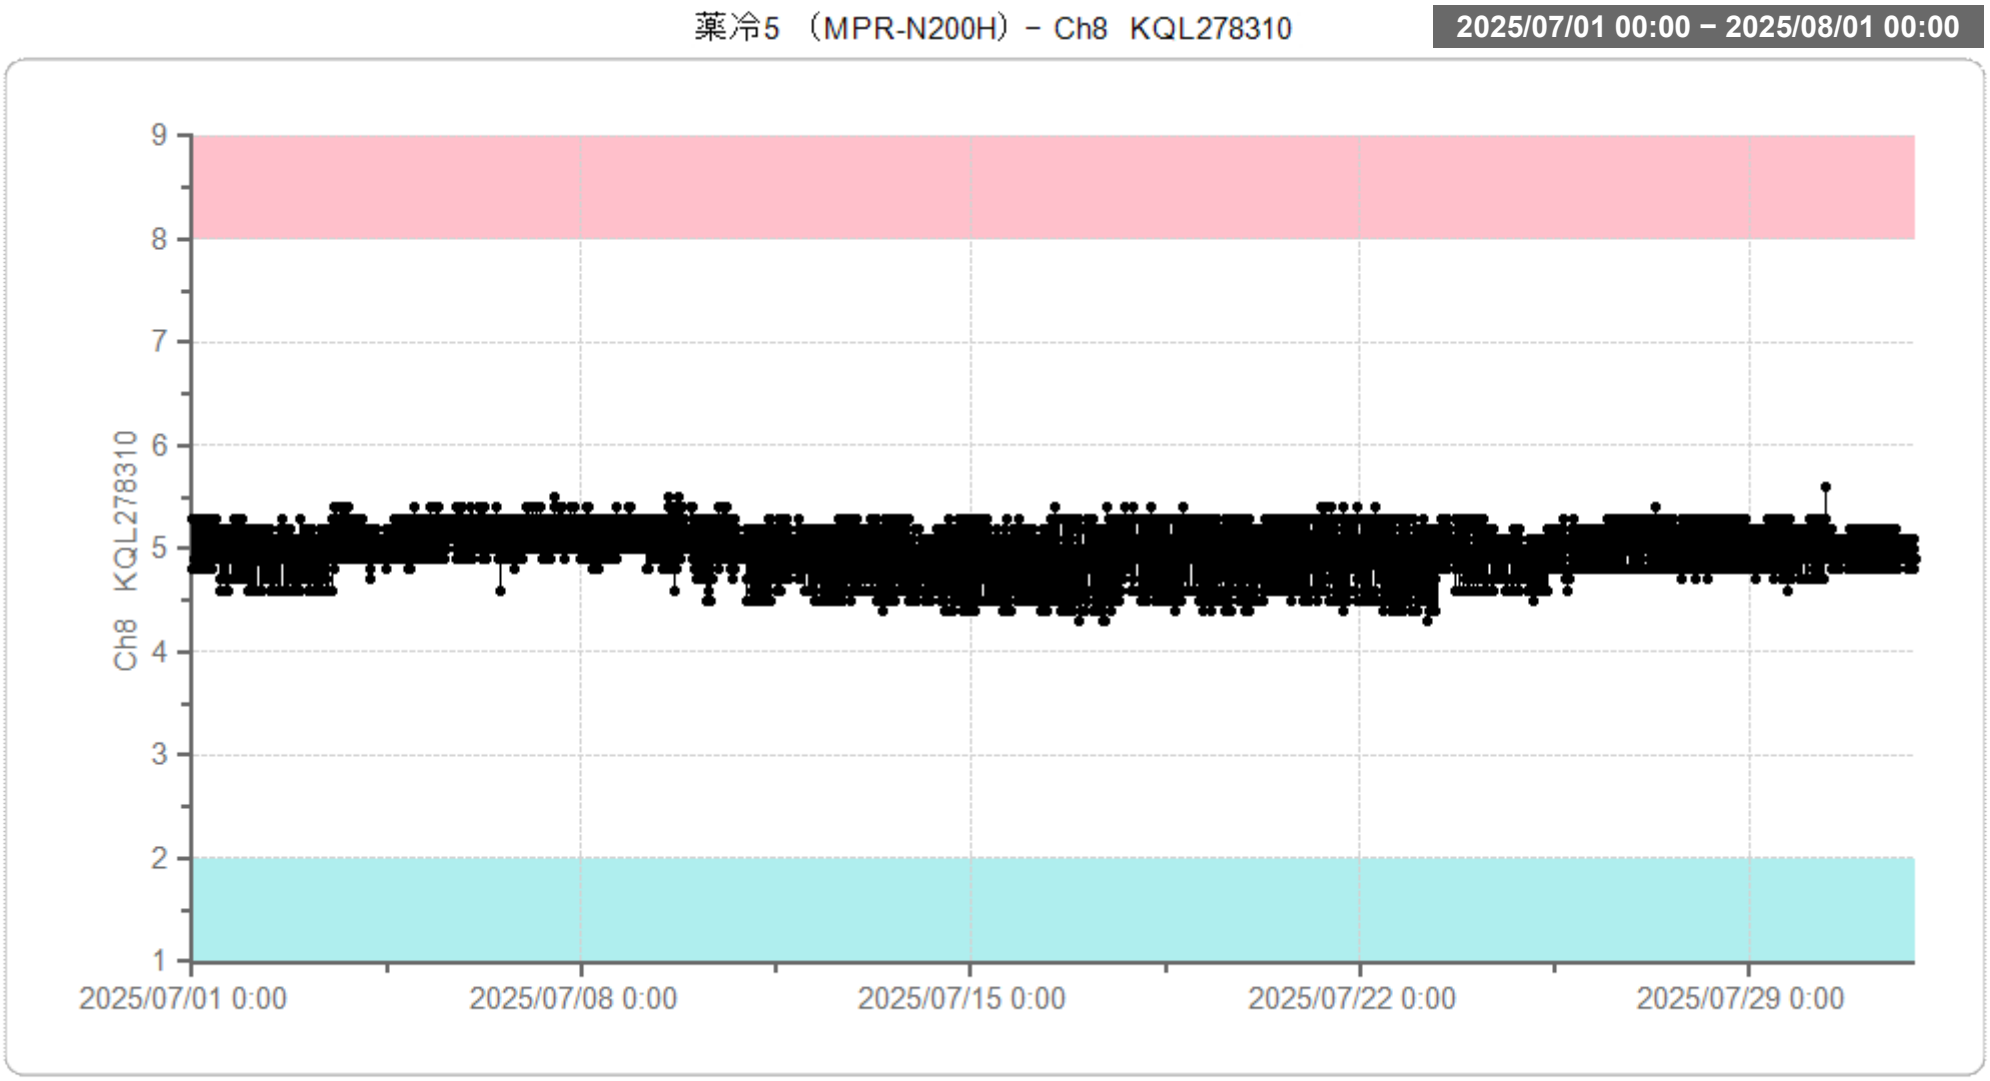


User: super
Print Time: 2025/08/01 11:28:53

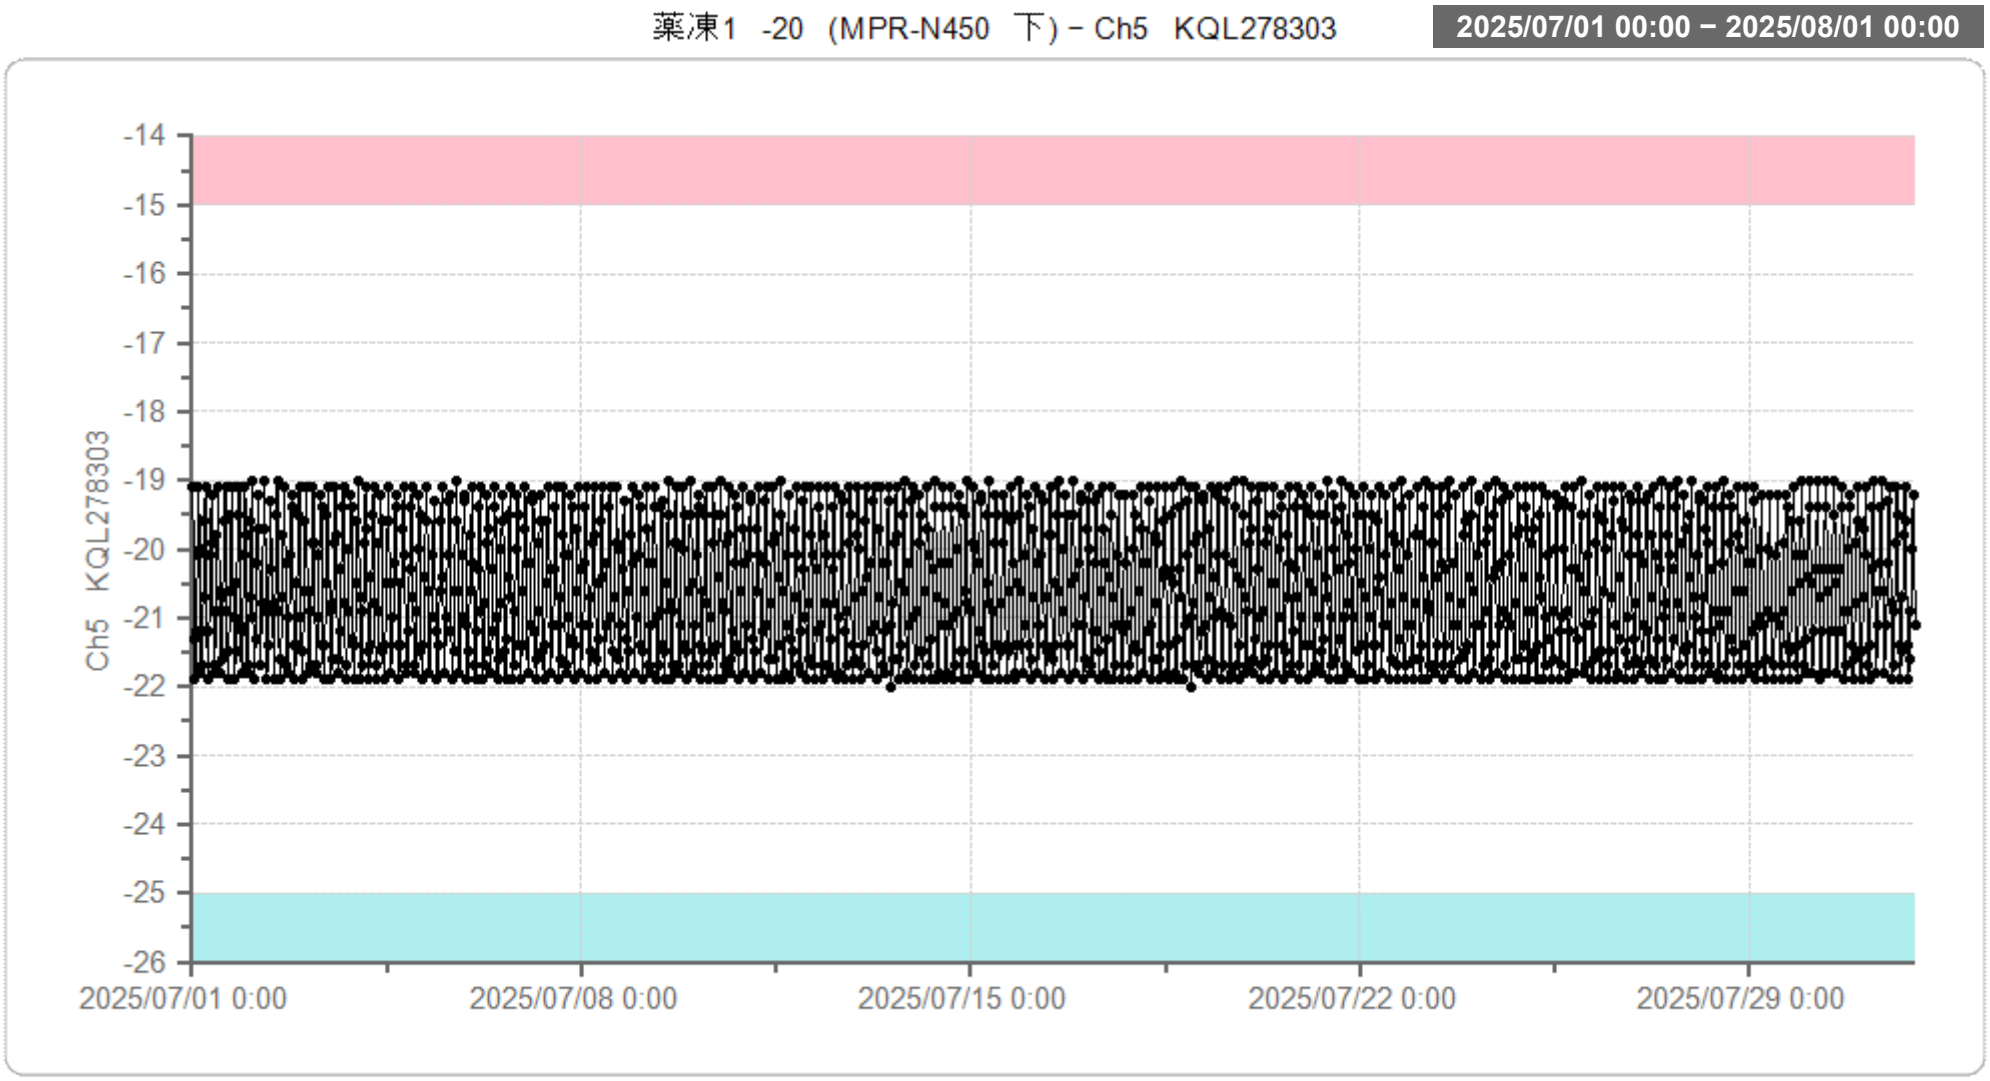


User: super
Print Time: 2025/08/01 11:25:32

薬凍2 -30 (MPR-414F 下) - Ch3 KQL278306 2025/07/01 00:00 – 2025/08/01 00:00

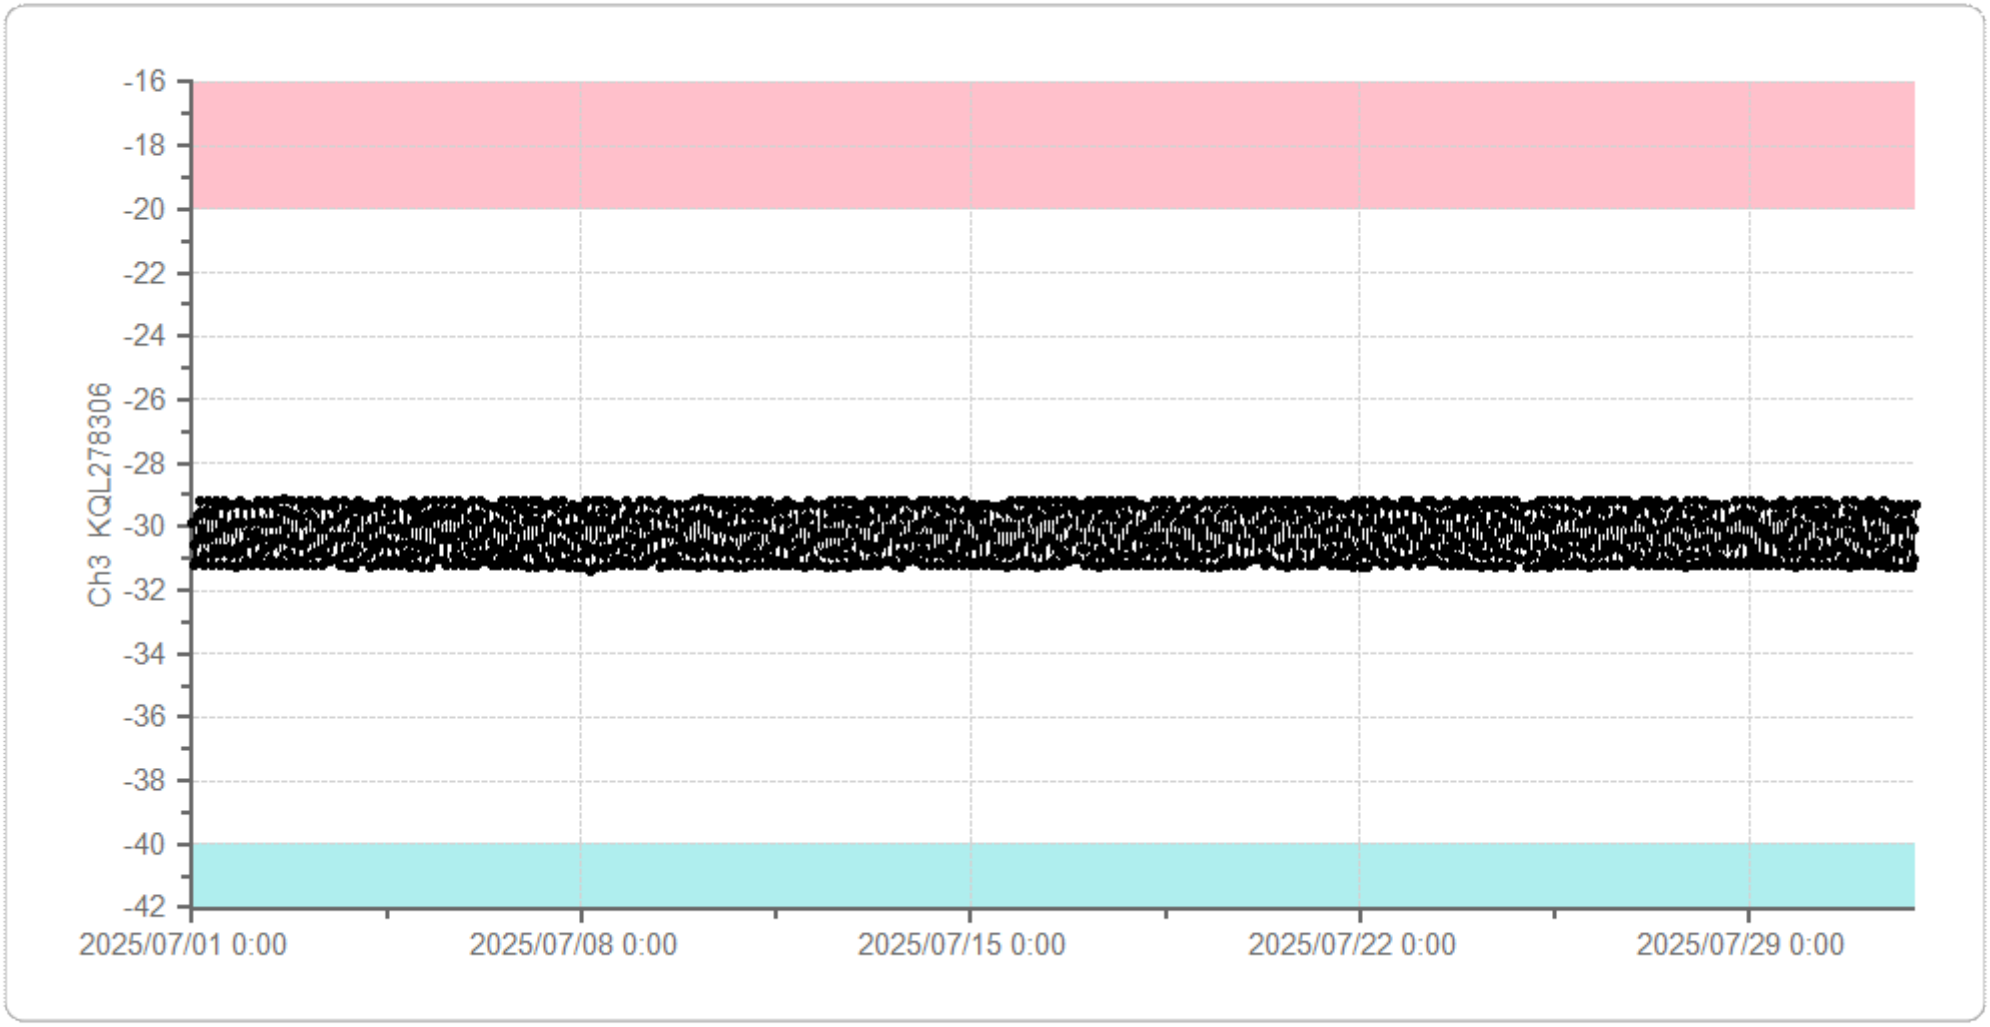


User: super
Print Time: 2025/08/01 11:25:32

検冷 (MPR-N450FH) - Ch3 KQL278309 2025/07/01 00:00 – 2025/08/01 00:00

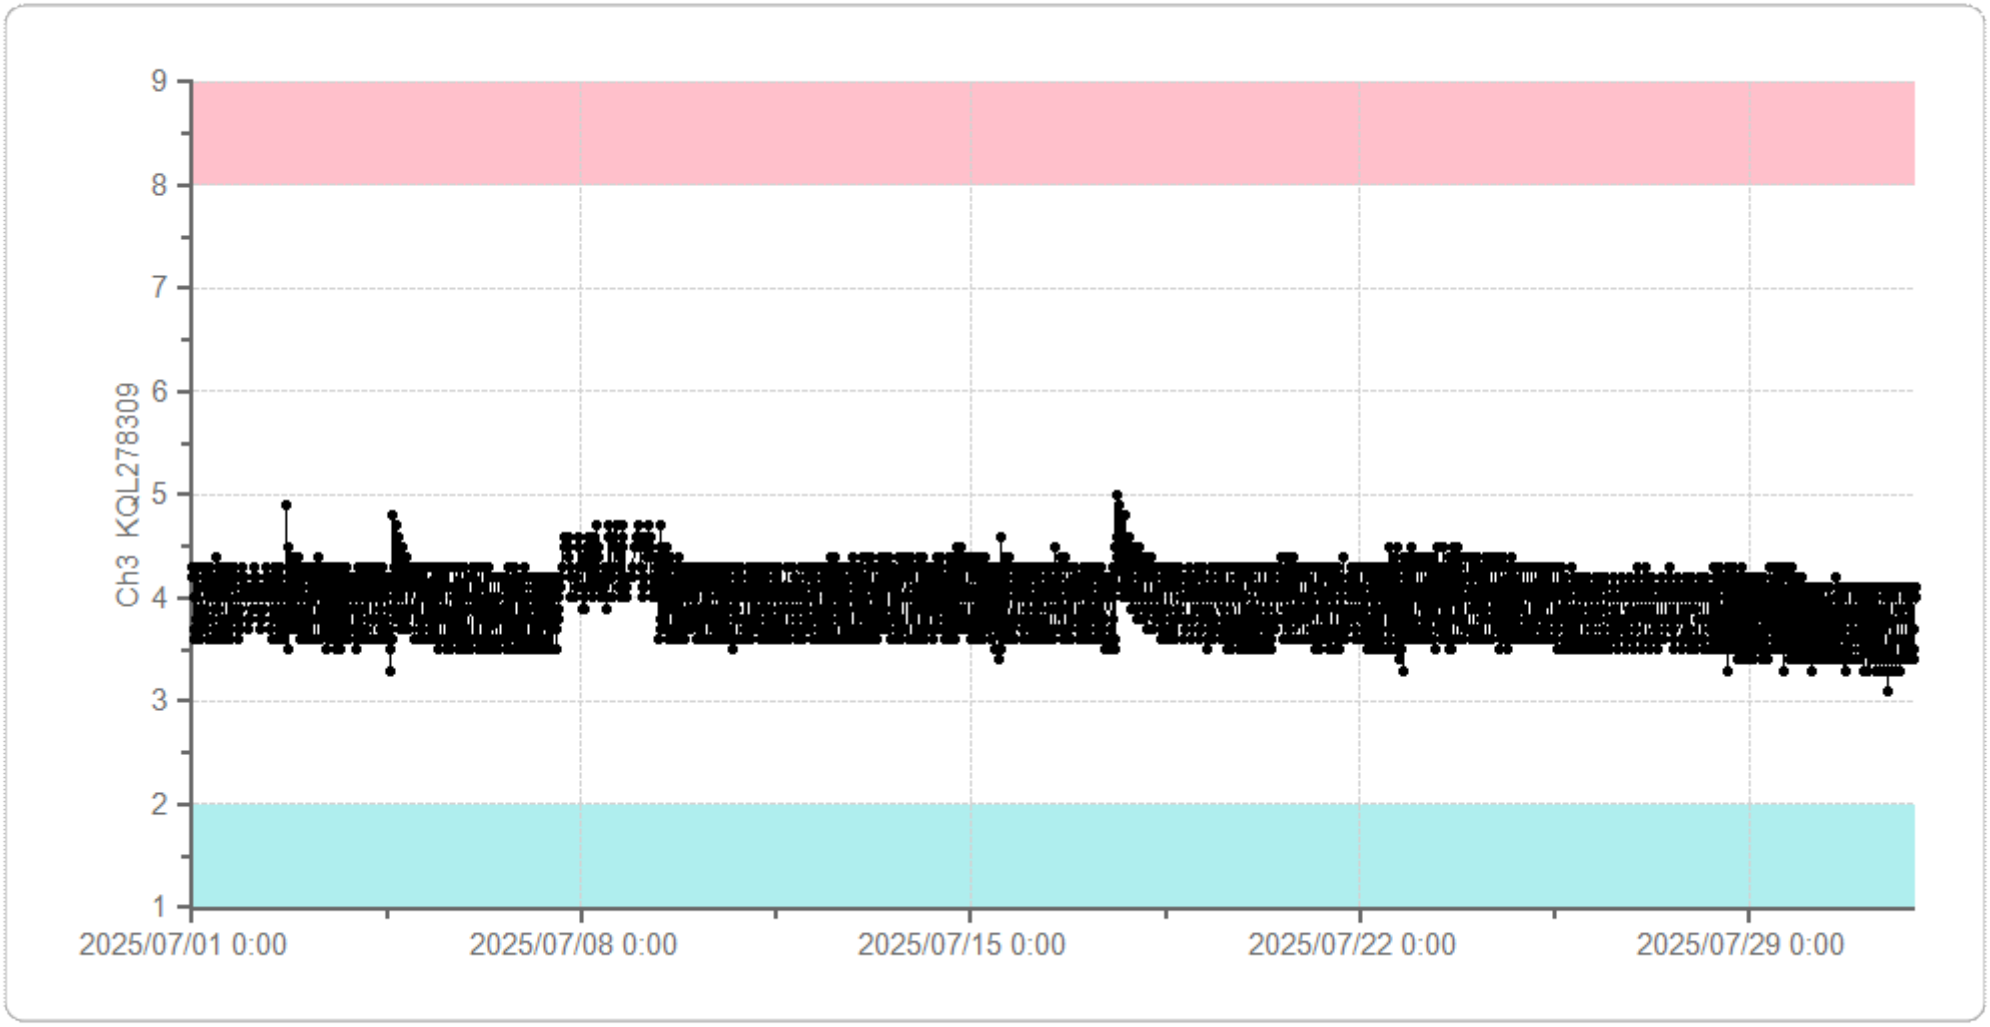

Graph Display


User: super
Print Time: 2025/08/01 11:25:32

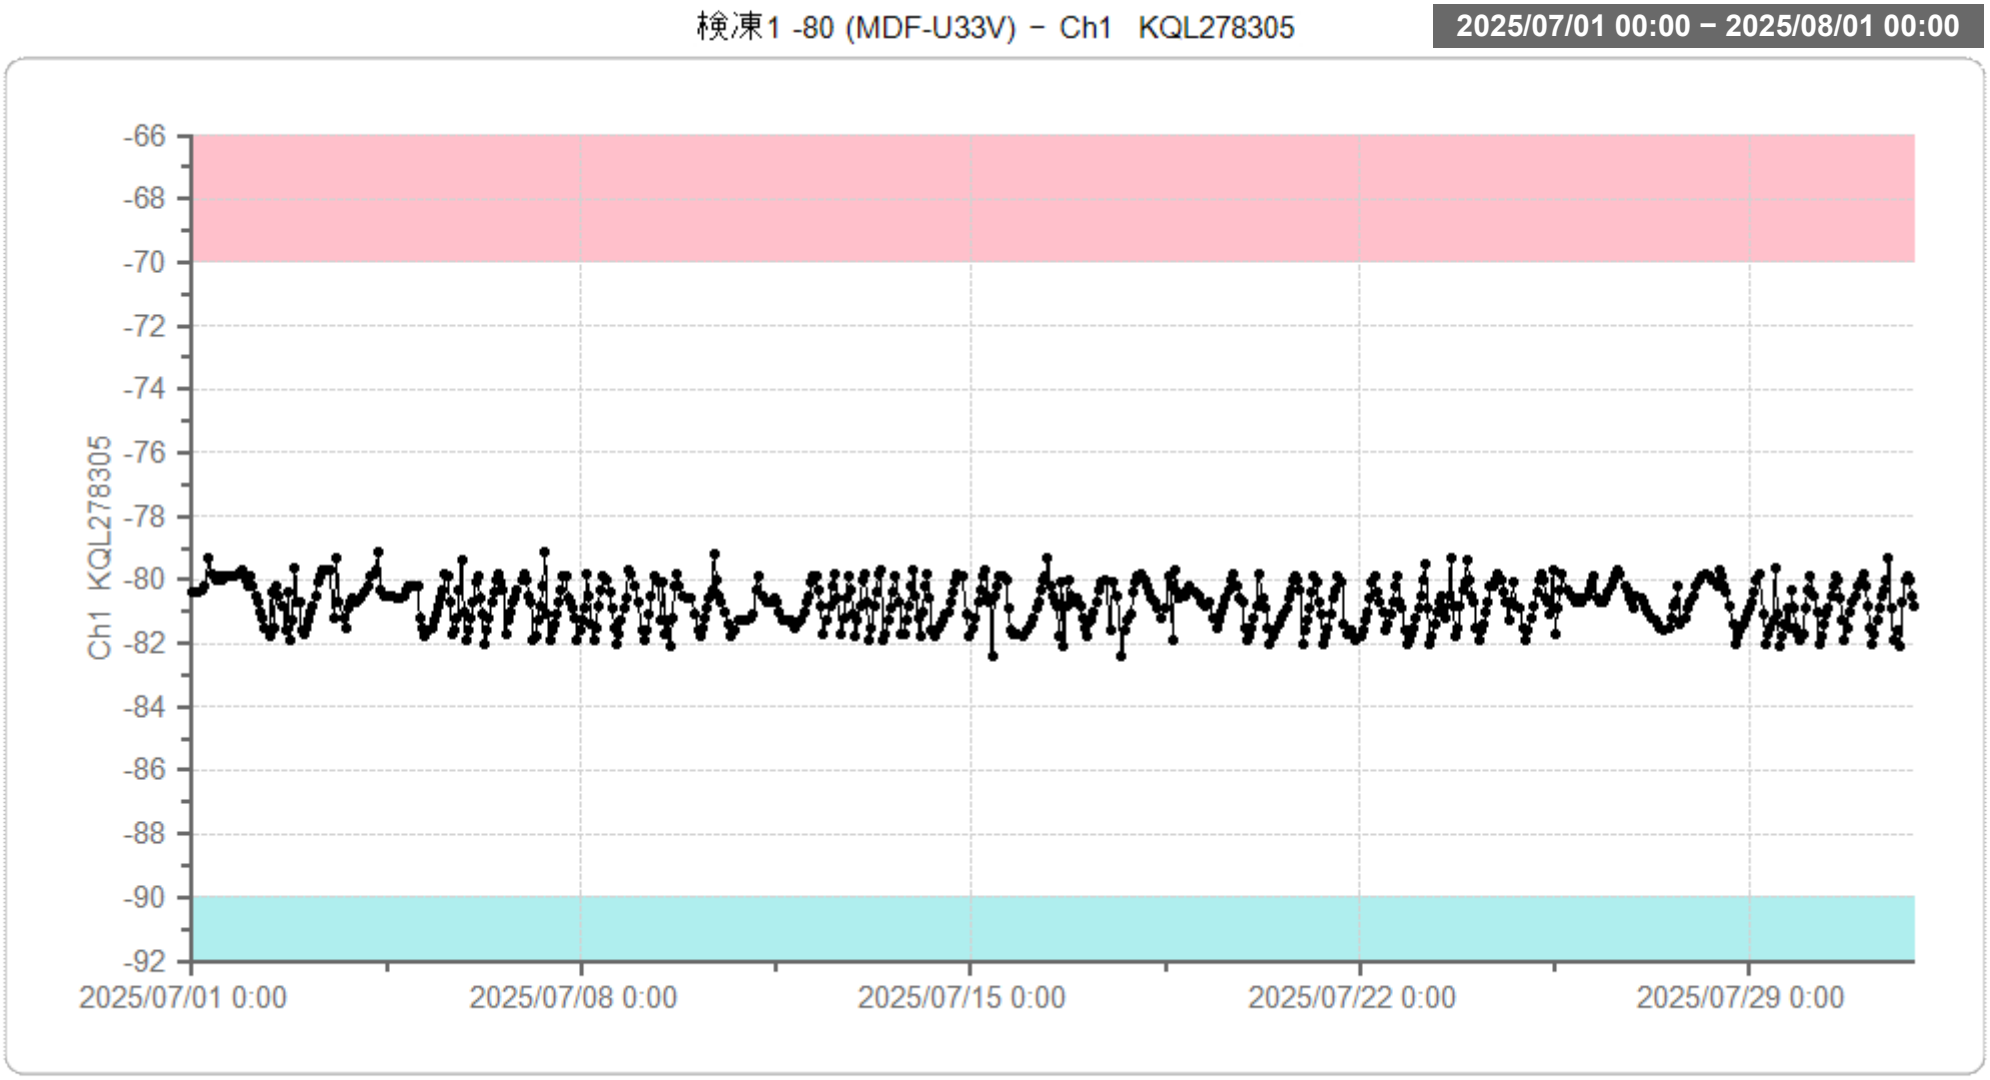

User: super
Print Time: 2025/08/01 11:25:32

検凍2 -80 (MDF-DC202) - Ch2 KQL278307

2025/07/01 00:00 – 2025/08/01 00:00

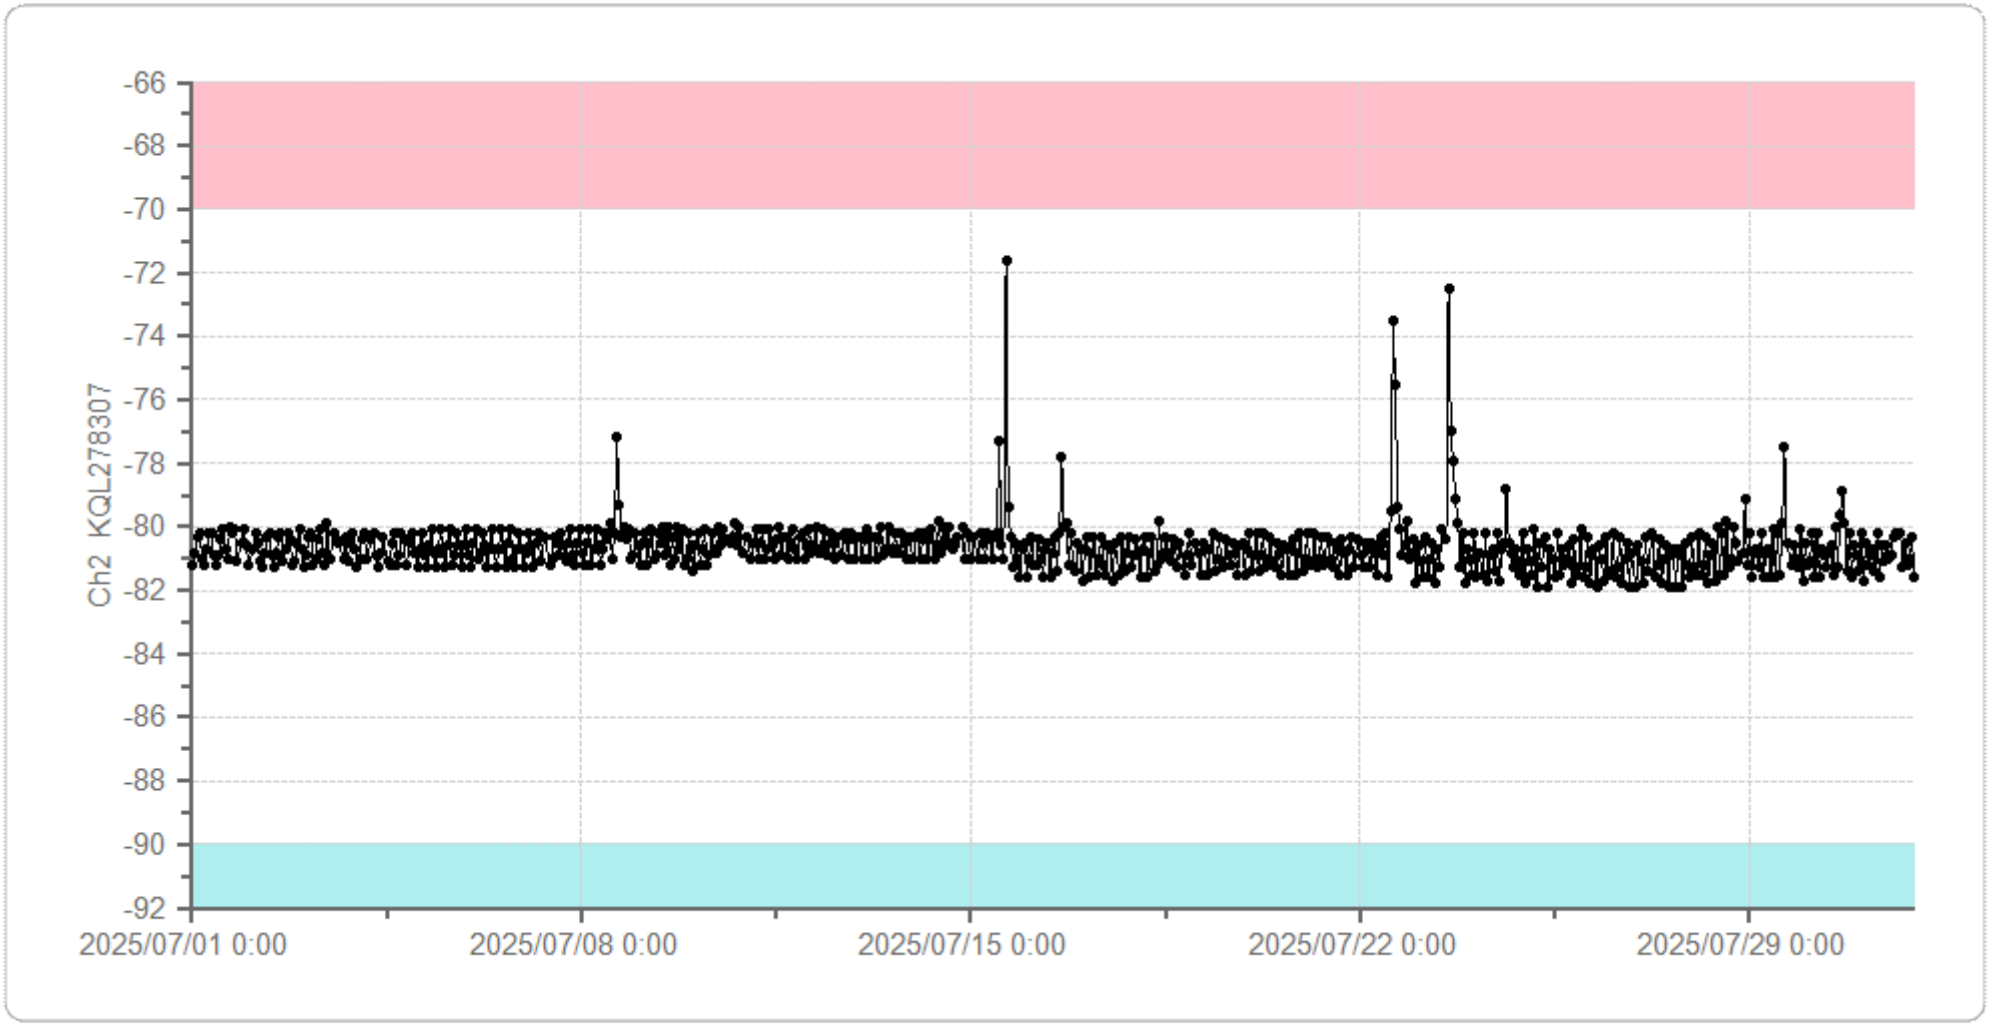

User: super
Print Time: 2025/08/01 11:28:53

検凍3 -30 (MPR-N450FH) - Ch4 ASK116771

2025/07/01 00:00 – 2025/08/01 00:00

